



KIDS-BDI105-JLU

인체적용시험결과보고서

'하이소닉 초음파 디바이스 외 2종'의 디바이스 2종의
볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐
(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습,
피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 및
디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력,
볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채
(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도,
피부 거칠기(결) 개선에 대한 인체적용시험

의뢰기관 : (주)제이엘유

2024년 10월 24일

목 차



I. 시험목적	1
II. 시험기간	1
III. 시험기관	1
IV. 의뢰기관	1
V. 시험방법	2
VI. 결과보고	14
VII. 결 론	52
VIII. 참고문헌	56

별첨자료

[별첨 1] 시험결과에 대한 세부자료

[별첨 2] 인체적용시험 사진자료

[별첨 3] 시험제품 전성분

[별첨 4] 시험제품 안전성 확인서

[별첨 5] 시험기관 연구자의 약력 및 연구경력

[별첨 6] 시험기관의 주요설비

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

한국피부과학연구원에서는 (주)제이엘유에서 의뢰한 '하이소닉 초음파 디바이스 외 2종'의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 개선에 대한 인체적용시험의 연구를 위탁받고, 식품의약품안전처의 의약품, 의약외품, 화장품 및 의료기기 검사기관 지정 등에 관한 규정, 의약품 임상시험 관리기준, 화장품 인체적용시험 및 효력시험 가이드라인, 화장품 표시·광고 실증을 위한 시험방법 가이드라인, 기능성화장품의 유효성평가를 위한 가이드라인, 보건복지부의 생명윤리 및 안전에 관한 법률 및 한국피부과학연구원 표준작업지침서(SOP)에 따라 성실히 연구를 수행하여 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2024년 10월 24일



시험기관 : 한국피부과학연구원 (직인)

시험기관장 : 한국피부과학연구원 연구원장
건국대학교 겸임교수, 이학박사

안 인 숙



시험책임자 : 한국피부과학연구원 연구원장
건국대학교 겸임교수, 이학박사

안 인 숙



시험담당자 : 한국피부과학연구원 연구소장, 이학박사

권 승 빈



본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

시험의뢰자 및 시험기관에 관한 정보



시험명	'하이소닉 초음파 디바이스 외 2종'의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 개선에 대한 인체적용시험
CODE NO	KIDS-BDI105-JLU

의뢰자	명 칭	(주)제이엘유
	소재지	부산광역시 북구 효열로 111, 410, 411, 412호(금곡동, 부산지식산업센터)
	연락처	051-331-7185
	이메일	jlukorea@naver.com
시험기관	명 칭	한국피부과학연구원
	소재지	서울특별시 송파구 법원로11길 25, 에이동 6층(문정동, 에이치비지니스파크)
	연락처	1566-8668
	이메일	research@skinresearch.or.kr

시험 책임자	소속	한국피부과학연구원	책임자	이학박사 안인숙
	주소	서울특별시 송파구 법원로11길 25, 에이동 6층(문정동, 에이치비지니스파크)		
시험 담당자	성명	권승빈, 김윤, 김현경, 김유라, 김명선, 황여진, 김미지, 안정원		
	시험기간	2024년 9월 25일 ~ 2024년 10월 24일	보고일	2024년 10월 24일

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

신뢰성 보증 확인서



□ 시험 명 : '하이소닉 초음파 디바이스 외 2종'의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 개선에 대한 인체적용시험

□ 시험번호 : KIDS-BDI105-JLU

본 시험은 헬싱키선언에 근거한 윤리규정, 식품의약품안전처의 의약품, 의약외품, 화장품 및 의료기기 검사기관 지정 등에 관한 규정, 의약품 임상시험 관리기준, 화장품 인체적용시험 및 효력 시험 가이드라인, 화장품 표시·광고 실증을 위한 시험방법 가이드라인, 기능성화장품의 유효성평가를 위한 가이드라인, 보건복지부의 생명윤리 및 안전에 관한 법률 및 한국피부과학연구원 표준 작업지침서(SOP)에 따라 진행되었으며, 모든 절차는 신뢰성 보증업무 담당자가 점검하였음.

시험명	'하이소닉 초음파 디바이스 외 2종'의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 개선에 대한 인체적용시험				
일시	시험단계	신뢰성 보증 담당자 점검종류	신뢰성 보증 담당자 점검결과	승인일자	비고
2024. 09. 25	시험계획서	시험계획, 피시험자 모집건 점검	승인	2024. 09. 25	
2024. 10. 04 ~ 2024. 10. 08	시험진행 (측정진행)	시험실시 점검	승인	2024. 10. 08	
2024. 10. 10 ~ 2024. 10. 16	데이터 분석 업무, 시험제품 정보입수	데이터(Raw data) 점검	승인	2024. 10. 16	
2024. 10. 17 ~ 2024. 10. 23	보고서 업무	초안보고서 심사	승인	2024. 10. 23	
2024. 10. 24	최종보고서 보고	최종 심사	승인	2024. 10. 24	

본 연구보고서는 시험결과에 근거하여 작성되었으며,
시험자료를 정확하게 반영하고 있음을 증명함.

2024년 10월 24일

연구원장 안인숙



신뢰성 보증 책임자 김가람 (인)



본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

인체적용시험 결과보고서 요약문



시험제목	'하이소닉 초음파 디바이스 외 2종'의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 개선에 대한 인체적용시험	
시험기관	한국피부과학연구원 서울특별시 송파구 법원로11길 25, 에이동 6층(문정동, 에이치비즈니스파크)	
의뢰기관	(주)제이엘유	
시험책임자	이학박사 안인숙	
시험담당자	권승빈, 김윤, 김현경, 김유라, 김명선, 황여진, 김미지, 안정원	
시험제품명	하이소닉 초음파 디바이스(시험제품 A) 하이소닉 하이푸 디바이스(시험제품 B) 오바코 타임슬립 워터맥스 크림(시험제품 C)	
시험기간	2024년 9월 25일(시험개시일) ~ 2024년 10월 24일(시험종료일) (시험개시일 : 시험책임자가 시험계획서에 서명한 날/시험종료일 : 시험책임자가 최종보고서에 서명한 날)	
시험기간 (측정기간)	2024년 10월 4일(피시험자1차방문일) ~ 2024년 10월 8일(방문종료일)	
피시험자 선정기준	피시험자 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 30~65세의 성인 여성	
최종 시험 완료한 피시험자 연령 및 인원	39~62세 성인 여성 22명 (평균 50.77 / 표준편차 5.98)	
시험방법	시료사용법	세안 후 안면부위에 시험제품 C인 '오바코 타임슬립 워터맥스 크림' 동일한 양을 고르게 펴 발라 흡수시킨 후, 왼쪽 안면부위에는 시험제품 B인 '하이소닉 하이푸 디바이스'를, 오른쪽 안면부위에는 시험제품 A인 '하이소닉 초음파 디바이스'를 적용한 뒤 오른쪽 안면부위에 시험제품 B인 '하이소닉 하이푸 디바이스'를 추가로 적용하였다.
	평가방법	한국피부과학연구원 표준작업지침서(SOP)에 따라 진행되었으며, 모든 절차는 신뢰성 보증업무 담당자가 점검하였음 1. 기기측정 1) Cutometer에 의한 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력 개선 평가

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



시험방법	평가방법	2) 전안촬영시스템 F-RAY와 이미지 분석프로그램에 의한 디바이스 2종의 볼/턱 라인부위 피부 처짐(처진 각도) 개선 평가 3) 전안촬영시스템 Mark-vu와 이미지 분석프로그램에 의한 디바이스 2종의 피부 광채(윤기) 개선 평가 4) Epsilon E100에 의한 디바이스 2종의 피부 겉보습 개선 평가 5) MoistureMeterD Compact에 의한 디바이스 2종의 피부 속보습 개선 평가 6) DUB-Skin Scanner에 의한 디바이스 2종의 피부치밀도 개선 평가 7) ANTERA 3D에 의한 디바이스 2종의 피부 거칠기(결) 개선 평가 8) Cutometer에 의한 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력 개선 평가 9) 전안촬영시스템 F-RAY와 이미지 분석프로그램에 의한 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도) 개선 평가 10) 전안촬영시스템 Mark-vu와 이미지 분석프로그램에 의한 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 광채(윤기) 개선 평가 11) Epsilon E100에 의한 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 겉보습 개선 평가 12) MoistureMeterD Compact에 의한 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 속보습 개선 평가 13) DUB-Skin Scanner에 의한 디바이스 2종 병행 사용 시 피부치밀도 개선 평가 14) ANTERA 3D에 의한 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 거칠기(결) 개선 평가 2. 피부이상반응 평가 3. 설문조사																						
시험결과	1. Cutometer를 이용한 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력 평가 결과 <table><tr><th colspan="2">개선율(%)</th><th>1회 사용 직후</th></tr><tr><td rowspan="2">볼부위</td><td>시험제품 A+C</td><td>4.11</td></tr><tr><td>시험제품 B+C</td><td>2.69</td></tr><tr><td rowspan="2">턱라인부위</td><td>시험제품 A+C</td><td>3.69</td></tr><tr><td>시험제품 B+C</td><td>2.15</td></tr><tr><td colspan="2">시험제품 B+C 대비 시험제품 A+C 개선 배수</td><td>1회 사용 직후</td></tr><tr><td colspan="2">볼부위</td><td>1.53</td></tr><tr><td colspan="2">턱라인부위</td><td>1.72</td></tr></table>		개선율(%)		1회 사용 직후	볼부위	시험제품 A+C	4.11	시험제품 B+C	2.69	턱라인부위	시험제품 A+C	3.69	시험제품 B+C	2.15	시험제품 B+C 대비 시험제품 A+C 개선 배수		1회 사용 직후	볼부위		1.53	턱라인부위		1.72
개선율(%)		1회 사용 직후																						
볼부위	시험제품 A+C	4.11																						
	시험제품 B+C	2.69																						
턱라인부위	시험제품 A+C	3.69																						
	시험제품 B+C	2.15																						
시험제품 B+C 대비 시험제품 A+C 개선 배수		1회 사용 직후																						
볼부위		1.53																						
턱라인부위		1.72																						

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

시험결과	2. 전안촬영시스템 F-RAY와 이미지 분석프로그램을 이용한 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도) 평가 결과		
	개선율(%)		1회 사용 직후
	볼부위	시험제품 A+C	3.41
		시험제품 B+C	1.82
	턱라인부위	시험제품 A+C	2.19
		시험제품 B+C	1.01
	시험제품 B+C 대비 시험제품 A+C 개선 배수		1회 사용 직후
	볼부위		1.88
	턱라인부위		2.16
	3. 전안촬영시스템 Mark-vu와 이미지 분석프로그램을 이용한 디바이스 2종의 피부 광채(윤기) 평가 결과		
			1회 사용 직후
	개선율(%)	시험제품 A+C	67.90
		시험제품 B+C	42.50
	시험제품 B+C 대비 시험제품 A+C 개선 배수		1.60
	4. Epsilon E100을 이용한 디바이스 2종의 피부 겉보습 평가 결과		
			1회 사용 직후
	개선율(%)	시험제품 A+C	145.19
		시험제품 B+C	96.56
	시험제품 B+C 대비 시험제품 A+C 개선 배수		1.50
	5. MoistureMeterD Compact를 이용한 디바이스 2종의 피부 속보습 평가 결과		
			1회 사용 직후
	개선율(%)	시험제품 A+C	7.59
		시험제품 B+C	4.93
	시험제품 B+C 대비 시험제품 A+C 개선 배수		1.54
	6. DUB-Skin Scanner를 이용한 디바이스 2종의 피부치밀도 평가 결과		
			1회 사용 직후
	개선율(%)	시험제품 A+C	10.81
		시험제품 B+C	6.51
	시험제품 B+C 대비 시험제품 A+C 개선 배수		1.66

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

시험결과	7. ANTERA 3D를 이용한 디바이스 2종의 피부 거칠기(결) 평가 결과		
			1회 사용 직후
	개선율(%)	시험제품 A+C	10.61
		시험제품 B+C	7.29
	시험제품 B+C 대비 시험제품 A+C 개선 배수		1.46
	8. Cutometer를 이용한 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력 평가 결과		
	개선율(%)		1회 사용 직후
	볼부위	시험제품 A+B+C	5.87
		시험제품 A+C	4.11
	턱라인부위	시험제품 A+B+C	5.51
		시험제품 A+C	3.69
	시험제품 A+C 대비 시험제품 A+B+C 개선 배수		1회 사용 직후
	볼부위		1.43
	턱라인부위		1.49
	9. 전안촬영시스템 F-RAY와 이미지 분석프로그램을 이용한 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도) 평가 결과		
	개선율(%)		1회 사용 직후
	볼부위	시험제품 A+B+C	5.52
		시험제품 A+C	3.41
	턱라인부위	시험제품 A+B+C	3.52
		시험제품 A+C	2.19
	시험제품 A+C 대비 시험제품 A+B+C 개선 배수		1회 사용 직후
	볼부위		1.62
	턱라인부위		1.61
	10. 전안촬영시스템 Mark-vu와 이미지 분석프로그램을 이용한 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 광채(윤기) 평가 결과		
			1회 사용 직후
	개선율(%)	시험제품 A+B+C	46.96
		시험제품 A+C	67.90
	시험제품 A+C 대비 시험제품 A+B+C 개선 배수		0.69

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구소의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



시험결과	11. Epsilon E100을 이용한 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 겉보습 평가 결과		
			1회 사용 직후
	개선율(%)	시험제품 A+B+C	173.44
		시험제품 A+C	145.19
	시험제품 A+C 대비 시험제품 A+B+C 개선 배수		1.19
	12. MoistureMeterD Compact를 이용한 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 속보습 평가 결과		
			1회 사용 직후
	개선율(%)	시험제품 A+B+C	11.24
		시험제품 A+C	7.59
	시험제품 A+C 대비 시험제품 A+B+C 개선 배수		1.48
	13. DUB-Skin Scanner를 이용한 디바이스 2종 병행 사용 시 피부치밀도 평가 결과		
			1회 사용 직후
	개선율(%)	시험제품 A+B+C	15.89
		시험제품 A+C	10.81
	시험제품 A+C 대비 시험제품 A+B+C 개선 배수		1.47
	14. ANTERA 3D를 이용한 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 거칠기(결) 평가 결과		
			1회 사용 직후
	개선율(%)	시험제품 A+B+C	13.78
		시험제품 A+C	10.61
	시험제품 A+C 대비 시험제품 A+B+C 개선 배수		1.30
15. 시험기간 동안 피시험자로부터 피부이상반응은 관찰되지 않았다.			
결론	(주)제이엘유에서 의뢰한 '하이소닉 초음파 디바이스 외 2종'은 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 개선에 도움을 주는 제품으로 판단된다.		

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



I. 시험목적

본 시험은 30~65세의 성인 여성을 대상으로 '하이소닉 초음파 디바이스 외 2종'의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 개선에 대한 인체효능을 평가하는 것을 목적으로 한다.

II. 시험기간

2024년 9월 25일 ~ 2024년 10월 24일

III. 시험기관

기관명 : 한국피부과학연구원
주소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 25, 에이동 6층(문정동, 에이치비지니스파크)
전화 : 1566-8668
팩스 : 02-6957-8004
이메일 : research@skinresearch.or.kr
홈페이지 : www.skinresearch.or.kr
시험자 : 권승빈, 김윤, 김현경, 김유라, 김명선, 황여진, 김미지, 안정원

IV. 의뢰기관

기관명 : (주)제이엘유
의뢰인 : 김기수
주소 : 부산광역시 북구 효열로 111, 410, 411, 412호(금곡동, 부산지식산업센터)
전화 : 051-331-7185
팩스 : 051-331-7187
이메일 : jlukorea@naver.com

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



V. 시험방법

1. 피시험자의 선정

자발적으로 모집된 30~65세의 성인 여성 중에서 다음 1)항의 기준에 만족하며, 2)항에 해당되는 사항이 없는 사람을 피시험자로 선정하였다. 시험책임자 또는 시험책임자의 위임을 받은 시험자는 시험의 모든 정보를 피시험자에게 충분히 알렸으며, 피시험자는 자의에 따라 동의서를 작성하고 시험에 참가하였다.

1) 피시험자 선정기준

- (1) 시험책임자 또는 시험책임자의 위임을 받은 사람으로부터 피시험자에게 알려주어야 할 사항에 대하여 충분히 설명을 듣고 자발적으로 동의서를 작성하고 서명한 사람
- (2) 30~65세의 성인 여성으로서 피부질환을 포함하는 급, 만성 신체질환이 없는 건강한 사람
- (3) 시험기간 동안 추적관찰이 가능한 사람

2) 피시험자 선정제외기준

지원자와의 면담에 의하여 다음 사항에 해당되는 사람은 피시험자에서 제외시켰다.

- (1) 임신 또는 수유중인 여성과 임신 가능성이 있는 여성
- (2) 피부질환 치료를 위하여 스테로이드가 함유된 피부 외용제를 1개월 이상 사용하는 사람
- (3) 동일한 시험에 참가한 뒤 6개월이 경과되지 않은 사람
- (4) 민감성, 과민성 피부를 가진 사람
- (5) 시험부위에 점, 여드름, 홍반, 모세혈관확장 등의 피부이상 소견이 있는 사람
- (6) 연구시작 전 6개월 내에 시험부위에 시술을 받은 사람
- (7) 그 외 시험책임자의 판단으로 시험에 부적합하다고 생각되는 사람

3) 피시험자 중도탈락기준

아래의 경우 시험책임자의 판단 하에 중지시키고, 이를 시험결과 산정에서 제외하고 최종보고서에 기록하여 보고하였다.

- (1) 시험부위에 소양감이나 홍반 등의 유해사례가 발생한 경우
- (2) 피시험자가 시험 진행과정 중 시험부위에 의학적 처치, 타제품의 적용, 과도한 자외선 노출, 지나친 음주 및 흡연 등으로 결과의 평가에 장애가 발생할 경우

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



- (3) 피시험자가 시험 진행과정 중 개인사정에 의하여 추적관찰이 어려운 경우
- (4) 특별한 이유 없이 피시험자가 사용방법이나 일정을 어긴 경우

4) 정보의 비밀 유지와 성실 의무

정보의 비밀 유지를 위하여 아래의 사항을 피시험자에게 충분히 알렸다.

- (1) 본 시험에 참여한 피시험자의 비밀은 보장되며 의학적인 목적에 의해서 피시험자의 신원이 밝혀지지 않는 범위에서 시험자료를 이용한다.
- (2) 피시험자는 본 시험을 통해 얻은 정보는 시험이 종료될 때까지 비밀을 유지한다.
- (3) 본 시험에 참여하는 피시험자는 성실하고 정직하게 자료를 작성한다.

5) 피시험자에게 알려주어야 할 사항

시험책임자 또는 시험책임자의 위임을 받은 사람은 피시험자들에게 본 시험의 목적과 방법, 기대 이득 효과와 시험으로부터 야기될 수 있는 소양증, 홍반, 자극 등의 이상반응, 시험기간 종료와 동시에 즉시적인 시험군에서의 탈퇴, 본인의 인체적용시험 거부 또는 탈퇴로 다른 불이익을 받지 않게 됨을 확인하고 시험제품으로 인한 모든 이상반응의 발생 가능성과 만일 이상반응 발생시 중도탈락 및 치료 등의 다른 조치가 고려될 수 있음에 대하여 충분히 설명하였다. 또한 시험 종료 후 피시험자는 참여에 대한 비용(시험비)을 받는다는 것을 알려주었다.

6) 유해사례(부작용) 발생시 조치

유해사례(부작용) 발생시 모든 이상반응을 기록하고, 매회 시험대상자가 방문할 때마다 문진과 전문가 육안평가로 피부를 진찰하여 개인별 증례기록서(Case Report Form)에 기록한다. 이상반응이 발생할 경우 시료 사용 및 시험 참여를 바로 중단하고 피시험자 본인의 서명이 첨부된 '시험참가 포기동의서'를 쓰도록 하고, 피부과 진료가 필요하다고 판단시에 한국피부과학연구원과 연계된 피부과 전문의에게 치료를 받을 수 있도록 빠르게 조치를 취한다. 또한, 이상반응 발생부터 치료 완료 후까지 추적관찰을 통해 증례기록서를 기록하고, 이상반응 치료를 위해 발생하는 모든 비용은 의뢰기관이 부담하며, 단 연구원의 조치로(자외선 조사 등) 인한 이상반응일 경우에 한해 한국피부과학연구원에서 부담하도록 한다.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



2. 시험부위

시험제품의 용법을 기준으로 하여 피시험자의 안면부위를 본 시험의 시험부위로 선정하였다.

3. 시험제품 사용

본 시험에 사용된 시험제품의 물리화학적 특성과 안전성을 확인하고 확보할 책임은 의뢰기관에 있으며, 본 시험기관에서는 시험제품의 물리화학적 특성을 확인하기 위한 별도의 분석절차를 수행하지 않는다. 한국피부과학연구원에서는 보고서가 발행된 날로부터 180일간 시험제품을 보관하며, 의뢰기관으로부터 별도의 요청이 없는 경우 해당 시험제품을 폐기한다. 시험제품은 고온과 직사광선을 피해, 실온(1~30℃)에서 보관한다.

1) 시험제품 정보

(1) 시험제품명

- ① 시험제품 A : 하이소닉 초음파 디바이스
- ② 시험제품 B : 하이소닉 하이푸 디바이스
- ③ 시험제품 C : 오바코 타임슬립 워터맥스 크림

(2) 시험제품 관리번호

- ① 시험제품 A : M-KIDS-BDIP01-JLU
- ② 시험제품 B : M-KIDS-BDIP02-JLU
- ③ 시험제품 C : M-KIDS-BDIP03-JLU

(3) 의뢰기관 : (주)제이엘유

(4) 제형

- ① 시험제품 A : 원형의 헤드가 달린 미용기기
- ② 시험제품 B : 원형의 헤드가 달린 미용기기
- ③ 시험제품 C : 무색의 반투명한 젤크림타입

(5) 전성분 : 별첨 3 참조

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



2) 시험제품의 용법 및 용량

- (1) 피시험자는 세안 후 안면부위에 시험제품 C인 '오바코 타임슬립 워터맥스 크림' 동일한 양을 고르게 펴 발라 흡수시킨 후, 왼쪽 안면부위에는 시험제품 B인 '하이소닉 하이푸 디바이스'를, 오른쪽 안면부위에는 시험제품 A인 '하이소닉 초음파 디바이스'를 적용한 뒤 오른쪽 안면부위에 시험제품 B인 '하이소닉 하이푸 디바이스'를 추가로 적용하였다.
- (2) 인체적용시험기간 중에는 본 연구원에서 지급한 제품 이외에 시험결과에 영향을 미칠 수 있는 안면 미용기기와 아이크림, 미백크림, 노화방지용 크림과 같은 각종 기능성화장품 및 각질제거제의 사용을 일체 금하였으며, 팩이나 마사지 등의 시술도 금하였다.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

4. 평가

1) 시험장소

본 인체적용시험은 한국피부과학연구원에서 동일한 세안제로 세안 후 30분간 항온항습실 (온도 : $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$, 습도 : $50 \pm 5\%$)에서 안정을 취한 뒤 측정하였다.

2) 측정

(1) Cutometer에 의한 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력 개선 평가

본 시험에서는 Cutometer (Cutometer dual MPA 580, Courage+Khazaka Electronic GmbH, Cologne, Germany)를 적용하였다. 동일한 시험담당자가 모든 피시험자의 양쪽 볼, 턱라인부위(시험제품 A+C 도포부위, 시험제품 B+C 도포부위)에 probe를 접촉테이프로 고정 한 후 450mbar의 압력으로 2초간 흡입 및 이완을 3회 반복하고 그 평균값을 계산하여 분석에 사용하였다. 이에 대한 분석은 Cutometer 전용 분석프로그램인 software MPA CTplus를 이용하여 피부 탄력을 나타내는 R2 값을 분석하였고, 측정단위는 %이다. 시험제품 사용 전과 비교하여 측정값이 증가할수록, 시험제품 B+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+C 도포부위의 측정값 변화가 유의하게($p < .05$) 증가할수록 개선되었음을 의미한다.



그림 1. Cutometer.

(2) 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도) 개선 평가

① 전안촬영시스템 F-RAY와 이미지 분석프로그램에 의한 디바이스 2종의 볼부위 피부 처짐 (처진 각도) 개선 평가

본 시험에서는 전안촬영시스템 F-RAY (BEYOUNG, Korea)와 이미지 분석프로그램 (Image-Pro 10, Media Cybernetics, Inc., USA)을 적용하였다. 동일한 시험담당자가 모든 피시험자의 양쪽 안면부위(시험제품 A+C 도포부위, 시험제품 B+C 도포부위)를 30° 의 각도로 측정하였고, 무아레 전용 필터로 측정된 이미지는 이미지 분석프로그램을 이용하여 콧방울 부위에서 수평선을 그려 콧방울 바로 옆 팔자부위와 만나는 등고선의 접선이 이루는 각도를

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

분석하였다. 시험제품 사용 전과 비교하여 측정값이 감소할수록, 시험제품 B+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+C 도포부위의 측정값 변화가 유의하게($p<.05$) 감소할수록 개선되었음을 의미한다.



그림 2. 전안촬영시스템 F-RAY.

② 전안촬영시스템 F-RAY와 이미지 분석프로그램에 의한 디바이스 2종의 턱라인부위 피부 처짐(처진 각도) 개선 평가

본 시험에서는 전안촬영시스템 F-RAY와 이미지 분석프로그램을 적용하였다. 동일한 시험담당자가 모든 피시험자의 양쪽 안면부위(시험제품 A+C 도포부위, 시험제품 B+C 도포부위)를 45°의 각도로 측정하였고, 무아레 전용 필터로 측정된 이미지는 이미지 분석프로그램을 이용하여 턱부위에서 수평선을 그려 이중턱부위와 만나는 등고선의 접선이 이루는 각도를 분석하였다. 시험제품 사용 전과 비교하여 측정값이 감소할수록, 시험제품 B+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+C 도포부위의 측정값 변화가 유의하게($p<.05$) 감소할수록 개선되었음을 의미한다.

(3) 전안촬영시스템 Mark-vu와 이미지 분석프로그램에 의한 디바이스 2종의 피부 광채(윤기) 개선 평가

본 시험에서는 전안촬영시스템 Mark-vu (PSI Plus Co., Ltd., Suwon, Republic of Korea)와 이미지 분석프로그램(Image J, National Institutes of Health, USA)을 적용하였다. 동일한 시험담당자가 모든 피시험자의 양쪽 안면부위(시험제품 A+C 도포부위, 시험제품 B+C 도포부위)를 측정하였고, Specular light로 측정된 이미지는 피부의 광채(윤기)를 나타내는 intensity 값을 분석하였다. 시험제품 사용 전과 비교하여 측정값이 증가할수록, 시험제품 B+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+C 도포부위의 측정값 변화가 유의하게($p<.05$) 증가할수록 개선되었음을 의미한다.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



그림 3. 전안촬영시스템 Mark-vu.

(4) Epsilon E100에 의한 디바이스 2종의 피부 겉보습 개선 평가

본 시험에서는 Epsilon E100 (Biox Systems Ltd., UK)을 적용하였다. 동일한 시험담당자가 모든 피시험자의 양쪽 볼부위(시험제품 A+C 도포부위, 시험제품 B+C 도포부위)를 측정하였고, 이에 대한 피부 수분의 변화를 분석하였다. 시험제품 사용 전과 비교하여 측정값이 증가할수록, 시험제품 B+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+C 도포부위의 측정값 변화가 유의하게($p < .05$) 증가할수록 개선되었음을 의미한다.

(5) MoistureMeterD Compact에 의한 디바이스 2종의 피부 속보습 개선 평가

본 시험에서는 MoistureMeterD Compact (Delfin Technologies Ltd., Finland)를 적용하였다. 동일한 시험담당자가 모든 피시험자의 양쪽 볼부위(시험제품 A+C 도포부위, 시험제품 B+C 도포부위)에 수직으로 probe를 접촉하여 10초 동안 수평을 유지시키면서 피부 수분을 측정하였으며, 측정단위는 %이다. 시험제품 사용 전과 비교하여 측정값이 증가할수록, 시험제품 B+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+C 도포부위의 측정값 변화가 유의하게($p < .05$) 증가할수록 개선되었음을 의미한다.



그림 4. Epsilon E100.



그림 5. MoistureMeterD Compact.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



(6) DUB-Skin Scanner에 의한 디바이스 2종의 피부치밀도 개선 평가

본 시험에서는 DUB-Skin Scanner (Taberna pro medicm, Luneburg, Germany)를 적용하였다. 동일한 시험담당자가 모든 피시험자의 양쪽 눈꼬리 옆 3 cm부위(시험제품 A+C 도포부위, 시험제품 B+C 도포부위)를 동일한 압으로 눌러 피부치밀도를 측정하였다. 피부치밀도를 나타내는 Density 값을 분석하였고, 측정단위 %값을 사용하였다. 시험제품 사용 전과 비교하여 측정값이 증가할수록, 시험제품 B+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+C 도포부위의 측정값 변화가 유의하게($p<.05$) 증가할수록 개선되었음을 의미한다.

(7) ANTERA 3D에 의한 디바이스 2종의 피부 거칠기(결) 개선 평가

본 시험에서는 ANTERA 3D (Miravex, Ireland)를 적용하였다. 동일한 시험담당자가 모든 피시험자의 양쪽 볼부위(시험제품 A+C 도포부위, 시험제품 B+C 도포부위)를 측정하였고, 측정의 재현성을 위하여 시험제품 사용 전에 측정한 이미지와 오버랩시켜 동일부위를 측정하였다. 촬영된 이미지는 ANTERA 3D 전용 소프트웨어인 ANTERA CS software를 이용하였으며, 이에 대한 분석은 Texture small filter를 이용하여 피부의 평균 거칠기(결)를 나타내는 측정변수값인 Ra 값을 분석하였다. 시험제품 사용 전과 비교하여 측정값이 감소할수록, 시험제품 B+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+C 도포부위의 측정값 변화가 유의하게($p<.05$) 감소할수록 개선되었음을 의미한다.

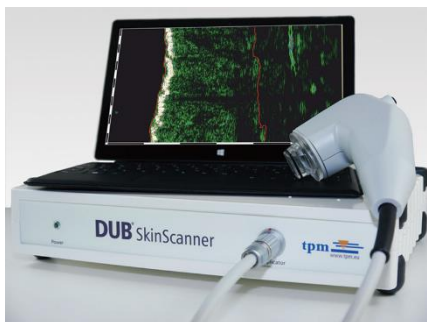


그림 6. DUB-Skin Scanner.



그림 7. ANTERA 3D.

(8) Cutometer에 의한 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력 개선 평가

본 시험에서는 Cutometer를 적용하였다. 동일한 시험담당자가 모든 피시험자의 양쪽 볼, 턱라인부위(시험제품 A+B+C 도포부위, 시험제품 A+C 도포부위)에 probe를 접촉테이프고정한 후 450mbar의 압력으로 2초간 흡입 및 이완을 3회 반복하고 그 평균값을 계산하여 분석에 사용하였다. 이에 대한 분석은 Cutometer 전용 분석프로그램인 software MPA CTplus를 이용하여 피부 탄력을 나타내는 R2 값을 분석하였고, 측정단위는 %이다. 시험제품

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

사용 전과 비교하여 측정값이 증가할수록, 시험제품 A+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위의 측정값 변화가 유의하게($p<.05$) 증가할수록 개선되었음을 의미한다.

(9) 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도) 개선 평가

① 전안촬영시스템 F-RAY와 이미지 분석프로그램에 의한 디바이스 2종 병행 사용 시 볼부위 피부 처짐(처진 각도) 개선 평가

본 시험에서는 전안촬영시스템 F-RAY와 이미지 분석프로그램을 적용하였다. 동일한 시험담당자가 모든 피시험자의 양쪽 안면부위(시험제품 A+B+C 도포부위, 시험제품 A+C 도포부위)를 30°의 각도로 측정하였고, 무아레 전용 필터로 측정된 이미지는 이미지 분석프로그램을 이용하여 콧방울부위에서 수평선을 그려 콧방울 바로 옆 팔자부위와 만나는 등고선의 접선이 이루는 각도를 분석하였다. 시험제품 사용 전과 비교하여 측정값이 감소할수록, 시험제품 A+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위의 측정값 변화가 유의하게($p<.05$) 감소할수록 개선되었음을 의미한다.

② 전안촬영시스템 F-RAY와 이미지 분석프로그램에 의한 디바이스 2종의 턱라인부위 피부 처짐(처진 각도) 개선 평가

본 시험에서는 전안촬영시스템 F-RAY와 이미지 분석프로그램을 적용하였다. 동일한 시험담당자가 모든 피시험자의 양쪽 안면부위(시험제품 A+B+C 도포부위, 시험제품 A+C 도포부위)를 45°의 각도로 측정하였고, 무아레 전용 필터로 측정된 이미지는 이미지 분석프로그램을 이용하여 턱부위에서 수평선을 그려 이중턱부위와 만나는 등고선의 접선이 이루는 각도를 분석하였다. 시험제품 사용 전과 비교하여 측정값이 감소할수록, 시험제품 A+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위의 측정값 변화가 유의하게($p<.05$) 감소할수록 개선되었음을 의미한다.

(10) 전안촬영시스템 Mark-vu와 이미지 분석프로그램에 의한 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 광채(윤기) 개선 평가

본 시험에서는 전안촬영시스템 Mark-vu와 이미지 분석프로그램을 적용하였다. 동일한 시험담당자가 모든 피시험자의 양쪽 안면부위(시험제품 A+B+C 도포부위, 시험제품 A+C 도포부위)를 측정하였고, Specular light로 측정된 이미지는 피부의 광채(윤기)를 나타내는 intensity 값을 분석하였다. 시험제품 사용 전과 비교하여 측정값이 증가할수록, 시험제품 A+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위의 측정값 변화가 유의하게($p<.05$) 증가할수록 개선되었음을 의미한다.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

(11) Epsilon E100에 의한 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 겉보습 개선 평가

본 시험에서는 Epsilon E100을 적용하였다. 동일한 시험담당자가 모든 피시험자의 양쪽 볼부위(시험제품 A+B+C 도포부위, 시험제품 A+C 도포부위)를 측정하였고, 이에 대한 피부 수분의 변화를 분석하였다. 시험제품 사용 전과 비교하여 측정값이 증가할수록, 시험제품 A+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위의 측정값 변화가 유의하게($p<.05$) 증가할수록 개선되었음을 의미한다.

(12) MoistureMeterD Compact에 의한 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 속보습 개선 평가

본 시험에서는 MoistureMeterD Compact를 적용하였다. 동일한 시험담당자가 모든 피시험자의 양쪽 볼부위(시험제품 A+B+C 도포부위, 시험제품 A+C 도포부위)에 수직으로 probe를 접촉하여 10초 동안 수평을 유지시키면서 피부 수분을 측정하였으며, 측정단위는 %이다. 시험제품 사용 전과 비교하여 측정값이 증가할수록, 시험제품 A+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위의 측정값 변화가 유의하게($p<.05$) 증가할수록 개선되었음을 의미한다.

(13) DUB-Skin Scanner에 의한 디바이스 2종 병행 사용 시 피부치밀도 개선 평가

본 시험에서는 DUB-Skin Scanner를 적용하였다. 동일한 시험담당자가 모든 피시험자의 양쪽 눈꼬리 옆 3 cm부위(시험제품 A+C 도포부위, 시험제품 B+C 도포부위)를 동일한 압력으로 눌러 피부치밀도를 측정하였다. 피부치밀도를 나타내는 Density 값을 분석하였고, 측정단위 % 값을 사용하였다. 시험제품 사용 전과 비교하여 측정값이 증가할수록, 시험제품 A+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위의 측정값 변화가 유의하게($p<.05$) 증가할수록 개선되었음을 의미한다.

(14) ANTERA 3D에 의한 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 거칠기(결) 개선 평가

본 시험에서는 ANTERA 3D를 적용하였다. 동일한 시험담당자가 모든 피시험자의 양쪽 볼부위(시험제품 A+C 도포부위, 시험제품 B+C 도포부위)를 측정하였고, 측정의 재현성을 위하여 시험제품 사용 전에 측정한 이미지와 오버랩시켜 동일부위를 측정하였다. 촬영된 이미지는 ANTERA 3D 전용 소프트웨어인 ANTERA CS software를 이용하였으며, 이에 대한 분석은 Texture small filter를 이용하여 피부의 평균 거칠기(결)를 나타내는 측정변수값인 Ra 값을 분석하였다. 시험제품 사용 전과 비교하여 측정값이 감소할수록, 시험제품 A+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위의 측정값 변화가 유의하게($p<.05$) 감소할수록 개선되었음을 의미한다.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

(15) 이상반응 평가

시험담당자는 시험부위에서 피부이상인 홍반(Erythema), 부종(Edema), 인설생성(Scaling), 가려움(Itching), 자통(Stinging), 작열감(Burning), 뻣뻣함(Tightness), 따끔거림(Prickling)의 여부를 관찰하고 피부이상반응이 나타날 시 등급을 표시하여 이에 대한 결과를 작성하였다. 또한 피시험자를 대상으로 피부이상반응에 대한 설문조사를 하였다.

(16) 설문조사

피시험자의 일반적 피부상태 특성과 시험제품 사용 전후의 피부상태, 시험제품 사용감 등에 대해 설문조사를 실시하였다.

5. 유해사례

유해사례 평가는 개인별 증례기록서(Case Report Form)에서 매회 피시험자가 방문할 때마다 문진과 육안으로 유해사례(홍반, 부종, 인설, 가려움, 자통, 작열감, 뻣뻣함, 따끔거림)나 다른 이상이 발생하는지 평가하였다. 정도를 약한 정도인지, 중간 정도인지, 심한 정도인지를 구분하여 기록하였으며, 시험중지 또는 탈락사항이 발생하는지 점검하여 증례기록서에 기입하였다. 방문하는 날이 아니더라도 시험에 더 이상 참가할 수 없게 되는 경우는 본인의 서명이 첨부된 '시험 참가 포기동의서'를 쓰도록 하였다.

6. 통계분석 방법

본 시험의 통계처리는 SPSS 17.0 for Windows 프로그램을 이용하여 분석하였다. 피시험자의 설문지 분석을 위하여 평균, 표준편차, 빈도, 백분율을 실시하였고, 다양한 피부 개선도에 대한 기기측정 결과의 유의한 변화여부를 분석하기 위하여 다음과 같이 통계 분석을 실시하였다.

시험제품 도포부위의 사용 전, 후의 측정값에 대하여 Shapiro-Wilk test로 정규성 검정을 실시하였고, 정규성을 만족하는 경우 paired t -test, 정규성을 만족하지 않는 경우 Wilcoxon signed-rank test 분석을 실시하였다. 단, 시험제품 도포부위의 사용 전, 후, 특수 조건 후(지속, 환경, 세정 등)의 측정값에는 정규성 검정 없이 Repeated measures ANOVA 분석을 실시하였다.

시험부위, 대조부위 혹은 도포부위, 무도포부위의 비교 평가 시, 평가 시점이 2개월 경우 사용 전, 후의 측정값에 대하여 Shapiro-Wilk test로 정규성 검정을 실시하였고, 정규성을 만족하는 경우 Independent t -test로, 정규성을 만족하지 못하는 경우 Mann-Whitney U test로 분석을 실시하였다. 혈행, 붓기 항목(전체적으로 평균이 개선되었는지 확인)의 측정값에는

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



ANCOVA 분석을 실시하였다. 평가 시점이 3개 이상일 경우에는 정규성 검정 없이 Repeated measures ANOVA 분석을 실시하였다.

시험결과 분석에 사용된 사용 전, 후 측정값에 대하여 각 항목별 개선율은 다음의 공식을 이용하여 산출하였다.

$$\text{개선율(\%)} = \frac{|\text{사용 후 측정값} - \text{사용 전 측정값}|}{\text{사용 전 측정값}} \times 100$$

시험결과 분석에 사용된 대조제품 도포부위 대비 시험제품 도포부위의 개선율(%) 배수는 다음의 공식을 이용하여 산출하였다.

$$\text{대조제품 도포부위 대비 시험제품 도포부위 개선율(\%)} \text{ 배수} = \frac{\text{시험제품 도포부위 개선율(\%)}}{\text{대조제품 도포부위 개선율(\%)}}$$

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



Ⅵ. 결과보고

1. 피시험자 기본정보

본 시험에 참가한 피시험자의 정보는 다음과 같다(표 1).

표 1. 피시험자 기본정보

등록 피시험자	22명
최종 완료 피시험자	22명
성별	여성
평균연령	50.77세
표준편차	5.98

본 시험에 참가한 피시험자 별 연령은 그림 8과 같다(세부자료는 별첨 1 참조).

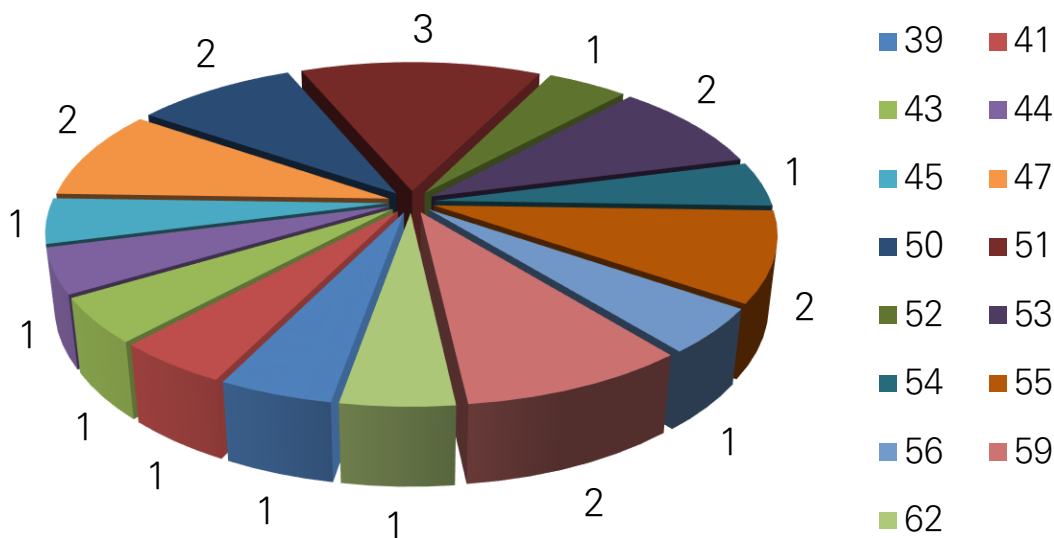


그림 8. 피시험자 연령분포.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



2. 시험제품 사용 전후의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력 개선 평가

시험결과, 사용 전과 비교하여 시험제품 A+C 도포부위와 시험제품 B+C 도포부위 모두 1회 사용 직후 통계적으로 유의하게($p<.001$) 증가하였다. 또한 시험제품 B+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+C 도포부위에서 1회 사용 직후 통계적으로 유의하게($p<.001$) 증가하여, 시험제품이 볼/턱라인부위 탄력 개선에 도움을 주는 것으로 판단된다(표 2~7, 그림 9~12).

표 2. R2 값 변화 (N=22)

	볼부위			
	시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
평균	63.50	66.10	64.29	66.02
표준편차	5.24	5.31	5.04	5.24
	턱라인부위			
	시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
평균	71.00	73.63	70.59	72.10
표준편차	6.44	6.46	5.96	5.86

%

표 3. ΔR2 값 변화 (N=22)

	볼부위		턱라인부위	
	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위
	ΔR2 ₁	ΔR2 ₁	ΔR2 ₁	ΔR2 ₁
평균	2.61	1.73	2.62	1.52
표준편차	0.67	0.60	0.70	0.36

ΔR2₁=1회 사용 직후-사용 전

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

표 4. R2 값 개선율(%)

	볼부위		턱라인부위	
	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후	1회 사용 직후	1회 사용 직후
개선율(%)	4.11	2.69	3.69	2.15

표 5. 시험제품 B+C 도포부위에 대한 시험제품 A+C 도포부위의 R2 값 개선율(%) 배수

	볼부위	턱라인부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후
배수	1.53	1.72

표 6. R2 값 통계분석

	볼부위		턱라인부위	
	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후	1회 사용 직후	1회 사용 직후
p-value	.000***	.000***	.000***	.000***

*p < .05 **p < .01 ***p < .001: p-value is measured by paired t-test

표 7. 시험제품 B+C 도포부위에 대한 시험제품 A+C 도포부위의 ΔR2 값 통계분석

	볼부위	턱라인부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후
p-value	.000***	.000***

*p < .05 **p < .01 ***p < .001: p-value is measured by Independent t-test

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

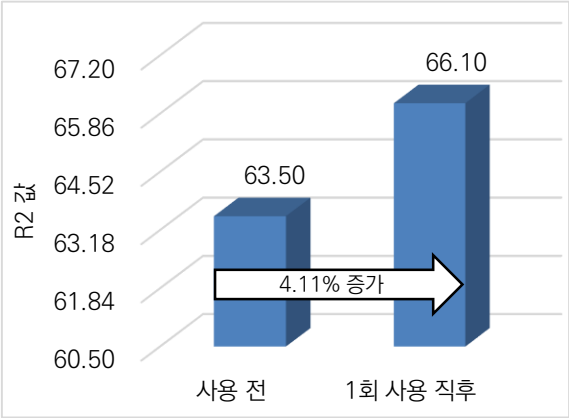


그림 9. 시험제품 A+C 도포부위 R2 값 변화 및 개선율(%)(볼부위).

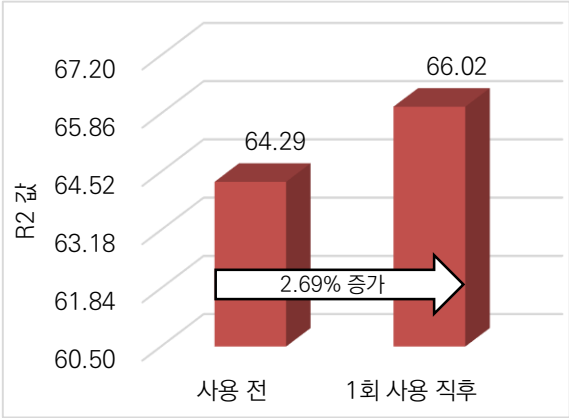


그림 10. 시험제품 B+C 도포부위 R2 값 변화 및 개선율(%)(볼부위).

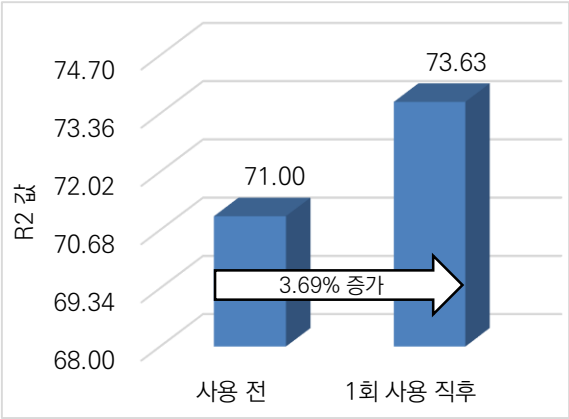


그림 11. 시험제품 A+C 도포부위 R2 값 변화 및 개선율(%)(턱라인부위).

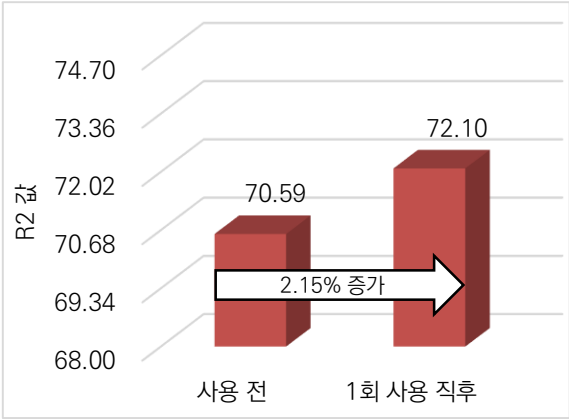


그림 12. 시험제품 B+C 도포부위 R2 값 변화 및 개선율(%)(턱라인부위).

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



3. 시험제품 사용 전후의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도) 개선 평가

시험결과, 사용 전과 비교하여 시험제품 A+C 도포부위와 시험제품 B+C 도포부위 모두 1회 사용 직후 통계적으로 유의하게($p<.05$) 감소하여, 시험제품이 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도) 개선에 도움을 주는 것으로 판단된다. 또한 볼부위에서 시험제품 B+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+C 도포부위에서 1회 사용 직후 개선율 간 차이는 있으나 통계적으로 유의한 수준은 아니었으며, 턱라인부위에서 시험제품 B+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+C 도포부위에서 1회 사용 직후 통계적으로 유의하게($p<.01$) 감소하였다(표 8~13, 그림 13~16).

표 8. 피부 각도 변화 (N=22)

	볼부위			
	시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
평균	28.32	27.35	29.30	28.77
표준편차	5.14	5.22	5.22	5.43
	턱라인부위			
	시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
평균	83.54	81.71	83.82	82.97
표준편차	3.06	3.97	5.16	5.01

degree (°)

표 9. Δ피부 각도 변화 (N=22)

	볼부위		턱라인부위	
	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위
	Δ피부 각도 ₁	Δ피부 각도 ₁	Δ피부 각도 ₁	Δ피부 각도 ₁
평균	-0.97	-0.53	-1.83	-0.85
표준편차	1.68	1.00	1.43	0.84

Δ피부 각도₁=1회 사용 직후-사용 전

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

표 10. 피부 각도 개선율(%)

	볼부위		턱라인부위	
	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후	1회 사용 직후	1회 사용 직후
개선율(%)	3.41	1.82	2.19	1.01

표 11. 시험제품 B+C 도포부위에 대한 시험제품 A+C 도포부위의 피부 각도 개선율(%) 배수

	볼부위	턱라인부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후
배수	1.88	2.16

표 12. 피부 각도 통계분석

	볼부위		턱라인부위	
	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후	1회 사용 직후	1회 사용 직후
p-value	.014*	.021*	.000***	.000***

*p < .05 **p < .01 ***p < .001: p-value is measured by paired t-test

표 13. 시험제품 B+C 도포부위에 대한 시험제품 A+C 도포부위의 Δ피부 각도 통계분석

	볼부위	턱라인부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후
p-value	.306	.008**

*p < .05 **p < .01 ***p < .001: p-value is measured by Independent t-test

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

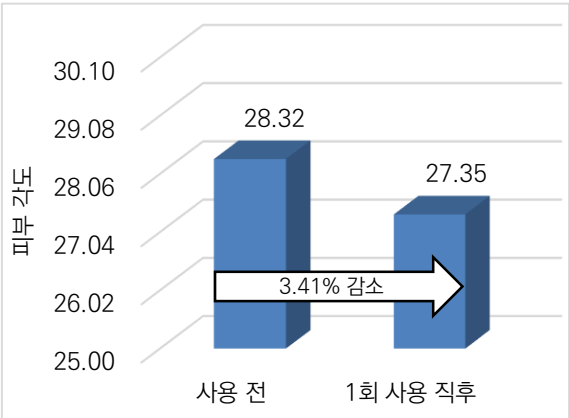


그림 13. 시험제품 A+C 도포부위 피부 각도 변화 및 개선율(%) (볼부위).

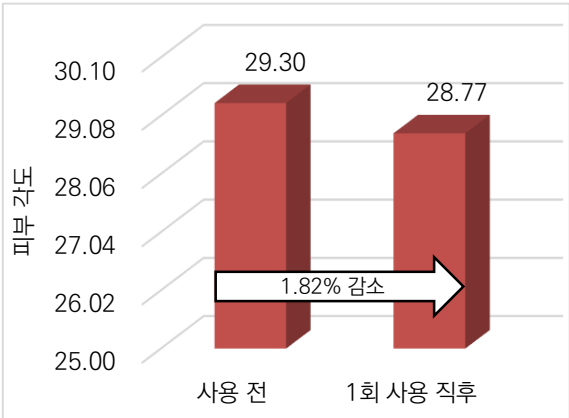


그림 14. 시험제품 B+C 도포부위 피부 각도 변화 및 개선율(%) (볼부위).

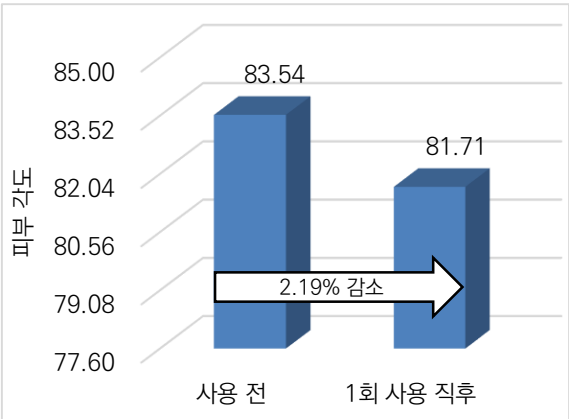


그림 15. 시험제품 A+C 도포부위 피부 각도 변화 및 개선율(%) (턱라인부위).

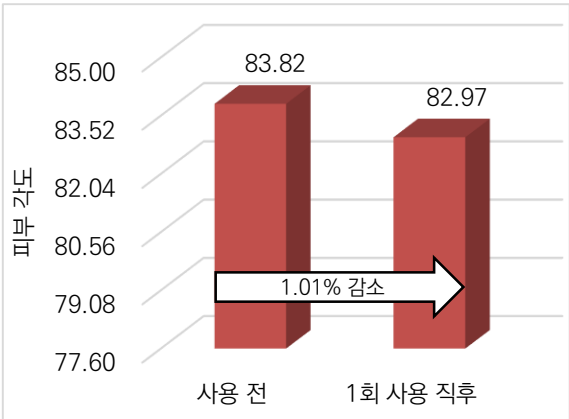


그림 16. 시험제품 B+C 도포부위 피부 각도 변화 및 개선율(%) (턱라인부위).

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



4. 시험제품 사용 전후의 디바이스 2종의 피부 광채(윤기) 개선 평가

시험결과, 사용 전과 비교하여 시험제품 A+C 도포부위와 시험제품 B+C 도포부위 모두 1회 사용 직후 통계적으로 유의하게($p < .001$) 증가하였다. 또한 시험제품 B+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+C 도포부위에서 1회 사용 직후 통계적으로 유의하게($p < .05$) 증가하여, 시험제품이 피부 광채(윤기) 개선에 도움을 주는 것으로 판단된다(표 14~19, 그림 17, 18).

표 14. intensity 값 변화 (N=22)

	시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
평균	5.32	8.94	5.65	8.05
표준편차	1.97	2.23	2.15	2.13

표 15. Δintensity 값 변화 (N=22)

	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위
	Δintensity ₁	Δintensity ₁
평균	3.61	2.40
표준편차	1.64	1.46

Δintensity₁=1회 사용 직후-사용 전

표 16. intensity 값 개선율(%)

	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후
개선율(%)	67.90	42.50

표 17. 시험제품 B+C 도포부위에 대한 시험제품 A+C 도포부위의 intensity 값 개선율(%) 배수

	1회 사용 직후
배수	1.60

표 18. intensity 값 통계분석

	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후
p-value	.000***	.000***

* $p < .05$ ** $p < .01$ *** $p < .001$: p-value is measured by paired t-test

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

표 19. 시험제품 B+C 도포부위에 대한 시험제품 A+C 도포부위의 Δ intensity 값 통계분석

	1회 사용 직후
p-value	.013*

*p < .05 **p < .01 ***p < .001: p-value is measured by Independent t-test

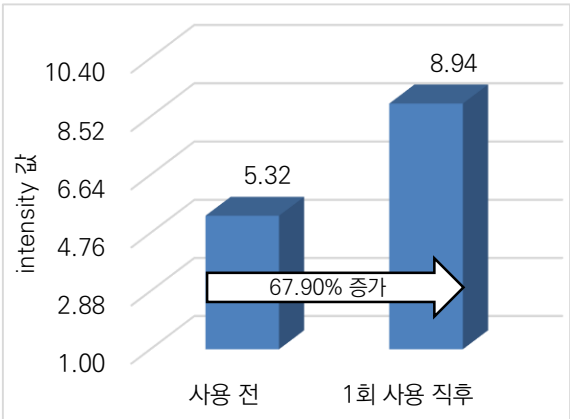


그림 17. 시험제품 A+C 도포부위 intensity 값 변화 및 개선율(%).

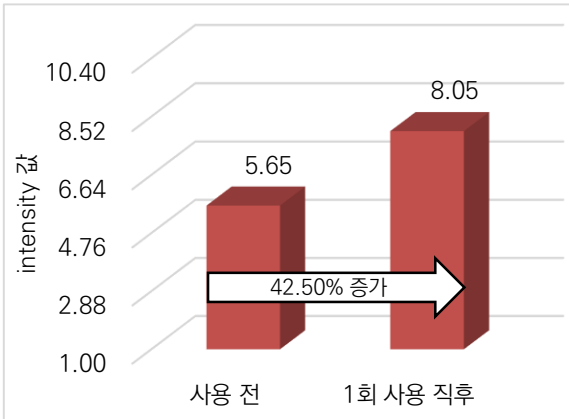


그림 18. 시험제품 B+C 도포부위 intensity 값 변화 및 개선율(%).

5. 시험제품 사용 전후의 디바이스 2종의 피부 겉보습 개선 평가

시험결과, 사용 전과 비교하여 시험제품 A+C 도포부위와 시험제품 B+C 도포부위 모두 1회 사용 직후 통계적으로 유의하게(p < .001) 증가하였다. 또한 시험제품 B+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+C 도포부위에서 1회 사용 직후 통계적으로 유의하게(p < .001) 증가하여, 시험제품이 피부 겉보습 개선에 도움을 주는 것으로 판단된다(표 20~25, 그림 19, 20).

표 20. 피부 수분 변화 (N=22)

	시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
평균	22.42	54.96	21.88	43.00
표준편차	4.06	4.88	4.29	8.48

ϵ =Epsilon

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

표 21. Δ피부 수분 변화 (N=22)

	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위
	Δ피부 수분 ₁	Δ피부 수분 ₁
평균	32.55	21.13
표준편차	5.88	7.74

Δ피부 수분₁=1회 사용 직후-사용 전

표 22. 피부 수분 개선율(%)

	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후
개선율(%)	145.19	96.56

표 23. 시험제품 B+C 도포부위에 대한 시험제품 A+C 도포부위의 피부 수분 개선율(%) 배수

	1회 사용 직후
배수	1.50

표 24. 피부 수분 통계분석

	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후
p-value	.000***	.000***

*p < .05 **p < .01 ***p < .001: p-value is measured by paired t-test

표 25. 시험제품 B+C 도포부위에 대한 시험제품 A+C 도포부위의 Δ피부 수분 통계분석

	1회 사용 직후
p-value	.000***

*p < .05 **p < .01 ***p < .001: p-value is measured by Independent t-test

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

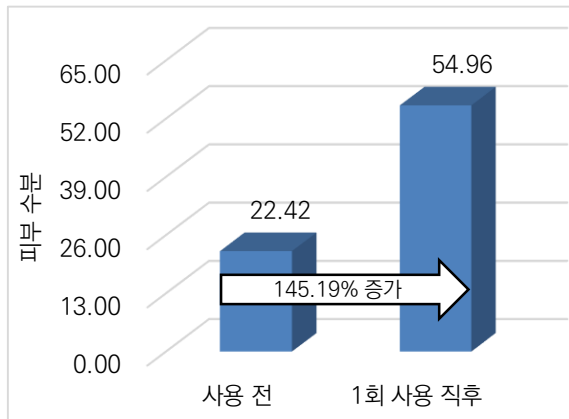


그림 19. 시험제품 A+C 도포부위 피부 수분 변화 및 개선율(%).

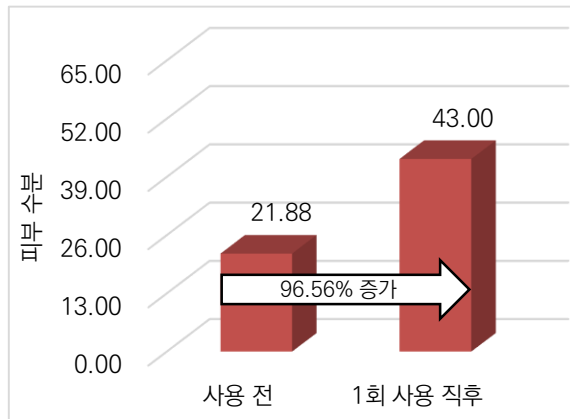


그림 20. 시험제품 B+C 도포부위 피부 수분 변화 및 개선율(%).

6. 시험제품 사용 전후의 디바이스 2종의 피부 속보습 개선 평가

시험결과, 사용 전과 비교하여 시험제품 A+C 도포부위와 시험제품 B+C 도포부위 모두 1회 사용 직후 통계적으로 유의하게($p<.001$) 증가하였다. 또한 시험제품 B+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+C 도포부위에서 1회 사용 직후 통계적으로 유의하게($p<.001$) 증가하여, 시험제품이 피부 속보습 개선에 도움을 주는 것으로 판단된다(표 26~31, 그림 21, 22).

표 26. 피부 수분 변화 (N=22)

	시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
평균	46.09	49.59	46.14	48.41
표준편차	4.50	4.67	4.25	4.47

%

표 27. Δ피부 수분 변화 (N=22)

	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위
	Δ피부 수분 ₁	Δ피부 수분 ₁
평균	3.50	2.27
표준편차	1.06	0.94

Δ피부 수분₁=1회 사용 직후-사용 전

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

표 28. 피부 수분 개선율(%)

	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후
개선율(%)	7.59	4.93

표 29. 시험제품 B+C 도포부위에 대한 시험제품 A+C 도포부위의 피부 수분 개선율(%) 배수

	1회 사용 직후
배수	1.54

표 30. 피부 수분 통계분석

	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후
p-value	.000***	.000***

*p < .05 **p < .01 ***p < .001: p-value is measured by Wilcoxon signed-rank test

표 31. 시험제품 B+C 도포부위에 대한 시험제품 A+C 도포부위의 Δ피부 수분 통계분석

	1회 사용 직후
p-value	.000***

*p < .05 **p < .01 ***p < .001: p-value is measured by Mann-Whitney U test

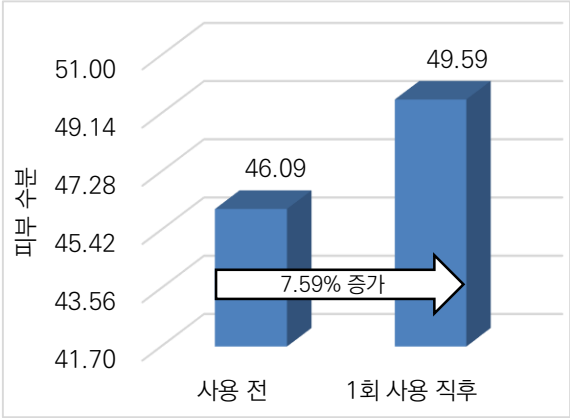


그림 21. 시험제품 A+C 도포부위 피부 수분 변화 및 개선율(%)

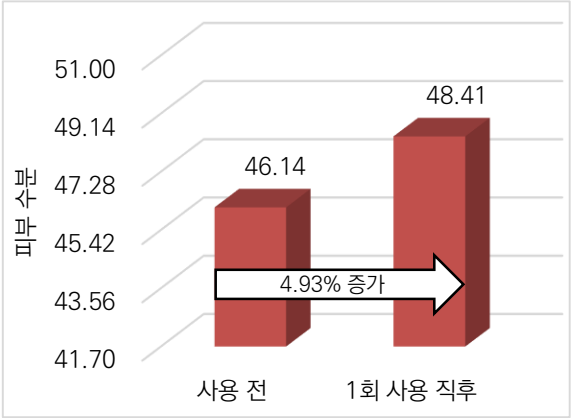


그림 22. 시험제품 B+C 도포부위 피부 수분 변화 및 개선율(%)

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



7. 시험제품 사용 전후의 디바이스 2종의 피부치밀도 개선 평가

시험결과, 사용 전과 비교하여 시험제품 A+C 도포부위와 시험제품 B+C 도포부위 모두 1회 사용 직후 통계적으로 유의하게($p < .001$) 증가하였다. 또한 시험제품 B+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+C 도포부위에서 1회 사용 직후 통계적으로 유의하게($p < .05$) 증가하여, 시험제품이 피부치밀도 개선에 도움을 주는 것으로 판단된다(표 32~37, 그림 23, 24).

표 32. Density 값 변화 (N=22)

	시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
평균	8.61	9.54	8.63	9.19
표준편차	1.62	1.68	1.64	1.60

%

표 33. ΔDensity 값 변화 (N=22)

	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위
	ΔDensity ₁	ΔDensity ₁
평균	0.93	0.56
표준편차	0.53	0.41

ΔDensity₁=1회 사용 직후-사용 전

표 34. Density 값 개선율(%)

	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후
개선율(%)	10.81	6.51

표 35. 시험제품 B+C 도포부위에 대한 시험제품 A+C 도포부위의 Density 값 개선율(%) 배수

	1회 사용 직후
배수	1.66

표 36. Density 값 통계분석

	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후
p-value	.000***	.000***

* $p < .05$ ** $p < .01$ *** $p < .001$: p-value is measured by paired t-test

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

표 37. 시험제품 B+C 도포부위에 대한 시험제품 A+C 도포부위의 ΔDensity 값 통계분석

	1회 사용 직후
p-value	.013*

*p < .05 **p < .01 ***p < .001: p-value is measured by Independent t-test

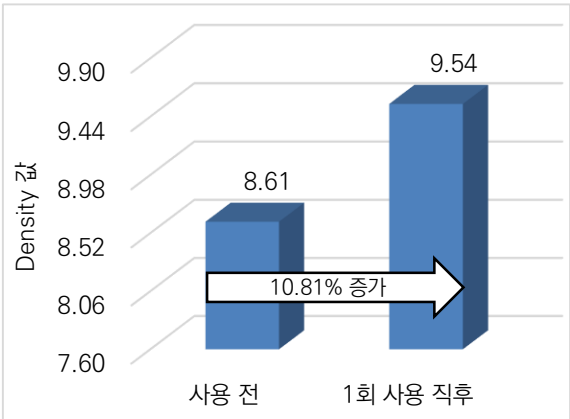


그림 23. 시험제품 A+C 도포부위 Density 값 변화 및 개선율(%).

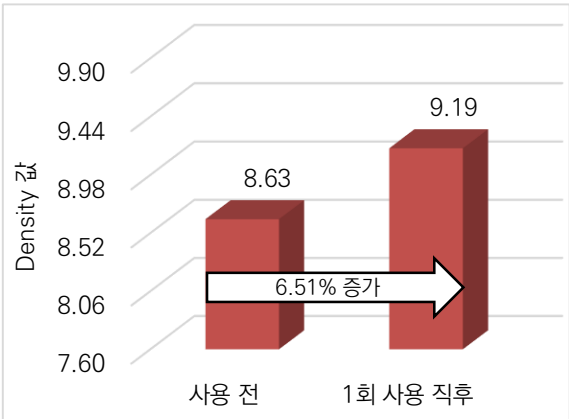


그림 24. 시험제품 B+C 도포부위 Density 값 변화 및 개선율(%).

8. 시험제품 사용 전후의 디바이스 2종의 피부 거칠기(결) 개선 평가

시험결과, 사용 전과 비교하여 시험제품 A+C 도포부위와 시험제품 B+C 도포부위 모두 1회 사용 직후 통계적으로 유의하게(p<.001) 감소하였다. 또한 시험제품 B+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+C 도포부위에서 1회 사용 직후 통계적으로 유의하게(p<.05) 감소하여, 시험제품이 피부 거칠기(결) 개선에 도움을 주는 것으로 판단된다(표 38~43, 그림 25, 26).

표 38. Texture small 값 변화 (N=22)

	시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
평균	7.33	6.55	7.08	6.56
표준편차	1.14	0.96	1.23	1.15

A.U=Arbitrary unit

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



표 39. ΔTexture small 값 변화 (N=22)

	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위
	ΔTexture small ₁	ΔDensity ₁
평균	-0.78	-0.52
표준편차	0.37	0.38

ΔTexture small₁=1회 사용 직후-사용 전

표 40. Texture small 값 개선율(%)

	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후
개선율(%)	10.61	7.29

표 41. 시험제품 B+C 도포부위에 대한 시험제품 A+C 도포부위의 Texture small 값 개선율(%) 배수

	1회 사용 직후
배수	1.46

표 42. Texture small 값 통계분석

	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후
p-value	.000***	.000***

*p < .05 **p < .01 ***p < .001: p-value is measured by paired t-test

표 43. 시험제품 B+C 도포부위에 대한 시험제품 A+C 도포부위의 ΔTexture small 값 통계분석

	1회 사용 직후
p-value	.026*

*p < .05 **p < .01 ***p < .001: p-value is measured by Independent t-test

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

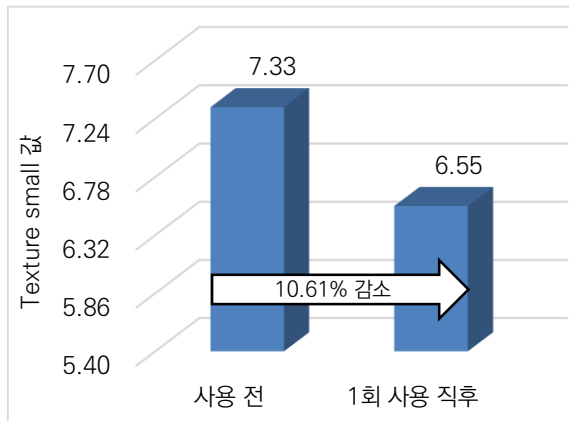


그림 25. 시험제품 A+C 도포부위 Texture small 값 변화 및 개선율(%).

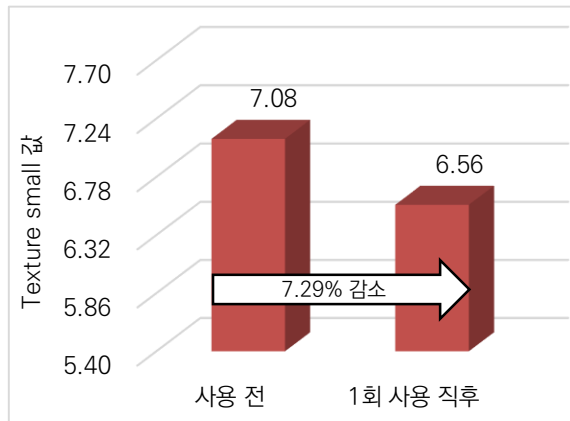


그림 26. 시험제품 B+C 도포부위 Texture small 값 변화 및 개선율(%).

9. 시험제품 사용 전후의 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력 개선 평가

시험결과, 사용 전과 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위와 시험제품 A+C 도포부위 모두 1회 사용 직후 통계적으로 유의하게($p<.001$) 증가하였다. 또한 시험제품 A+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위에서 1회 사용 직후 통계적으로 유의하게($p<.001$) 증가하여, 시험제품이 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력 개선에 도움을 주는 것으로 판단된다(표 44~49, 그림 27~30).

표 44. R2 값 변화

(N=22)

	볼부위			
	시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
평균	63.50	67.22	63.50	66.10
표준편차	5.24	5.13	5.24	5.31
	턱라인부위			
	시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
평균	71.00	74.92	71.00	73.63
표준편차	6.44	6.52	6.44	6.46

%

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

표 45. ΔR2 값 변화 (N=22)

	볼부위		턱라인부위	
	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위
	ΔR2 ₁	ΔR2 ₁	ΔR2 ₁	ΔR2 ₁
평균	3.73	2.61	3.91	2.62
표준편차	0.48	0.67	1.05	0.70

ΔR2₁=1회 사용 직후-사용 전

표 46. R2 값 개선율(%)

	볼부위		턱라인부위	
	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후	1회 사용 직후	1회 사용 직후
개선율(%)	5.87	4.11	5.51	3.69

표 47. 시험제품 A+C 도포부위에 대한 시험제품 A+B+C 도포부위의 R2 값 개선율(%) 배수

	볼부위	턱라인부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후
배수	1.43	1.49

표 48. R2 값 통계분석

	볼부위		턱라인부위	
	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후	1회 사용 직후	1회 사용 직후
p-value	.000***	.000***	.000***	.000***

*p < .05 **p < .01 ***p < .001: p-value is measured by paired t-test

표 49. 시험제품 A+C 도포부위에 대한 시험제품 A+B+C 도포부위의 ΔR2 값 통계분석

	볼부위	턱라인부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후
p-value	.000***	.000***

*p < .05 **p < .01 ***p < .001: p-value is measured by Independent t-test

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

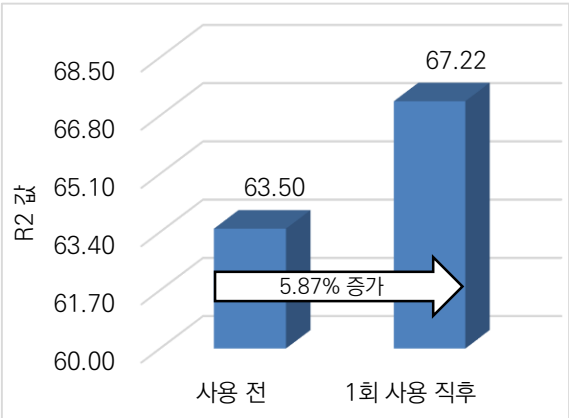


그림 27. 시험제품 A+B+C 도포부위 R2 값 변화 및 개선율(%)(볼부위).

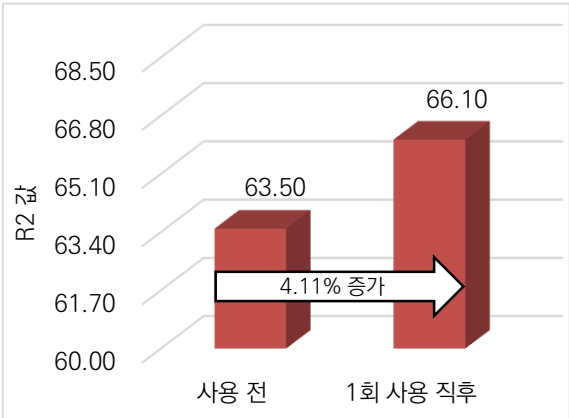


그림 28. 시험제품 A+C 도포부위 R2 값 변화 및 개선율(%)(볼부위).

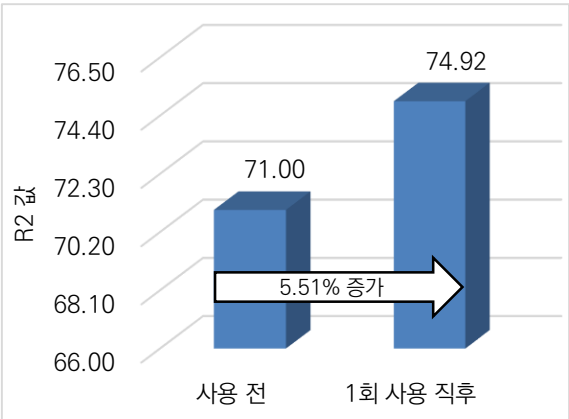


그림 29. 시험제품 A+B+C 도포부위 R2 값 변화 및 개선율(%)(턱라인부위).

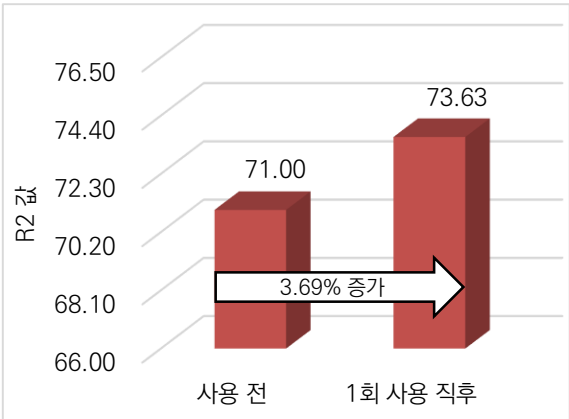


그림 30. 시험제품 A+C 도포부위 R2 값 변화 및 개선율(%)(턱라인부위).

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



10. 시험제품 사용 전후의 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도) 개선 평가

시험결과, 사용 전과 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위와 시험제품 A+C 도포부위 모두 1회 사용 직후 통계적으로 유의하게($p<.05$) 감소하여, 시험제품이 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 피부 처짐(처짐 각도) 개선에 도움을 주는 것으로 판단된다. 또한 볼부위에서 시험제품 A+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위에서 1회 사용 직후 개선을 간 차이는 있으나 통계적으로 유의한 수준은 아니었으며, 턱라인부위에서 시험제품 A+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위에서 1회 사용 직후 통계적으로 유의하게($p<.05$) 감소하였다(표 50~55, 그림 31~34).

표 50. 피부 각도 변화 (N=22)

	볼부위			
	시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
평균	28.32	26.75	28.32	27.35
표준편차	5.14	4.95	5.14	5.22
	턱라인부위			
	시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
평균	83.54	80.60	83.54	81.71
표준편차	3.06	3.99	3.06	3.97

degree (°)

표 51. Δ피부 각도 변화 (N=22)

	볼부위		턱라인부위	
	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위
	Δ피부 각도 ₁	Δ피부 각도 ₁	Δ피부 각도 ₁	Δ피부 각도 ₁
평균	-1.56	-0.97	-2.94	-1.83
표준편차	1.58	1.68	1.64	1.43

Δ피부 각도₁=1회 사용 직후-사용 전

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

표 52. 피부 각도 개선율(%)

	볼부위		턱라인부위	
	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후	1회 사용 직후	1회 사용 직후
개선율(%)	5.52	3.41	3.52	2.19

표 53. 시험제품 A+C 도포부위에 대한 시험제품 A+B+C 도포부위의 피부 각도 개선율(%) 배수

	볼부위	턱라인부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후
배수	1.62	1.61

표 54. 피부 각도 통계분석

	볼부위		턱라인부위	
	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후	1회 사용 직후	1회 사용 직후
p-value	.000***	.014*	.000***	.000***

*p < .05 **p < .01 ***p < .001: p-value is measured by paired t-test

표 55. 시험제품 A+C 도포부위에 대한 시험제품 A+B+C 도포부위의 Δ피부 각도 통계분석

	볼부위	턱라인부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후
p-value	.230	.021*

*p < .05 **p < .01 ***p < .001: p-value is measured by Independent t-test

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

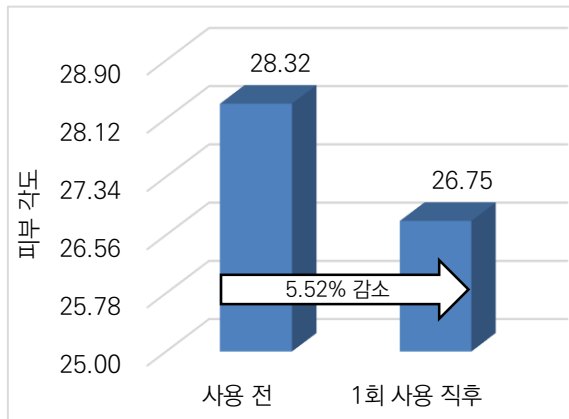


그림 31. 시험제품 A+B+C 도포부위 피부 각도 변화 및 개선율(%) (볼부위).

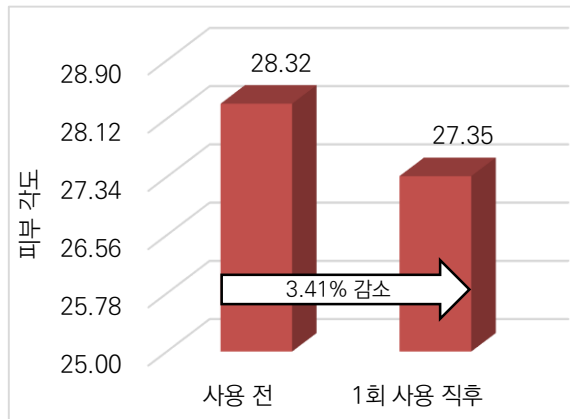


그림 32. 시험제품 A+C 도포부위 피부 각도 변화 및 개선율(%) (볼부위).

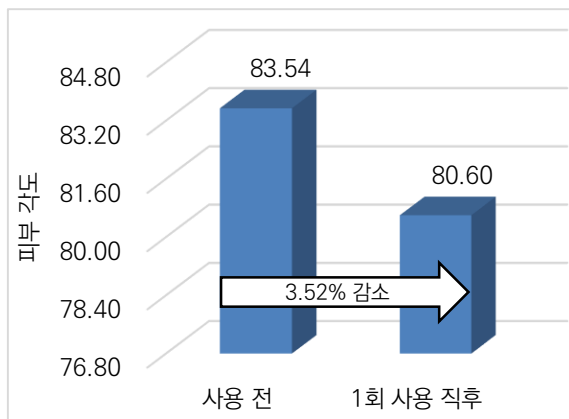


그림 33. 시험제품 A+B+C 도포부위 피부 각도 변화 및 개선율(%) (턱라인부위).

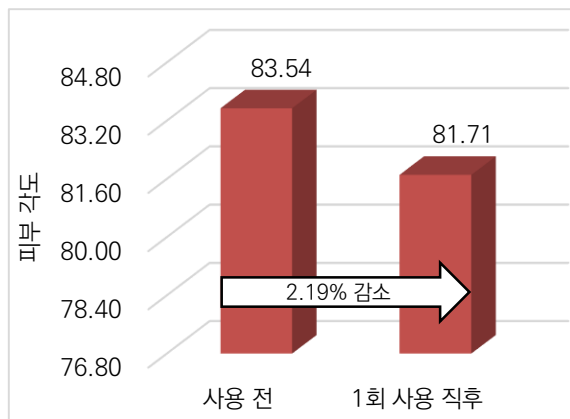


그림 34. 시험제품 A+C 도포부위 피부 각도 변화 및 개선율(%) (턱라인부위).

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



11. 시험제품 사용 전후의 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 광채(윤기) 개선 평가

시험결과, 사용 전과 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위와 시험제품 A+C 도포부위 모두 1회 사용 직후 통계적으로 유의하게($p<.001$) 증가하여, 시험제품이 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 광채(윤기) 개선에 도움을 주는 것으로 판단된다. 또한 시험제품 A+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위에서 1회 사용 직후 개선율 간 차이는 있으나 통계적으로 유의한 수준은 아니었다(표 56~61, 그림 35, 36).

표 56. intensity 값 변화 (N=22)

	시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
평균	5.32	7.82	5.32	8.94
표준편차	1.97	2.42	1.97	2.23

표 57. Δ intensity 값 변화 (N=22)

	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위
	Δ intensity ₁	Δ intensity ₁
평균	2.50	3.61
표준편차	2.77	1.64

Δ intensity₁=1회 사용 직후-사용 전

표 58. intensity 값 개선율(%)

	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후
개선율(%)	46.96	67.90

표 59. 시험제품 A+C 도포부위에 대한 시험제품 A+B+C 도포부위의 intensity 값 개선율(%) 배수

	1회 사용 직후
배수	0.69

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

표 60. intensity 값 통계분석

	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후
p-value	.000***	.000***

*p < .05 **p < .01 ***p < .001: p-value is measured by paired t-test

표 61. 시험제품 A+C 도포부위에 대한 시험제품 A+B+C 도포부위의 Δintensity 값 통계분석

	1회 사용 직후
p-value	.112

*p < .05 **p < .01 ***p < .001: p-value is measured by Independent t-test

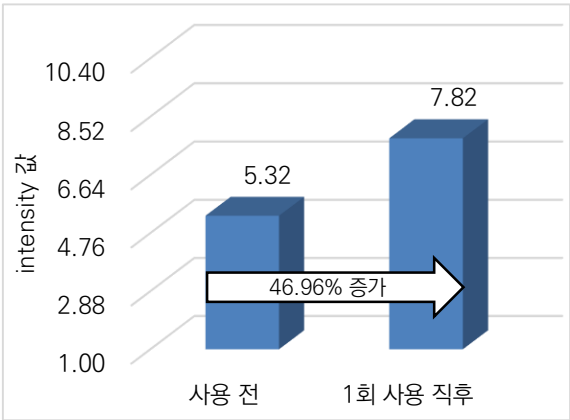


그림 35. 시험제품 A+B+C 도포부위 intensity 값 변화 및 개선율(%).

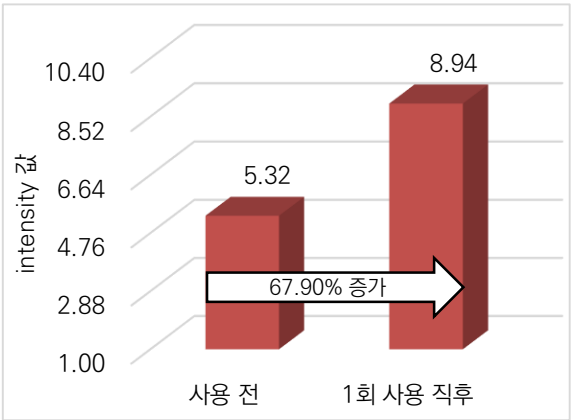


그림 36. 시험제품 A+C 도포부위 intensity 값 변화 및 개선율(%).

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



12. 시험제품 사용 전후의 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 겉보습 개선 평가

시험결과, 사용 전과 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위와 시험제품 A+C 도포부위 모두 1회 사용 직후 통계적으로 유의하게($p<.001$) 증가하였다. 또한 시험제품 A+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위에서 1회 사용 직후 통계적으로 유의하게($p<.001$) 증가하여, 시험제품이 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 겉보습 개선에 도움을 주는 것으로 판단된다(표 62~67, 그림 37, 38).

표 62. 피부 수분 변화 (N=22)

	시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
평균	22.42	61.29	22.42	54.96
표준편차	4.06	4.77	4.06	4.88

ϵ =Epsilon

표 63. Δ피부 수분 변화 (N=22)

	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위
	Δ피부 수분 ₁	Δ피부 수분 ₁
평균	38.88	32.55
표준편차	6.32	5.88

Δ피부 수분₁=1회 사용 직후-사용 전

표 64. 피부 수분 개선율(%)

	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후
개선율(%)	173.44	145.19

표 65. 시험제품 A+C 도포부위에 대한 시험제품 A+B+C 도포부위의 피부 수분 개선율(%) 배수

	1회 사용 직후
배수	1.19

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

표 66. 피부 수분 통계분석

	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후
p-value	.000***	.000***

*p < .05 **p < .01 ***p < .001: p-value is measured by paired t-test

표 67. 시험제품 A+C 도포부위에 대한 시험제품 A+B+C 도포부위의 Δ피부 수분 통계분석

	1회 사용 직후
p-value	.000***

*p < .05 **p < .01 ***p < .001: p-value is measured by Independent t-test

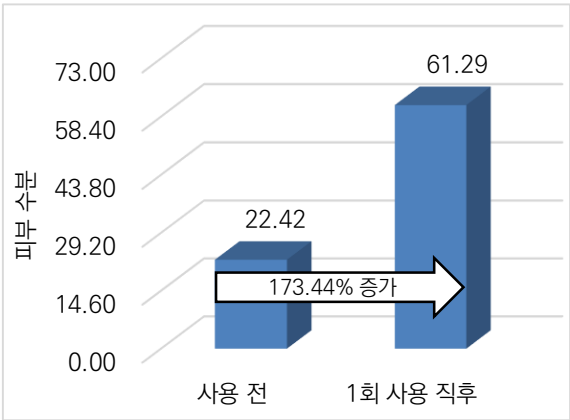


그림 37. 시험제품 A+B+C 도포부위 피부 수분 변화 및 개선율(%).

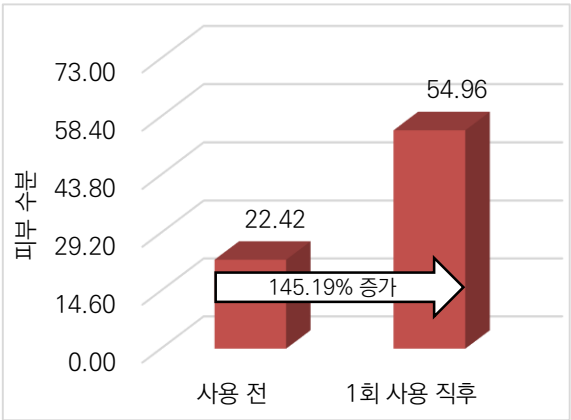


그림 38. 시험제품 A+C 도포부위 피부 수분 변화 및 개선율(%).

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



13. 시험제품 사용 전후의 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 속보습 개선 평가

시험결과, 사용 전과 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위와 시험제품 A+C 도포부위 모두 1회 사용 직후 통계적으로 유의하게($p<.001$) 증가하였다. 또한 시험제품 A+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위에서 1회 사용 직후 통계적으로 유의하게($p<.001$) 증가하여, 시험제품이 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 속보습 개선에 도움을 주는 것으로 판단된다(표 68~73, 그림 39, 40).

표 68. 피부 수분 변화 (N=22)

	시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
평균	46.09	51.27	46.09	49.59
표준편차	4.50	4.71	4.50	4.67

%

표 69. Δ피부 수분 변화 (N=22)

	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위
	Δ피부 수분 ₁	Δ피부 수분 ₁
평균	5.18	3.50
표준편차	1.22	1.06

Δ피부 수분₁=1회 사용 직후-사용 전

표 70. 피부 수분 개선율(%)

	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후
개선율(%)	11.24	7.59

표 71. 시험제품 A+C 도포부위에 대한 시험제품 A+B+C 도포부위의 피부 수분 개선율(%) 배수

	1회 사용 직후
배수	1.48

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

표 72. 피부 수분 통계분석

	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후
p-value	.000***	.000***

*p < .05 **p < .01 ***p < .001: p-value is measured by Wilcoxon signed-rank test

표 73. 시험제품 A+C 도포부위에 대한 시험제품 A+B+C 도포부위의 Δ피부 수분 통계분석

	1회 사용 직후
p-value	.000***

*p < .05 **p < .01 ***p < .001: p-value is measured by Mann-Whitney U test

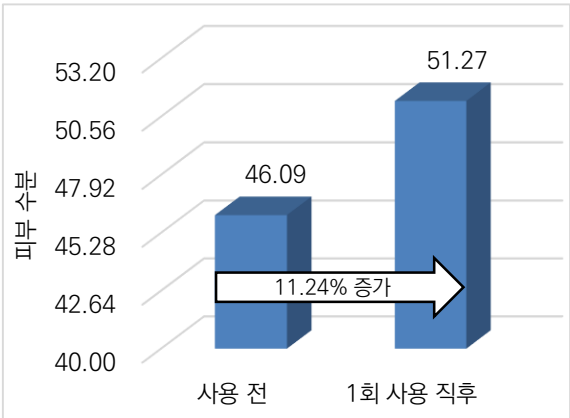


그림 39. 시험제품 A+B+C 도포부위 피부 수분 변화 및 개선율(%).

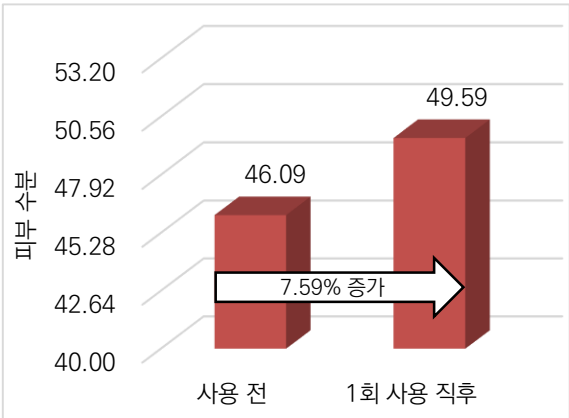


그림 40. 시험제품 A+C 도포부위 피부 수분 변화 및 개선율(%).

14. 시험제품 사용 전후의 디바이스 2종 병행 사용 시 피부치밀도 개선 평가

시험결과, 사용 전과 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위와 시험제품 A+C 도포부위 모두 1회 사용 직후 통계적으로 유의하게($p < .001$) 증가하였다. 또한 시험제품 A+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위에서 1회 사용 직후 통계적으로 유의하게($p < .05$) 증가하여, 시험제품이 디바이스 2종 병행 사용 시 피부치밀도 개선에 도움을 주는 것으로 판단된다(표 74~79, 그림 41, 42).

표 74. Density 값 변화 (N=22)

	시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
평균	8.61	9.98	8.61	9.54
표준편차	1.62	1.70	1.62	1.68

%

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



표 75. ΔDensity 값 변화 (N=22)

	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위
	ΔDensity ₁	ΔDensity ₁
평균	1.37	0.93
표준편차	0.59	0.53

ΔDensity₁=1회 사용 직후-사용 전

표 76. Density 값 개선율(%)

	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후
개선율(%)	15.89	10.81

표 77. 시험제품 A+C 도포부위에 대한 시험제품 A+B+C 도포부위의 Density 값 개선율(%) 배수

	1회 사용 직후
배수	1.47

표 78. Density 값 통계분석

	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후
p-value	.000***	.000***

*p < .05 **p < .01 ***p < .001: p-value is measured by paired t-test

표 79. 시험제품 A+C 도포부위에 대한 시험제품 A+B+C 도포부위의 ΔDensity 값 통계분석

	1회 사용 직후
p-value	.013*

*p < .05 **p < .01 ***p < .001: p-value is measured by Independent t-test

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

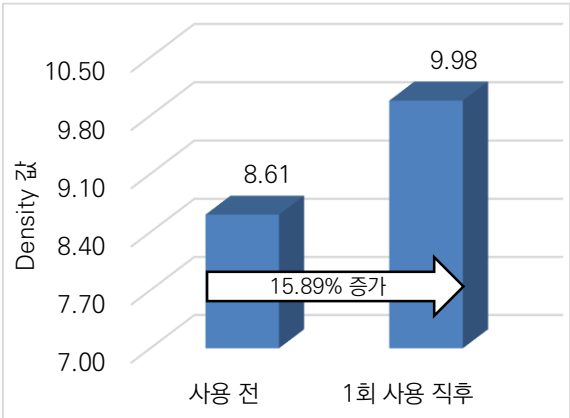


그림 41. 시험제품 A+B+C 도포부위 Density 값 변화 및 개선율(%).

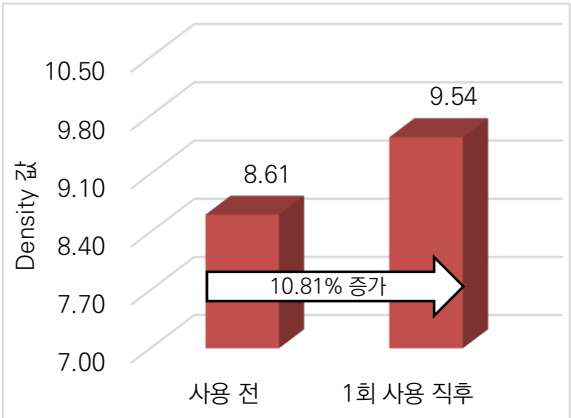


그림 42. 시험제품 A+C 도포부위 Density 값 변화 및 개선율(%).

15. 시험제품 사용 전후의 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 거칠기(결) 개선 평가

시험결과, 사용 전과 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위와 시험제품 A+C 도포부위 모두 1회 사용 직후 통계적으로 유의하게($p<.001$) 감소하였다. 또한 시험제품 A+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위에서 1회 사용 직후 통계적으로 유의하게($p<.05$) 감소하여, 시험제품이 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 거칠기(결) 개선에 도움을 주는 것으로 판단된다(표 80~85, 그림 43, 44).

표 80. Texture small 값 변화 (N=22)

	시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
평균	7.33	6.32	7.33	6.55
표준편차	1.14	0.89	1.14	0.96

A.U=Arbitrary unit

표 81. ΔTexture small 값 변화 (N=22)

	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위
	ΔTexture small ₁	ΔDensity ₁
평균	-1.01	-0.78
표준편차	0.39	0.37

ΔTexture small₁=1회 사용 직후-사용 전

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

표 82. Texture small 값 개선율(%)

	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후
개선율(%)	13.78	10.61

표 83. 시험제품 A+C 도포부위에 대한 시험제품 A+B+C 도포부위의 Texture small 값 개선율(%) 배수

	1회 사용 직후
배수	1.30

표 84. Texture small 값 통계분석

	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위
	1회 사용 직후	1회 사용 직후
p-value	.000***	.000***

*p < .05 **p < .01 ***p < .001: p-value is measured by paired t-test

표 85. 시험제품 A+C 도포부위에 대한 시험제품 A+B+C 도포부위의 ΔTexture small 값 통계분석

	1회 사용 직후
p-value	.048*

*p < .05 **p < .01 ***p < .001: p-value is measured by Independent t-test

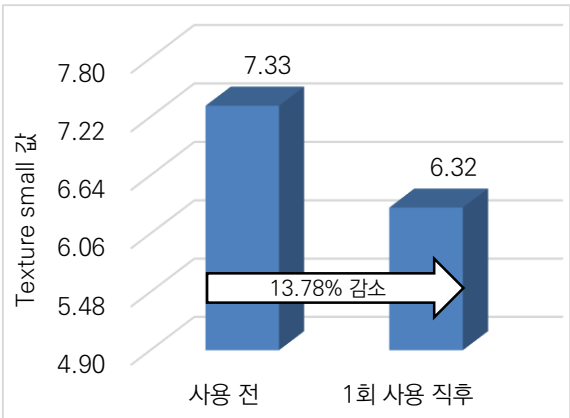


그림 43. 시험제품 A+B+C 도포부위 Texture small 값 변화 및 개선율(%)

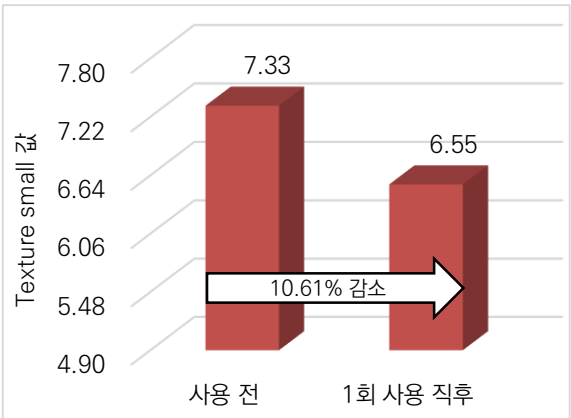


그림 44. 시험제품 A+C 도포부위 Texture small 값 변화 및 개선율(%)

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



16. 피부이상반응 평가

1) 시험담당자에 의한 피부이상반응 평가

피시험자에게 시험제품을 사용한 후 알레르기성 접촉 피부염(allergic contact dermatitis)이나 자극성 접촉 피부염(irritant contact dermatitis)에 대한 이상반응은 관찰되지 않았다.

2) 피시험자 설문조사에 의한 피부이상반응 보고

시험담당자에 의한 이상반응 평가와는 별도로, 피시험자를 대상으로 설문조사를 한 결과 피시험자가 보고한 피부이상반응은 다음과 같다(표 86). 피시험자를 대상으로 한 설문조사에서 특별한 피부이상반응은 관찰되지 않았다.

(시험기간 중 시험담당자는 피시험자의 안전을 최우선으로 생각하며 시험을 진행하였다. 피시험자에게는 본 시험 또는 시험제품에 의해 피부이상반응이 발생하였을 경우, 필요한 검사 및 치료를 시험의뢰기관에 요구할 수 있음을 사전 고지하였다.)

표 86. 피시험자가 보고한 피부이상반응 (N=22)

이상반응	1회 사용 직후	이상반응	1회 사용 직후
1. 홍반(붉어짐)	0	5. 자통(통증)	0
2. 부종(부어오름)	0	6. 작열감	0
3. 인설(각질)	0	7. 뻣뻣함	0
4. 가려움	0	8. 따끔거림	0

0: 없음, 1: 약한 정도, 2: 중간 정도, 3: 심한 정도
-부작용 등 발생사례 : 0
-부작용 발생에 따른 치료 및 보상 조치 내역 : 0

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

17. 피시험자의 시험제품 사용 전후에 대한 주관적 설문조사

1) 피시험자의 시험제품 사용 전 설문조사

표 87. 일반적 피부상태 특성 (N=22)

문항	빈도	백분율(%)	
피부타입	지성	0	0.0
	중성(정상피부)	0	0.0
	복합성(T존 지성, U존 건성)	0	0.0
	건성	22	100.0
	예민성	0	0.0
합계	22	100.0	

표 88. 시험제품 사용 전 피부상태 (N=22)

문항		빈도	백분율(%)
볼부위 피부가 탱탱하게 탄력 있는 편이다	전혀 그렇지 않다	17	77.3
	그렇지 않다	5	22.7
	보통이다	0	0.0
	그렇다	0	0.0
	매우 그렇다	0	0.0
턱라인부위 피부가 탱탱하게 탄력 있는 편이다	전혀 그렇지 않다	13	59.1
	그렇지 않다	9	40.9
	보통이다	0	0.0
	그렇다	0	0.0
	매우 그렇다	0	0.0
볼부위 피부가 처짐없이 탱탱한 편이다	전혀 그렇지 않다	13	59.1
	그렇지 않다	9	40.9
	보통이다	0	0.0
	그렇다	0	0.0
	매우 그렇다	0	0.0

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



턱라인부위 피부가 처짐없이 탱탱한 편이다	전혀 그렇지 않다	18	81.8
	그렇지 않다	4	18.2
	보통이다	0	0.0
	그렇다	0	0.0
	매우 그렇다	0	0.0
피부에 건강한 광채가 나는 편이다	전혀 그렇지 않다	16	72.7
	그렇지 않다	6	27.3
	보통이다	0	0.0
	그렇다	0	0.0
	매우 그렇다	0	0.0
피부가 촉촉하고 수분감이 오래 유지되는 편이다	전혀 그렇지 않다	14	63.6
	그렇지 않다	8	36.4
	보통이다	0	0.0
	그렇다	0	0.0
	매우 그렇다	0	0.0
피부가 속부터 수분감이 가득한 편이다	전혀 그렇지 않다	15	68.2
	그렇지 않다	7	31.8
	보통이다	0	0.0
	그렇다	0	0.0
	매우 그렇다	0	0.0
피부가 촘촘히 메워져 있는 편이다	전혀 그렇지 않다	18	81.8
	그렇지 않다	4	18.2
	보통이다	0	0.0
	그렇다	0	0.0
	매우 그렇다	0	0.0
피부결이 거칠지 않고 매끈한 편이다	전혀 그렇지 않다	14	63.6
	그렇지 않다	8	36.4
	보통이다	0	0.0
	그렇다	0	0.0
	매우 그렇다	0	0.0
합계		22	100.0

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



2) 피시험자의 시험제품 사용 후 설문조사

표 89. 시험제품 A 사용감 (N=22)

문항		1회 사용 직후	
		빈도	백분율(%)
사용의 편리성	만족	22	100.0
	불만족	0	0.0
유지, 관리, 보관의 편리성	만족	22	100.0
	불만족	0	0.0
효과에 대한 만족감	만족	22	100.0
	불만족	0	0.0
사용감에 관한 전체적인 만족도	만족	22	100.0
	불만족	0	0.0

표 90. 시험제품 B 사용감 (N=22)

문항		1회 사용 직후	
		빈도	백분율(%)
사용의 편리성	만족	22	100.0
	불만족	0	0.0
유지, 관리, 보관의 편리성	만족	22	100.0
	불만족	0	0.0
효과에 대한 만족감	만족	22	100.0
	불만족	0	0.0
사용감에 관한 전체적인 만족도	만족	22	100.0
	불만족	0	0.0

표 91. 시험제품 C 사용감 (N=22)

문항		1회 사용 직후	
		빈도	백분율(%)
탄력감	만족	22	100.0
	불만족	0	0.0
광채	만족	22	100.0
	불만족	0	0.0

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



'하이소닉 초음파 디바이스 외 2종'의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도),
 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(겉) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력,
 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(겉) 개선에 대한 인체적용시험

보습감	만족	22	100.0
	불만족	0	0.0
사용감에 관한 전체적인 만족도	만족	22	100.0
	불만족	0	0.0

표 92. 시험제품 사용 후 피부상태 (N=22)

문항	1회 사용 직후	
	빈도	백분율(%)
볼부위 피부에 탄력이 생겨 탱탱해진 것 같다	전혀 그렇지 않다	0 0.0
	그렇지 않다	0 0.0
	보통이다	0 0.0
	그렇다	5 22.7
	매우 그렇다	17 77.3
턱라인부위 피부에 탄력이 생겨 탱탱해진 것 같다	전혀 그렇지 않다	0 0.0
	그렇지 않다	0 0.0
	보통이다	0 0.0
	그렇다	6 27.3
	매우 그렇다	16 72.7
볼부위 처진 피부가 탱탱해진 것 같다	전혀 그렇지 않다	0 0.0
	그렇지 않다	0 0.0
	보통이다	0 0.0
	그렇다	6 27.3
	매우 그렇다	16 72.7
턱라인부위 처진 피부가 탱탱해진 것 같다	전혀 그렇지 않다	0 0.0
	그렇지 않다	0 0.0
	보통이다	0 0.0
	그렇다	4 18.2
	매우 그렇다	18 81.8
피부에 건강한 광채가 나는 것 같다	전혀 그렇지 않다	0 0.0
	그렇지 않다	0 0.0
	보통이다	0 0.0
	그렇다	6 27.3
	매우 그렇다	16 72.7

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



'하이소닉 초음파 디바이스 외 2종'의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도),
 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력,
 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 개선에 대한 인체적용시험

피부의 촉촉함이 오래 지속되는 것 같다	전혀 그렇지 않다	0	0.0
	그렇지 않다	0	0.0
	보통이다	0	0.0
	그렇다	6	27.3
	매우 그렇다	16	72.7
피부가 속부터 수분감이 느껴지는 것 같다	전혀 그렇지 않다	0	0.0
	그렇지 않다	0	0.0
	보통이다	0	0.0
	그렇다	6	27.3
	매우 그렇다	16	72.7
피부가 촘촘히 메워진 것 같다	전혀 그렇지 않다	0	0.0
	그렇지 않다	0	0.0
	보통이다	0	0.0
	그렇다	4	18.2
	매우 그렇다	18	81.8
거친 피부결이 매끄러워진 것 같다	전혀 그렇지 않다	0	0.0
	그렇지 않다	0	0.0
	보통이다	0	0.0
	그렇다	8	36.4
	매우 그렇다	14	63.6
디바이스 2종 병행 사용 시 볼부위 피부에 탄력이 생겨 탱탱해진 것 같다	전혀 그렇지 않다	0	0.0
	그렇지 않다	0	0.0
	보통이다	0	0.0
	그렇다	5	22.7
	매우 그렇다	17	77.3
디바이스 2종 병행 사용 시 턱라인부위 피부에 탄력이 생겨 탱탱해진 것 같다	전혀 그렇지 않다	0	0.0
	그렇지 않다	0	0.0
	보통이다	0	0.0
	그렇다	5	22.7
	매우 그렇다	17	77.3

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



'하이소닉 초음파 디바이스 외 2종'의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(겉) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(겉) 개선에 대한 인체적용시험

디바이스 2종 병행 사용 시 볼부위 처진 피부가 탱탱해진 것 같다	전혀 그렇지 않다	0	0.0
	그렇지 않다	0	0.0
	보통이다	0	0.0
	그렇다	8	36.4
	매우 그렇다	14	63.6
디바이스 2종 병행 사용 시 턱라인부위 처진 피부가 탱탱해진 것 같다	전혀 그렇지 않다	0	0.0
	그렇지 않다	0	0.0
	보통이다	0	0.0
	그렇다	6	27.3
	매우 그렇다	16	72.7
디바이스 2종 병행 사용 시 피부에 건강한 광채가 나는 것 같다	전혀 그렇지 않다	0	0.0
	그렇지 않다	0	0.0
	보통이다	0	0.0
	그렇다	7	31.8
	매우 그렇다	15	68.2
디바이스 2종 병행 사용 시 피부의 촉촉함이 오래 지속되는 것 같다	전혀 그렇지 않다	0	0.0
	그렇지 않다	0	0.0
	보통이다	0	0.0
	그렇다	4	18.2
	매우 그렇다	18	81.8
디바이스 2종 병행 사용 시 피부가 속부터 수분감이 느껴지는 것 같다	전혀 그렇지 않다	0	0.0
	그렇지 않다	0	0.0
	보통이다	0	0.0
	그렇다	8	36.4
	매우 그렇다	14	63.6
디바이스 2종 병행 사용 시 피부가 촘촘히 메워진 것 같다	전혀 그렇지 않다	0	0.0
	그렇지 않다	0	0.0
	보통이다	0	0.0
	그렇다	5	22.7
	매우 그렇다	17	77.3

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



'하이소닉 초음파 디바이스 외 2종'의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 개선에 대한 인체적용시험

디바이스 2종 병행 사용 시 거친 피부결이 매끄러워진 것 같다	전혀 그렇지 않다	0	0.0
	그렇지 않다	0	0.0
	보통이다	0	0.0
	그렇다	5	22.7
	매우 그렇다	17	77.3
합계		22	100.0

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

Ⅶ. 결론

한국피부과학연구원에서는 (주)제이엘유의 의뢰를 받아 성인 여성 22명의 피시험자를 대상으로 '하이소닉 초음파 디바이스 외 2종'의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 개선에 대한 인체적용시험을 진행하였다.

디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력 개선도를 분석한 결과, 시험제품 사용 전과 비교하여 통계적으로 유의한 수준으로($p < .001$) 시험제품 A+C 도포부위와 시험제품 B+C 도포부위 모두 1회 사용 직후 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력이 개선됨을 나타냈다. 또한 시험제품 B+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+C 도포부위에서 1회 사용 직후 통계적으로 유의한 수준으로($p < .001$) 볼/턱라인부위 탄력이 개선됨을 나타냈다.

디바이스 2종의 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도) 개선도를 분석한 결과, 시험제품 사용 전과 비교하여 통계적으로 유의한 수준으로($p < .05$) 시험제품 A+C 도포부위와 시험제품 B+C 도포부위 모두 1회 사용 직후 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도)이 개선됨을 나타냈다. 또한 볼부위에서 시험제품 B+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+C 도포부위에서 1회 사용 직후 개선율 간 차이는 있으나 통계적으로 유의한 수준은 아니었으며, 턱라인부위에서 시험제품 B+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+C 도포부위에서 1회 사용 직후 통계적으로 유의한 수준으로($p < .01$) 나타나, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도)이 개선됨을 나타냈다.

디바이스 2종의 피부 광채(윤기) 개선도를 분석한 결과, 시험제품 사용 전과 비교하여 통계적으로 유의한 수준으로($p < .001$) 시험제품 A+C 도포부위와 시험제품 B+C 도포부위 모두 1회 사용 직후 디바이스 2종의 피부 광채(윤기)가 개선됨을 나타냈다. 또한 시험제품 B+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+C 도포부위에서 1회 사용 직후 통계적으로 유의한 수준으로($p < .05$) 피부 광채(윤기)가 개선됨을 나타냈다.

디바이스 2종의 피부 겉보습 개선도를 분석한 결과, 시험제품 사용 전과 비교하여 통계적으로 유의한 수준으로($p < .001$) 시험제품 A+C 도포부위와 시험제품 B+C 도포부위 모두 1회 사용 직후 디바이스 2종의 피부 겉보습이 개선됨을 나타냈다. 또한 시험제품 B+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+C 도포부위에서 1회 사용 직후 통계적으로 유의한 수준으로($p < .001$) 피부 겉보습이

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



개선됨을 나타냈다.

디바이스 2종의 피부 속보습 개선도를 분석한 결과, 시험제품 사용 전과 비교하여 통계적으로 유의한 수준으로($p<.001$) 시험제품 A+C 도포부위와 시험제품 B+C 도포부위 모두 1회 사용 직후 디바이스 2종의 피부 속보습이 개선됨을 나타냈다. 또한 시험제품 B+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+C 도포부위에서 1회 사용 직후 통계적으로 유의한 수준으로($p<.001$) 피부 속보습이 개선됨을 나타냈다.

디바이스 2종의 피부치밀도 개선도를 분석한 결과, 시험제품 사용 전과 비교하여 통계적으로 유의한 수준으로($p<.001$) 시험제품 A+C 도포부위와 시험제품 B+C 도포부위 모두 1회 사용 직후 디바이스 2종의 피부치밀도가 개선됨을 나타냈다. 또한 시험제품 B+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+C 도포부위에서 1회 사용 직후 통계적으로 유의한 수준으로($p<.05$) 피부치밀도가 개선됨을 나타냈다.

디바이스 2종의 피부 거칠기(결) 개선도를 분석한 결과, 시험제품 사용 전과 비교하여 통계적으로 유의한 수준으로($p<.001$) 시험제품 A+C 도포부위와 시험제품 B+C 도포부위 모두 1회 사용 직후 디바이스 2종의 피부 거칠기(결)가 개선됨을 나타냈다. 또한 시험제품 B+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+C 도포부위에서 1회 사용 직후 통계적으로 유의한 수준으로($p<.05$) 피부 거칠기(결)가 개선됨을 나타냈다.

디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력 개선도를 분석한 결과, 시험제품 사용 전과 비교하여 통계적으로 유의한 수준으로($p<.001$) 시험제품 A+B+C 도포부위와 시험제품 A+C 도포부위 모두 1회 사용 직후 볼/턱라인부위 탄력이 개선됨을 나타냈다. 또한 시험제품 A+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위에서 1회 사용 직후 통계적으로 유의한 수준으로($p<.001$) 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력이 개선됨을 나타냈다.

디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도) 개선도를 분석한 결과, 시험제품 사용 전과 비교하여 통계적으로 유의한 수준으로($p<.05$) 시험제품 A+B+C 도포부위와 시험제품 A+C 도포부위 모두 1회 사용 직후 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도)이 개선됨을 나타냈다. 또한 볼부위에서 시험제품 A+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위에서 1회 사용 직후 개선율 간 차이는 있으나 통계적으로 유의한 수준은 아니었으며, 턱라인부위에서 시험제품 A+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위에서 1회 사용 직후 통계적으로 유의한 수

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



준으로($p<.05$) 나타나, 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도)이 개선됨을 나타냈다.

디바이스 2종 병행 사용 시 피부 광채(윤기) 개선도를 분석한 결과, 시험제품 사용 전과 비교하여 통계적으로 유의한 수준으로($p<.001$) 시험제품 A+B+C 도포부위와 시험제품 A+C 도포부위 모두 1회 사용 직후 피부 광채(윤기)가 개선됨을 나타냈다. 또한 시험제품 A+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위에서 1회 사용 직후 개선율 간 차이는 있으나 통계적으로 유의한 수준은 아니었다.

디바이스 2종 병행 사용 시 피부 겉보습 개선도를 분석한 결과, 시험제품 사용 전과 비교하여 통계적으로 유의한 수준으로($p<.001$) 시험제품 A+B+C 도포부위와 시험제품 A+C 도포부위 모두 1회 사용 직후 피부 겉보습이 개선됨을 나타냈다. 또한 시험제품 A+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위에서 1회 사용 직후 통계적으로 유의한 수준으로($p<.001$) 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 겉보습이 개선됨을 나타냈다.

디바이스 2종 병행 사용 시 피부 속보습 개선도를 분석한 결과, 시험제품 사용 전과 비교하여 통계적으로 유의한 수준으로($p<.001$) 시험제품 A+B+C 도포부위와 시험제품 A+C 도포부위 모두 1회 사용 직후 피부 속보습이 개선됨을 나타냈다. 또한 시험제품 A+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위에서 1회 사용 직후 통계적으로 유의한 수준으로($p<.001$) 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 속보습이 개선됨을 나타냈다.

디바이스 2종 병행 사용 시 피부치밀도 개선도를 분석한 결과, 시험제품 사용 전과 비교하여 통계적으로 유의한 수준으로($p<.001$) 시험제품 A+B+C 도포부위와 시험제품 A+C 도포부위 모두 1회 사용 직후 피부치밀도가 개선됨을 나타냈다. 또한 시험제품 A+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위에서 1회 사용 직후 통계적으로 유의한 수준으로($p<.05$) 디바이스 2종 병행 사용 시 피부치밀도가 개선됨을 나타냈다.

디바이스 2종 병행 사용 시 피부 거칠기(결) 개선도를 분석한 결과, 시험제품 사용 전과 비교하여 통계적으로 유의한 수준으로($p<.001$) 시험제품 A+B+C 도포부위와 시험제품 A+C 도포부위 모두 1회 사용 직후 피부 거칠기(결)가 개선됨을 나타냈다. 또한 시험제품 A+C 도포부위와 비교하여 시험제품 A+B+C 도포부위에서 1회 사용 직후 통계적으로 유의한 수준으로($p<.05$) 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 거칠기(결)가 개선됨을 나타냈다.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



'하이소닉 초음파 디바이스 외 2종'의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 개선에 대한 인체적용시험

따라서 '하이소닉 초음파 디바이스 외 2종'은 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 개선에 도움을 주는 제품으로 판단된다.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

VIII. 참고문헌

김한식; 범희주. 미용과학. *청구문화사*, 2007, pp.90-350.

식품의약품안전처. 화장품 인체적용시험 및 효력시험 가이드라인, 2021.10.

식품의약품안전처. 화장품 표시·광고 실증을 위한 시험방법 가이드라인, 2020.12.

이주연; 서은경. 해양심층수 함유 화장품의 피부보습 효과. *한국인체미용예술학회지*, 2009, 10.2: 153-164.

이주희. 여고생의 생활습관에 따른 피부상태연구. *남부대학교 석사학위논문*, 2006.

이혜영, 등. 피부과학. *군자출판사*, 2007, pp58-86.

전세열, 등. 미용해부생리학. *광문각*, 2011.

정진호. 미용관련 기능성평가체계 구축. 식품의약품안전청, 2003.

조가영, 등. 모녀간 피부 특성의 상관관계에 대한 연구. *대한한방부인과학회지*, 2012, 25.4: 46-55.

하병조, 등. 화장품화학. *수문사*, 2002, pp86-90.

한승겸. 에스테티션을 위한 피부학. *정담미디어*, 2004.

한채정, 등. 피부미용학. *훈민사*, 2010.

BAUMANN, Leslie S.; BAUMANN, Leslie. *Cosmetic dermatology*. McGraw-Hill Professional Publishing, 2009.

KAHAN, V., *et al.* Stress, immunity and skin collagen integrity: evidence from animal models and clinical conditions. *Brain, behavior, and immunity*, 2009, 23.8: 1089-1095.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



MAYROVITZ, Harvey N. Assessing free and bound water in skin at 300 MHz using tissue dielectric constant measurements with the MoistureMeterD. In: *Lymphedema*. Springer, Cham, 2015. pp133-148.

SASAKI, Yukito. Skin improvement effect of volumefilling®. WORLD JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND MEDICAL RESEARCH, 2017, 3.3: 54-58.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

[별첨 1] 시험결과에 대한 세부자료

[별첨 2] 인체적용시험 사진자료

[별첨 3] 시험제품 전성분

[별첨 4] 시험제품 안전성 확인서

[별첨 5] 시험기관 연구자의 약력 및 연구경력

[별첨 6] 시험기관의 주요설비

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



[별첨 1] 시험결과에 대한 세부자료

1. 피시험자 기본정보

번호	피시험자 식별코드	연령	성별
1	2410-BDI105-001	50	여성
2	2410-BDI105-002	62	여성
3	2410-BDI105-003	50	여성
4	2410-BDI105-004	47	여성
5	2410-BDI105-005	56	여성
6	2410-BDI105-006	51	여성
7	2410-BDI105-007	51	여성
8	2410-BDI105-008	54	여성
9	2410-BDI105-009	53	여성
10	2410-BDI105-010	52	여성
11	2410-BDI105-011	41	여성
12	2410-BDI105-012	43	여성
13	2410-BDI105-013	55	여성
14	2410-BDI105-014	47	여성
15	2410-BDI105-015	45	여성
16	2410-BDI105-016	55	여성
17	2410-BDI105-017	59	여성
18	2410-BDI105-018	59	여성
19	2410-BDI105-019	44	여성
20	2410-BDI105-020	51	여성
21	2410-BDI105-021	39	여성
22	2410-BDI105-022	53	여성
평균		50.77	여성 22명
표준편차		5.98	

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



2. 기기평가

1) 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력 측정값 변화

(1) R2 값

번호	볼부위			
	시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
1	60.30	63.30	63.20	65.40
2	69.30	72.10	67.30	69.90
3	69.70	71.20	66.80	67.90
4	65.40	67.20	64.80	66.20
5	64.90	66.90	69.90	71.70
6	62.30	65.70	63.90	65.20
7	62.30	64.80	63.00	65.20
8	62.90	66.00	63.30	65.40
9	59.30	62.30	61.40	63.40
10	63.00	66.60	64.40	66.10
11	75.80	78.90	75.20	77.70
12	66.20	69.30	69.80	70.50
13	56.30	58.70	54.10	55.70
14	62.30	65.70	65.90	67.70
15	54.90	56.50	58.60	59.40
16	64.30	67.80	64.30	66.30
17	58.20	61.30	59.10	61.70
18	58.50	60.50	60.20	61.70
19	65.20	67.50	64.30	65.80
20	68.50	70.20	69.00	71.60
21	70.70	73.20	70.60	72.10
22	56.60	58.60	55.30	55.90
평균	63.50	66.10	64.29	66.02
표준편차	5.24	5.31	5.04	5.24

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



번호	턱라인부위			
	시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
1	68.50	71.50	67.20	68.50
2	65.10	67.40	64.50	66.10
3	67.10	69.30	66.30	67.50
4	71.30	73.20	70.50	72.00
5	68.30	70.90	68.00	69.50
6	73.70	75.30	75.20	76.60
7	69.20	73.00	70.90	72.60
8	70.50	73.10	72.00	74.00
9	77.40	80.00	70.80	72.60
10	72.10	75.80	73.70	75.90
11	84.30	86.90	83.90	85.10
12	83.20	86.70	78.90	79.90
13	63.10	64.70	66.30	67.70
14	62.90	65.50	61.10	62.90
15	65.80	68.90	66.00	67.30
16	68.80	71.90	63.30	65.20
17	68.80	71.30	70.80	72.70
18	61.00	63.60	62.90	64.10
19	69.50	73.00	71.70	73.40
20	71.60	74.30	70.50	72.10
21	79.00	81.60	78.40	80.00
22	80.90	81.90	80.00	80.60
평균	71.00	73.63	70.59	72.10
표준편차	6.44	6.46	5.96	5.86

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



(2) $\Delta R2$ 값

번호	볼부위		턱라인부위	
	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위
	$\Delta R2_1$	$\Delta R2_1$	$\Delta R2_1$	$\Delta R2_1$
1	3.00	2.20	3.00	1.30
2	2.80	2.60	2.30	1.60
3	1.50	1.10	2.20	1.20
4	1.80	1.40	1.90	1.50
5	2.00	1.80	2.60	1.50
6	3.40	1.30	1.60	1.40
7	2.50	2.20	3.80	1.70
8	3.10	2.10	2.60	2.00
9	3.00	2.00	2.60	1.80
10	3.60	1.70	3.70	2.20
11	3.10	2.50	2.60	1.20
12	3.10	0.70	3.50	1.00
13	2.40	1.60	1.60	1.40
14	3.40	1.80	2.60	1.80
15	1.60	0.80	3.10	1.30
16	3.50	2.00	3.10	1.90
17	3.10	2.60	2.50	1.90
18	2.00	1.50	2.60	1.20
19	2.30	1.50	3.50	1.70
20	1.70	2.60	2.70	1.60
21	2.50	1.50	2.60	1.60
22	2.00	0.60	1.00	0.60
평균	2.61	1.73	2.62	1.52
표준편차	0.67	0.60	0.70	0.36

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



2) 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도) 측정값 변화

(1) 피부 각도

번호	볼부위			
	시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
1	19.67	19.47	26.91	27.12
2	37.21	34.51	34.61	33.53
3	20.95	16.78	23.70	22.75
4	31.81	30.41	28.54	27.19
5	24.55	22.35	25.65	23.84
6	29.95	28.18	30.96	30.28
7	29.83	28.78	40.85	40.33
8	22.69	19.18	35.02	33.59
9	25.13	23.20	25.16	24.35
10	32.04	33.54	33.14	34.67
11	30.23	30.11	32.35	32.62
12	21.09	22.25	23.25	22.95
13	33.65	33.04	25.60	23.19
14	27.02	28.74	27.19	27.06
15	33.28	32.91	35.61	35.57
16	35.40	31.61	34.11	32.94
17	31.03	31.33	29.70	31.07
18	22.36	23.27	17.32	16.50
19	22.75	23.15	31.11	30.10
20	32.88	31.50	24.93	25.43
21	29.20	29.09	29.19	29.75
22	30.26	28.35	29.63	28.00
평균	28.32	27.35	29.30	28.77
표준편차	5.14	5.22	5.22	5.43

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



번호	턱라인부위			
	시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
1	85.86	82.09	87.18	86.85
2	80.22	78.34	75.23	74.15
3	77.23	75.68	83.93	82.57
4	80.19	77.57	84.75	83.37
5	84.62	83.13	83.43	82.32
6	83.46	79.92	73.79	74.30
7	84.23	82.87	81.35	80.70
8	84.70	82.32	85.46	84.71
9	87.71	88.81	87.92	88.90
10	84.38	83.55	89.31	88.51
11	85.91	83.95	81.27	81.06
12	83.13	82.50	83.35	83.07
13	85.65	83.73	80.73	80.38
14	81.72	80.94	85.41	85.16
15	79.13	73.48	75.96	74.75
16	88.67	88.64	96.92	95.39
17	86.50	85.21	83.66	82.39
18	81.35	79.59	86.55	85.12
19	80.30	77.22	85.10	84.41
20	80.91	77.96	78.19	77.28
21	84.27	83.29	86.77	85.43
22	87.72	86.83	87.71	84.44
평균	83.54	81.71	83.82	82.97
표준편차	3.06	3.97	5.16	5.01

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



(2) Δ피부 각도

번호	볼부위		턱라인부위	
	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위
	Δ피부 각도 ₁	Δ피부 각도 ₁	Δ피부 각도 ₁	Δ피부 각도 ₁
1	-0.20	0.21	-3.77	-0.33
2	-2.70	-1.08	-1.88	-1.08
3	-4.17	-0.95	-1.55	-1.36
4	-1.40	-1.35	-2.62	-1.38
5	-2.20	-1.81	-1.49	-1.11
6	-1.77	-0.68	-3.54	0.51
7	-1.05	-0.52	-1.36	-0.65
8	-3.51	-1.43	-2.38	-0.75
9	-1.93	-0.81	1.10	0.98
10	1.50	1.53	-0.83	-0.80
11	-0.12	0.27	-1.96	-0.21
12	1.16	-0.30	-0.63	-0.28
13	-0.61	-2.41	-1.92	-0.35
14	1.72	-0.13	-0.78	-0.25
15	-0.37	-0.04	-5.65	-1.21
16	-3.79	-1.17	-0.03	-1.53
17	0.30	1.37	-1.29	-1.27
18	0.91	-0.82	-1.76	-1.43
19	0.40	-1.01	-3.08	-0.69
20	-1.38	0.50	-2.95	-0.91
21	-0.11	0.56	-0.98	-1.34
22	-1.91	-1.63	-0.89	-3.27
평균	-0.97	-0.53	-1.83	-0.85
표준편차	1.68	1.00	1.43	0.84

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



3) 디바이스 2종의 피부 광채(윤기) 측정값 변화

(1) intensity 값

번호	시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
1	5.25	7.06	5.62	6.51
2	7.12	12.70	7.37	8.35
3	4.02	8.50	4.28	8.17
4	8.60	13.14	9.58	11.42
5	4.25	5.92	3.77	5.05
6	3.39	6.51	3.88	5.02
7	8.56	10.03	5.17	6.54
8	6.68	9.35	8.43	9.02
9	3.78	6.75	3.50	5.54
10	2.87	6.98	5.27	8.74
11	4.46	9.69	3.73	6.90
12	10.13	10.65	10.18	10.38
13	5.30	10.27	5.68	10.25
14	4.65	7.19	4.64	7.15
15	5.06	10.00	7.52	9.15
16	7.64	10.30	4.87	9.70
17	5.12	10.87	5.87	9.47
18	3.77	5.23	3.91	4.25
19	3.60	7.40	9.39	12.17
20	3.11	6.51	2.99	6.35
21	4.69	10.62	3.78	7.97
22	5.01	10.91	4.82	8.95
평균	5.32	8.94	5.65	8.05
표준편차	1.97	2.23	2.15	2.13

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



(2) Δ intensity 값

번호	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위
	Δ intensity ₁	Δ intensity ₁
1	1.81	0.89
2	5.58	0.98
3	4.48	3.89
4	4.55	1.84
5	1.67	1.28
6	3.11	1.14
7	1.47	1.37
8	2.67	0.59
9	2.97	2.04
10	4.10	3.47
11	5.22	3.17
12	0.52	0.20
13	4.97	4.57
14	2.54	2.51
15	4.94	1.63
16	2.66	4.83
17	5.75	3.60
18	1.45	0.34
19	3.80	2.78
20	3.39	3.36
21	5.93	4.19
22	5.90	4.13
평균	3.61	2.40
표준편차	1.64	1.46

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



4) 디바이스 2종의 피부 겉보습 측정값 변화

(1) 피부 수분

번호	시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
1	22.71	51.13	23.35	45.59
2	24.28	49.92	25.58	43.65
3	20.10	54.76	19.64	51.16
4	28.22	57.54	28.49	45.23
5	25.91	56.26	19.71	37.85
6	15.18	55.72	15.60	31.53
7	24.99	60.27	22.96	33.99
8	19.51	56.99	14.39	31.73
9	20.88	57.81	19.44	32.43
10	27.54	51.37	25.18	46.99
11	21.45	62.24	20.66	40.74
12	23.90	58.59	23.88	56.03
13	24.47	57.82	25.63	51.09
14	24.33	48.79	25.23	50.87
15	20.44	52.29	20.70	47.56
16	29.35	59.12	29.70	55.28
17	21.09	47.89	21.08	26.43
18	23.78	45.49	23.75	32.38
19	26.03	62.94	26.26	44.12
20	14.68	50.97	14.70	43.77
21	16.69	60.13	17.33	50.41
22	17.61	51.09	18.07	47.25
평균	22.42	54.96	21.88	43.00
표준편차	4.06	4.88	4.29	8.48

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



(2) Δ피부 수분

번호	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위
	Δ피부 수분 ₁	Δ피부 수분 ₁
1	28.42	22.24
2	25.64	18.07
3	34.66	31.52
4	29.32	16.74
5	30.35	18.14
6	40.54	15.93
7	35.28	11.03
8	37.48	17.34
9	36.93	12.99
10	23.83	21.81
11	40.79	20.08
12	34.69	32.15
13	33.35	25.46
14	24.46	25.64
15	31.85	26.86
16	29.77	25.58
17	26.80	5.35
18	21.71	8.63
19	36.91	17.86
20	36.29	29.07
21	43.44	33.08
22	33.48	29.18
평균	32.55	21.13
표준편차	5.88	7.74

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



5) 디바이스 2종의 피부 속보습 측정값 변화

(1) 피부 수분

번호	시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
1	52.00	56.00	52.00	55.00
2	49.00	52.00	48.00	50.00
3	54.00	58.00	53.00	55.00
4	55.00	58.00	54.00	56.00
5	46.00	49.00	45.00	48.00
6	41.00	43.00	38.00	40.00
7	50.00	53.00	47.00	49.00
8	37.00	39.00	37.00	38.00
9	47.00	50.00	46.00	48.00
10	47.00	52.00	48.00	52.00
11	47.00	50.00	48.00	50.00
12	42.00	46.00	43.00	45.00
13	42.00	46.00	43.00	46.00
14	46.00	52.00	48.00	52.00
15	42.00	47.00	42.00	44.00
16	46.00	51.00	47.00	50.00
17	51.00	53.00	50.00	51.00
18	47.00	50.00	48.00	49.00
19	45.00	48.00	46.00	48.00
20	44.00	47.00	44.00	48.00
21	42.00	46.00	44.00	46.00
22	42.00	45.00	44.00	45.00
평균	46.09	49.59	46.14	48.41
표준편차	4.50	4.67	4.25	4.47

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



(2) Δ피부 수분

번호	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위
	Δ피부 수분 ₁	Δ피부 수분 ₁
1	4.00	3.00
2	3.00	2.00
3	4.00	2.00
4	3.00	2.00
5	3.00	3.00
6	2.00	2.00
7	3.00	2.00
8	2.00	1.00
9	3.00	2.00
10	5.00	4.00
11	3.00	2.00
12	4.00	2.00
13	4.00	3.00
14	6.00	4.00
15	5.00	2.00
16	5.00	3.00
17	2.00	1.00
18	3.00	1.00
19	3.00	2.00
20	3.00	4.00
21	4.00	2.00
22	3.00	1.00
평균	3.50	2.27
표준편차	1.06	0.94

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



6) 디바이스 2종의 피부치밀도 측정값 변화

(1) Density 값

번호	시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
1	8.01	9.36	7.61	8.68
2	8.58	9.85	8.52	9.40
3	8.04	9.18	8.23	9.31
4	6.06	7.35	5.95	7.18
5	7.92	8.45	7.18	7.39
6	9.23	9.47	10.21	10.33
7	7.76	8.86	6.63	7.19
8	6.47	8.86	6.77	8.02
9	8.95	9.18	8.76	8.78
10	7.51	7.96	8.51	8.65
11	10.00	10.50	10.59	10.64
12	11.49	12.38	10.31	11.11
13	6.64	7.55	6.66	7.06
14	9.19	10.49	10.15	10.61
15	9.72	10.23	9.81	10.12
16	8.25	9.11	9.14	9.85
17	8.64	10.02	9.15	9.16
18	8.54	8.99	8.43	8.84
19	12.91	14.50	12.80	13.61
20	8.91	9.86	7.95	8.83
21	6.62	6.79	6.98	7.15
22	9.96	10.94	9.48	10.27
평균	8.61	9.54	8.63	9.19
표준편차	1.62	1.68	1.64	1.60

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



(2) ΔDensity 값

번호	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위
	ΔDensity ₁	ΔDensity ₁
1	1.35	1.07
2	1.27	0.88
3	1.14	1.08
4	1.29	1.23
5	0.53	0.21
6	0.24	0.12
7	1.10	0.56
8	2.39	1.25
9	0.23	0.02
10	0.45	0.14
11	0.50	0.05
12	0.89	0.80
13	0.91	0.40
14	1.30	0.46
15	0.51	0.31
16	0.86	0.71
17	1.38	0.01
18	0.45	0.41
19	1.59	0.81
20	0.95	0.88
21	0.17	0.17
22	0.98	0.79
평균	0.93	0.56
표준편차	0.53	0.41

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



7) 디바이스 2종의 피부 거칠기(결) 측정값 변화

(1) Texture small 값

번호	시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
1	5.86	5.57	6.12	5.96
2	6.04	5.59	5.75	5.65
3	7.57	7.11	6.77	6.40
4	7.13	6.83	7.67	7.33
5	6.85	5.92	7.89	6.93
6	10.55	9.39	10.39	9.87
7	7.28	6.80	7.01	6.95
8	7.51	6.18	6.70	5.80
9	6.36	5.48	6.12	5.18
10	6.98	6.44	6.90	6.29
11	7.98	6.84	6.72	6.42
12	5.76	5.51	5.47	5.39
13	8.42	7.01	7.75	6.42
14	7.99	7.29	8.90	8.29
15	7.12	6.54	6.55	6.24
16	8.87	7.84	9.22	8.38
17	8.81	7.55	7.91	6.76
18	6.49	5.86	6.48	6.21
19	7.82	7.00	7.16	6.95
20	6.53	5.24	5.56	4.72
21	6.99	6.20	6.76	6.35
22	6.34	5.96	5.98	5.88
평균	7.33	6.55	7.08	6.56
표준편차	1.14	0.96	1.23	1.15

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



(2) ΔTexture small 값

번호	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 B+C 도포부위
	ΔTexture small ₁	ΔTexture small ₁
1	-0.29	-0.15
2	-0.46	-0.09
3	-0.46	-0.37
4	-0.29	-0.34
5	-0.94	-0.96
6	-1.16	-0.51
7	-0.48	-0.07
8	-1.33	-0.89
9	-0.88	-0.95
10	-0.54	-0.61
11	-1.14	-0.31
12	-0.24	-0.07
13	-1.41	-1.33
14	-0.70	-0.61
15	-0.58	-0.31
16	-1.03	-0.83
17	-1.26	-1.15
18	-0.63	-0.27
19	-0.82	-0.21
20	-1.29	-0.83
21	-0.79	-0.42
22	-0.38	-0.09
평균	-0.78	-0.52
표준편차	0.37	0.38

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



8) 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력 측정값 변화

(1) R2 값

번호	볼부위			
	시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
1	60.30	64.60	60.30	63.30
2	69.30	73.10	69.30	72.10
3	69.70	72.80	69.70	71.20
4	65.40	68.80	65.40	67.20
5	64.90	68.60	64.90	66.90
6	62.30	66.80	62.30	65.70
7	62.30	65.30	62.30	64.80
8	62.90	67.20	62.90	66.00
9	59.30	62.70	59.30	62.30
10	63.00	66.90	63.00	66.60
11	75.80	79.70	75.80	78.90
12	66.20	70.70	66.20	69.30
13	56.30	60.10	56.30	58.70
14	62.30	66.20	62.30	65.70
15	54.90	58.70	54.90	56.50
16	64.30	68.00	64.30	67.80
17	58.20	62.30	58.20	61.30
18	58.50	62.50	58.50	60.50
19	65.20	68.20	65.20	67.50
20	68.50	71.30	68.50	70.20
21	70.70	74.10	70.70	73.20
22	56.60	60.30	56.60	58.60
평균	63.50	67.22	63.50	66.10
표준편차	5.24	5.13	5.24	5.31

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



번호	턱라인부위			
	시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
1	68.50	72.60	68.50	71.50
2	65.10	68.60	65.10	67.40
3	67.10	70.00	67.10	69.30
4	71.30	75.60	71.30	73.20
5	68.30	73.80	68.30	70.90
6	73.70	78.60	73.70	75.30
7	69.20	74.50	69.20	73.00
8	70.50	73.50	70.50	73.10
9	77.40	81.20	77.40	80.00
10	72.10	76.30	72.10	75.80
11	84.30	89.20	84.30	86.90
12	83.20	87.10	83.20	86.70
13	63.10	65.20	63.10	64.70
14	62.90	66.40	62.90	65.50
15	65.80	70.50	65.80	68.90
16	68.80	73.40	68.80	71.90
17	68.80	72.10	68.80	71.30
18	61.00	65.30	61.00	63.60
19	69.50	74.50	69.50	73.00
20	71.60	74.40	71.60	74.30
21	79.00	83.20	79.00	81.60
22	80.90	82.20	80.90	81.90
평균	71.00	74.92	71.00	73.63
표준편차	6.44	6.52	6.44	6.46

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



(2) ΔR2 값

번호	볼부위		턱라인부위	
	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위
	ΔR2 ₁	ΔR2 ₁	ΔR2 ₁	ΔR2 ₁
1	4.30	3.00	4.10	3.00
2	3.80	2.80	3.50	2.30
3	3.10	1.50	2.90	2.20
4	3.40	1.80	4.30	1.90
5	3.70	2.00	5.50	2.60
6	4.50	3.40	4.90	1.60
7	3.00	2.50	5.30	3.80
8	4.30	3.10	3.00	2.60
9	3.40	3.00	3.80	2.60
10	3.90	3.60	4.20	3.70
11	3.90	3.10	4.90	2.60
12	4.50	3.10	3.90	3.50
13	3.80	2.40	2.10	1.60
14	3.90	3.40	3.50	2.60
15	3.80	1.60	4.70	3.10
16	3.70	3.50	4.60	3.10
17	4.10	3.10	3.30	2.50
18	4.00	2.00	4.30	2.60
19	3.00	2.30	5.00	3.50
20	2.80	1.70	2.80	2.70
21	3.40	2.50	4.20	2.60
22	3.70	2.00	1.30	1.00
평균	3.73	2.61	3.91	2.62
표준편차	0.48	0.67	1.05	0.70

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



9) 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도) 측정값 변화

(1) 피부 각도

번호	볼부위			
	시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
1	19.67	19.77	19.67	19.47
2	37.21	33.80	37.21	34.51
3	20.95	16.02	20.95	16.78
4	31.81	30.21	31.81	30.41
5	24.55	21.14	24.55	22.35
6	29.95	26.75	29.95	28.18
7	29.83	28.49	29.83	28.78
8	22.69	22.12	22.69	19.18
9	25.13	22.32	25.13	23.20
10	32.04	31.88	32.04	33.54
11	30.23	29.92	30.23	30.11
12	21.09	22.05	21.09	22.25
13	33.65	32.81	33.65	33.04
14	27.02	26.23	27.02	28.74
15	33.28	31.66	33.28	32.91
16	35.40	31.38	35.40	31.61
17	31.03	30.90	31.03	31.33
18	22.36	22.15	22.36	23.27
19	22.75	22.46	22.75	23.15
20	32.88	29.92	32.88	31.50
21	29.20	28.61	29.20	29.09
22	30.26	27.99	30.26	28.35
평균	28.32	26.75	28.32	27.35
표준편차	5.14	4.95	5.14	5.22

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



번호	턱라인부위			
	시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
1	85.86	81.66	85.86	82.09
2	80.22	76.80	80.22	78.34
3	77.23	75.61	77.23	75.68
4	80.19	75.52	80.19	77.57
5	84.62	81.47	84.62	83.13
6	83.46	78.69	83.46	79.92
7	84.23	80.52	84.23	82.87
8	84.70	81.57	84.70	82.32
9	87.71	88.65	87.71	88.81
10	84.38	79.94	84.38	83.55
11	85.91	82.72	85.91	83.95
12	83.13	82.35	83.13	82.50
13	85.65	82.54	85.65	83.73
14	81.72	79.78	81.72	80.94
15	79.13	75.00	79.13	73.48
16	88.67	87.86	88.67	88.64
17	86.50	84.53	86.50	85.21
18	81.35	79.03	81.35	79.59
19	80.30	73.89	80.30	77.22
20	80.91	77.05	80.91	77.96
21	84.27	82.87	84.27	83.29
22	87.72	85.13	87.72	86.83
평균	83.54	80.60	83.54	81.71
표준편차	3.06	3.99	3.06	3.97

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



(2) Δ피부 각도

번호	볼부위		턱라인부위	
	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위
	Δ피부 각도 ₁	Δ피부 각도 ₁	Δ피부 각도 ₁	Δ피부 각도 ₁
1	0.10	-0.20	-4.20	-3.77
2	-3.41	-2.70	-3.42	-1.88
3	-4.93	-4.17	-1.62	-1.55
4	-1.60	-1.40	-4.67	-2.62
5	-3.41	-2.20	-3.15	-1.49
6	-3.20	-1.77	-4.77	-3.54
7	-1.34	-1.05	-3.71	-1.36
8	-0.57	-3.51	-3.13	-2.38
9	-2.81	-1.93	0.94	1.10
10	-0.16	1.50	-4.44	-0.83
11	-0.31	-0.12	-3.19	-1.96
12	0.96	1.16	-0.78	-0.63
13	-0.84	-0.61	-3.11	-1.92
14	-0.79	1.72	-1.94	-0.78
15	-1.62	-0.37	-4.13	-5.65
16	-4.02	-3.79	-0.81	-0.03
17	-0.13	0.30	-1.97	-1.29
18	-0.21	0.91	-2.32	-1.76
19	-0.29	0.40	-6.41	-3.08
20	-2.96	-1.38	-3.86	-2.95
21	-0.59	-0.11	-1.40	-0.98
22	-2.27	-1.91	-2.59	-0.89
평균	-1.56	-0.97	-2.94	-1.83
표준편차	1.58	1.68	1.64	1.43

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



10) 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 광채(윤기) 측정값 변화

(1) intensity 값

번호	시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
1	5.25	8.41	5.25	7.06
2	7.12	13.77	7.12	12.70
3	4.02	6.51	4.02	8.50
4	8.60	9.13	8.60	13.14
5	4.25	5.99	4.25	5.92
6	3.39	6.20	3.39	6.51
7	8.56	9.16	8.56	10.03
8	6.68	8.87	6.68	9.35
9	3.78	9.28	3.78	6.75
10	2.87	8.39	2.87	6.98
11	4.46	12.03	4.46	9.69
12	10.13	5.40	10.13	10.65
13	5.30	5.89	5.30	10.27
14	4.65	4.23	4.65	7.19
15	5.06	7.32	5.06	10.00
16	7.64	9.40	7.64	10.30
17	5.12	4.76	5.12	10.87
18	3.77	5.63	3.77	5.23
19	3.60	6.10	3.60	7.40
20	3.11	7.66	3.11	6.51
21	4.69	6.80	4.69	10.62
22	5.01	11.12	5.01	10.91
평균	5.32	7.82	5.32	8.94
표준편차	1.97	2.42	1.97	2.23

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



(2) Δ intensity 값

번호	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위
	Δ intensity ₁	Δ intensity ₁
1	3.16	1.81
2	6.65	5.58
3	2.49	4.48
4	0.53	4.55
5	1.74	1.67
6	2.81	3.11
7	0.60	1.47
8	2.19	2.67
9	5.50	2.97
10	5.52	4.10
11	7.57	5.22
12	-4.73	0.52
13	0.59	4.97
14	-0.42	2.54
15	2.26	4.94
16	1.76	2.66
17	-0.36	5.75
18	1.86	1.45
19	2.50	3.80
20	4.55	3.39
21	2.11	5.93
22	6.11	5.90
평균	2.50	3.61
표준편차	2.77	1.64

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



11) 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 겉보습 측정값 변화

(1) 피부 수분

번호	시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
1	22.71	61.86	22.71	51.13
2	24.28	51.96	24.28	49.92
3	20.10	56.44	20.10	54.76
4	28.22	59.09	28.22	57.54
5	25.91	67.25	25.91	56.26
6	15.18	67.28	15.18	55.72
7	24.99	65.09	24.99	60.27
8	19.51	66.65	19.51	56.99
9	20.88	64.82	20.88	57.81
10	27.54	61.11	27.54	51.37
11	21.45	70.26	21.45	62.24
12	23.90	60.26	23.90	58.59
13	24.47	61.95	24.47	57.82
14	24.33	58.40	24.33	48.79
15	20.44	57.07	20.44	52.29
16	29.35	58.41	29.35	59.12
17	21.09	54.23	21.09	47.89
18	23.78	60.01	23.78	45.49
19	26.03	68.10	26.03	62.94
20	14.68	57.25	14.68	50.97
21	16.69	61.56	16.69	60.13
22	17.61	59.40	17.61	51.09
평균	22.42	61.29	22.42	54.96
표준편차	4.06	4.77	4.06	4.88

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



(2) Δ피부 수분

번호	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위
	Δ피부 수분 ₁	Δ피부 수분 ₁
1	39.15	28.42
2	27.68	25.64
3	36.34	34.66
4	30.87	29.32
5	41.34	30.35
6	52.10	40.54
7	40.10	35.28
8	47.14	37.48
9	43.94	36.93
10	33.57	23.83
11	48.81	40.79
12	36.36	34.69
13	37.48	33.35
14	34.07	24.46
15	36.63	31.85
16	29.06	29.77
17	33.14	26.80
18	36.23	21.71
19	42.07	36.91
20	42.57	36.29
21	44.87	43.44
22	41.79	33.48
평균	38.88	32.55
표준편차	6.32	5.88

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



12) 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 속보습 측정값 변화

(1) 피부 수분

번호	시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
1	52.00	58.00	52.00	56.00
2	49.00	54.00	49.00	52.00
3	54.00	60.00	54.00	58.00
4	55.00	61.00	55.00	58.00
5	46.00	51.00	46.00	49.00
6	41.00	45.00	41.00	43.00
7	50.00	54.00	50.00	53.00
8	37.00	40.00	37.00	39.00
9	47.00	51.00	47.00	50.00
10	47.00	53.00	47.00	52.00
11	47.00	51.00	47.00	50.00
12	42.00	48.00	42.00	46.00
13	42.00	48.00	42.00	46.00
14	46.00	53.00	46.00	52.00
15	42.00	49.00	42.00	47.00
16	46.00	52.00	46.00	51.00
17	51.00	54.00	51.00	53.00
18	47.00	51.00	47.00	50.00
19	45.00	49.00	45.00	48.00
20	44.00	50.00	44.00	47.00
21	42.00	48.00	42.00	46.00
22	42.00	48.00	42.00	45.00
평균	46.09	51.27	46.09	49.59
표준편차	4.50	4.71	4.50	4.67

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



(2) Δ피부 수분

번호	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위
	Δ피부 수분 ₁	Δ피부 수분 ₁
1	6.00	4.00
2	5.00	3.00
3	6.00	4.00
4	6.00	3.00
5	5.00	3.00
6	4.00	2.00
7	4.00	3.00
8	3.00	2.00
9	4.00	3.00
10	6.00	5.00
11	4.00	3.00
12	6.00	4.00
13	6.00	4.00
14	7.00	6.00
15	7.00	5.00
16	6.00	5.00
17	3.00	2.00
18	4.00	3.00
19	4.00	3.00
20	6.00	3.00
21	6.00	4.00
22	6.00	3.00
평균	5.18	3.50
표준편차	1.22	1.06

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



13) 디바이스 2종 병행 사용 시 피부치밀도 측정값 변화

(1) Density 값

번호	시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
1	8.01	9.58	8.01	9.36
2	8.58	9.95	8.58	9.85
3	8.04	9.50	8.04	9.18
4	6.06	8.04	6.06	7.35
5	7.92	8.66	7.92	8.45
6	9.23	9.56	9.23	9.47
7	7.76	9.26	7.76	8.86
8	6.47	9.13	6.47	8.86
9	8.95	9.86	8.95	9.18
10	7.51	8.25	7.51	7.96
11	10.00	11.60	10.00	10.50
12	11.49	12.45	11.49	12.38
13	6.64	8.01	6.64	7.55
14	9.19	11.59	9.19	10.49
15	9.72	10.69	9.72	10.23
16	8.25	9.61	8.25	9.11
17	8.64	10.19	8.64	10.02
18	8.54	9.09	8.54	8.99
19	12.91	14.89	12.91	14.50
20	8.91	10.48	8.91	9.86
21	6.62	7.42	6.62	6.79
22	9.96	11.68	9.96	10.94
평균	8.61	9.98	8.61	9.54
표준편차	1.62	1.70	1.62	1.68

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



(2) ΔDensity 값

번호	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위
	ΔDensity ₁	ΔDensity ₁
1	1.57	1.35
2	1.37	1.27
3	1.46	1.14
4	1.98	1.29
5	0.74	0.53
6	0.33	0.24
7	1.50	1.10
8	2.66	2.39
9	0.91	0.23
10	0.74	0.45
11	1.60	0.50
12	0.96	0.89
13	1.37	0.91
14	2.40	1.30
15	0.97	0.51
16	1.36	0.86
17	1.55	1.38
18	0.55	0.45
19	1.98	1.59
20	1.57	0.95
21	0.80	0.17
22	1.72	0.98
평균	1.37	0.93
표준편차	0.59	0.53

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



14) 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 거칠기(결) 측정값 변화

(1) Texture small 값

번호	시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
	사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
1	5.86	5.39	5.86	5.57
2	6.04	5.45	6.04	5.59
3	7.57	6.66	7.57	7.11
4	7.13	6.62	7.13	6.83
5	6.85	5.84	6.85	5.92
6	10.55	8.97	10.55	9.39
7	7.28	6.54	7.28	6.80
8	7.51	6.12	7.51	6.18
9	6.36	5.24	6.36	5.48
10	6.98	6.38	6.98	6.44
11	7.98	6.64	7.98	6.84
12	5.76	5.33	5.76	5.51
13	8.42	6.87	8.42	7.01
14	7.99	7.10	7.99	7.29
15	7.12	6.19	7.12	6.54
16	8.87	7.25	8.87	7.84
17	8.81	7.294	8.81	7.547
18	6.49	5.79	6.49	5.86
19	7.82	6.70	7.82	7.00
20	6.53	5.22	6.53	5.24
21	6.99	5.78	6.99	6.20
22	6.34	5.67	6.34	5.96
평균	7.33	6.32	7.33	6.55
표준편차	1.14	0.89	1.14	0.96

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.




(2) ΔTexture small 값

번호	시험제품 A+B+C 도포부위	시험제품 A+C 도포부위
	ΔTexture small ₁	ΔTexture small ₁
1	-0.47	-0.29
2	-0.60	-0.46
3	-0.91	-0.46
4	-0.51	-0.29
5	-1.02	-0.94
6	-1.58	-1.16
7	-0.74	-0.48
8	-1.39	-1.33
9	-1.12	-0.88
10	-0.60	-0.54
11	-1.34	-1.14
12	-0.43	-0.24
13	-1.55	-1.41
14	-0.89	-0.70
15	-0.92	-0.58
16	-1.63	-1.03
17	-1.52	-1.26
18	-0.71	-0.63
19	-1.12	-0.82
20	-1.32	-1.29
21	-1.21	-0.79
22	-0.67	-0.38
평균	-1.01	-0.78
표준편차	0.39	0.37

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

[별첨 2] 인체적용시험 사진자료

1-1. 전안촬영시스템 F-RAY에 의한 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도) 중 볼부위 분석 사진

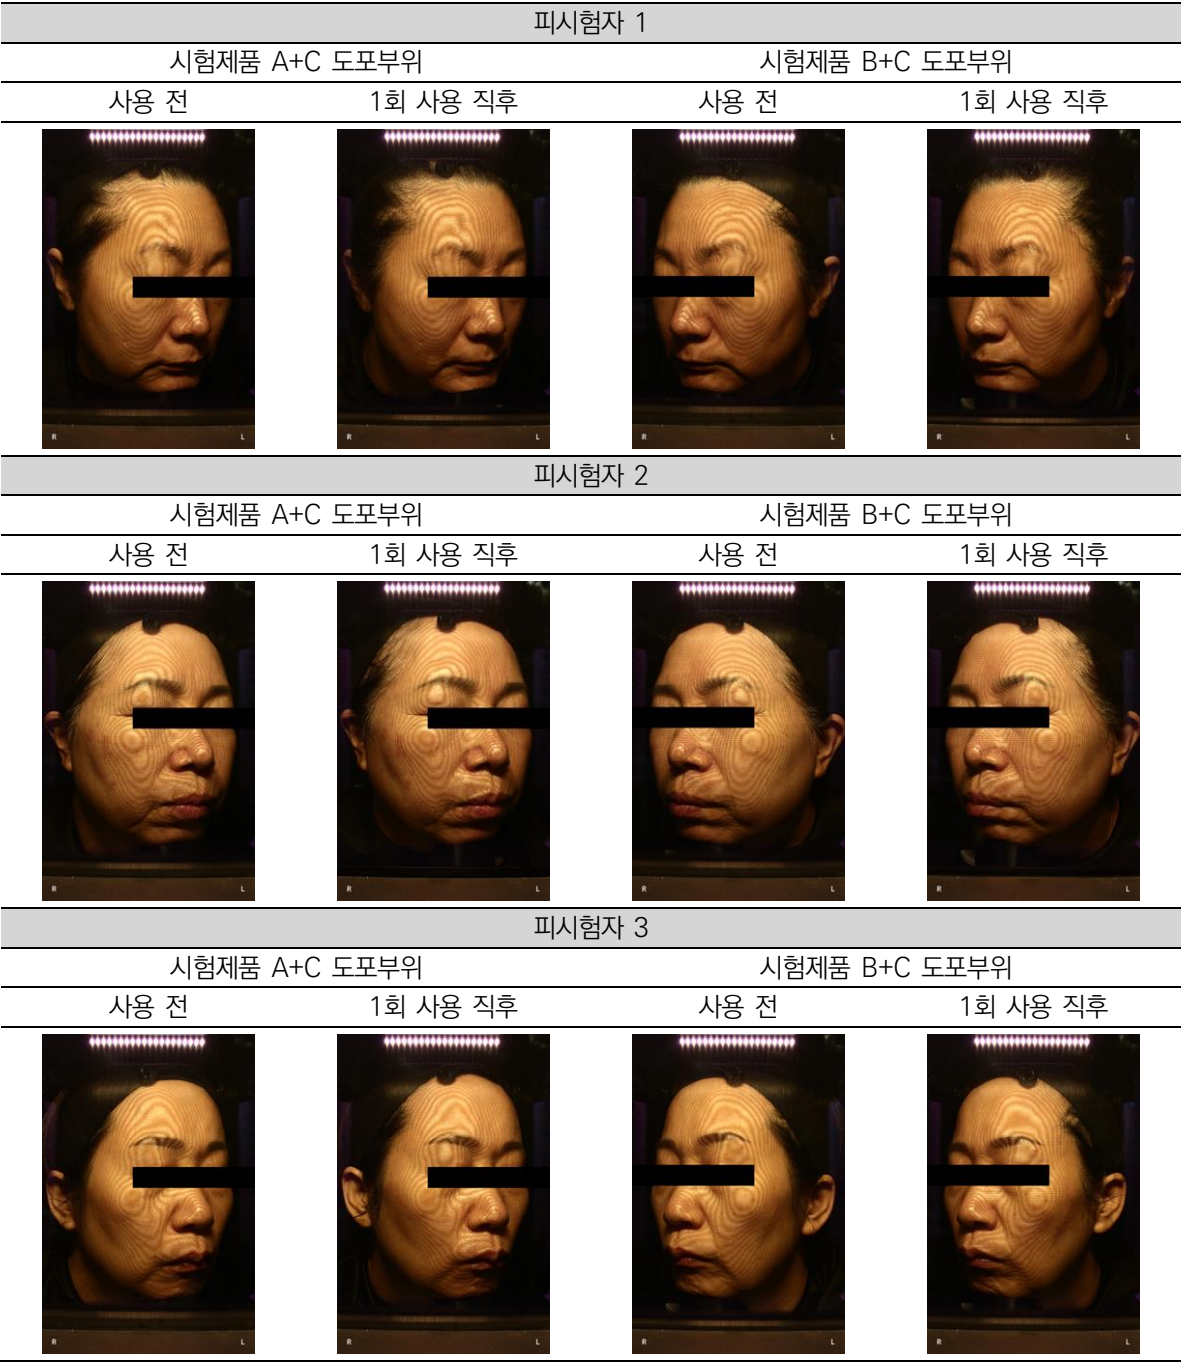

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 4			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 5			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 6			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 7			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 8			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 9			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후



본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 10			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 11			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 12			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

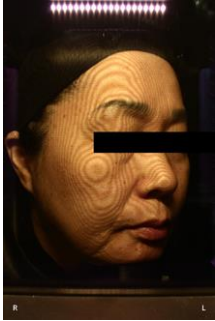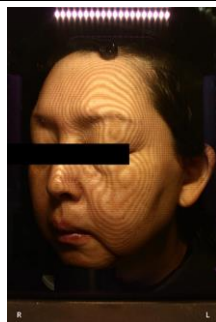

피시험자 13			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 14			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 15			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			


본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 16			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 17			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 18			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

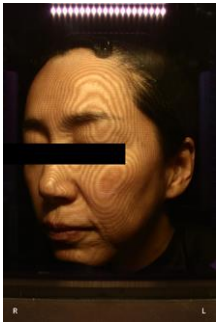

피시험자 19			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 20			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 21			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 22			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



1-2. 전안촬영시스템 F-RAY에 의한 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도) 중 턱라인부위 분석 사진

피시험자 1			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 2			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 3			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 4			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 5			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 6			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후



본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 7			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 8			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 9			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후



본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

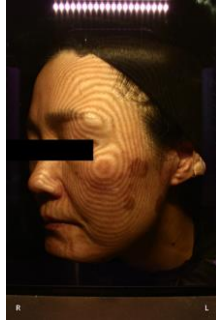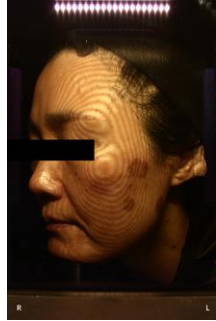

피시험자 10			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 11			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 12			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

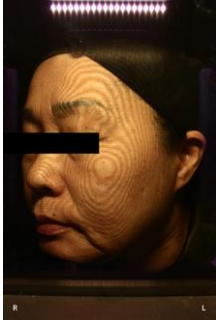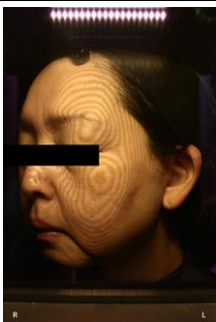

피시험자 13			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 14			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 15			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			


본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 16			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 17			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 18			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

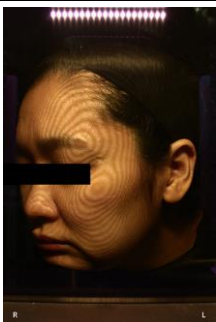

피시험자 19			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 20			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 21			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 22			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



2. 전안촬영시스템 Mark-vu에 의한 디바이스 2종의 피부 광채(윤기) 분석 사진

피시험자 1			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 2			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 3			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 4			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 5			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 6			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 7			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 8			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 9			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

'하이소닉 초음파 디바이스 외 2종'의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 개선에 대한 인체적용시험

피시험자 10			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 11			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 12			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 13			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 14			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 15			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 16			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 17			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 18			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

'하이소닉 초음파 디바이스 외 2종'의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 개선에 대한 인체적용시험

피시험자 19			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 20			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 21			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 22			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



3. Epsilon E100에 의한 디바이스 2종의 피부 겉보습 분석 사진

피시험자 1			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 2			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 3			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

'하이소닉 초음파 디바이스 외 2종'의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 개선에 대한 인체적용시험

피시험자 4			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 5			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 6			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 7			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 8			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 9			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

'하이소닉 초음파 디바이스 외 2종'의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 개선에 대한 인체적용시험

피시험자 10			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 11			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 12			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 13			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 14			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 15			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 16			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 17			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 18			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후





본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

'하이소닉 초음파 디바이스 외 2종'의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 개선에 대한 인체적용시험

피시험자 19			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 20			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 21			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.









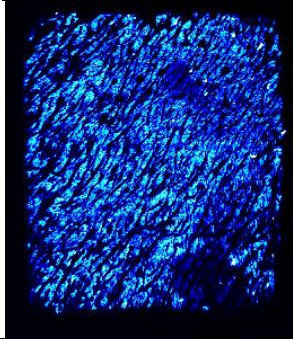
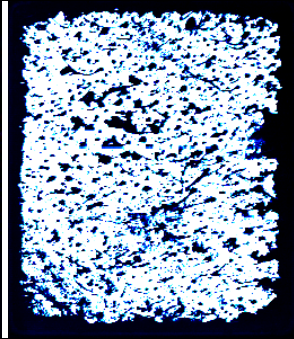
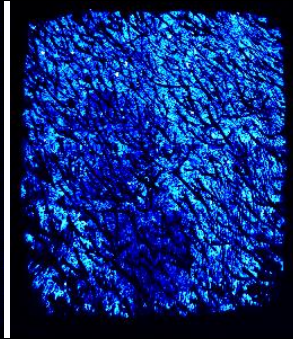
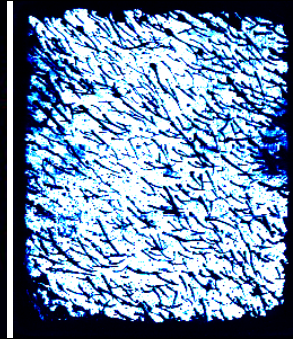


피시험자 22			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



4. DUB-Skin Scanner에 의한 디바이스 2종의 피부치밀도 분석 사진

피시험자 1			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 2			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 3			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 4			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 5			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 6			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 7			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 8			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 9			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 10			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 11			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 12			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 13			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 14			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 15			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 16			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 17			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 18			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후





본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 19			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 20			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 21			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후













본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 22			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

5. ANTERA 3D에 의한 디바이스 2종의 피부 거칠기(결) 분석 사진

피시험자 1			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 2			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 3			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

'하이소닉 초음파 디바이스 외 2종'의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 개선에 대한 인체적용시험

피시험자 4			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 5			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 6			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후













본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

'하이소닉 초음파 디바이스 외 2종'의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 개선에 대한 인체적용시험

피시험자 7			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 8			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 9			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 10			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 11			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 12			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 13			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 14			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 15			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후













본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 16			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 17			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 18			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후




본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 19			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 20			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 21			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 22			
시험제품 A+C 도포부위		시험제품 B+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



6-1. 전안촬영시스템 F-RAY에 의한 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도) 중 볼부위 분석 사진

피시험자 1			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 2			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 3			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 4			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 5			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 6			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 7			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 8			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 9			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 10			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 11			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 12			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후


본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

'하이소닉 초음파 디바이스 외 2종'의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 개선에 대한 인체적용시험

피시험자 13			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 14			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 15			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

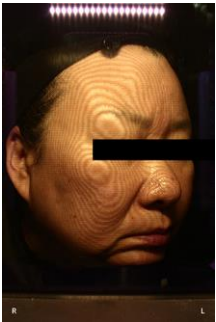

피시험자 16			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 17			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 18			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 19			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 20			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 21			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 22			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



6-2. 전안촬영시스템 F-RAY에 의한 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도) 중 턱라인부위 분석 사진

피시험자 1			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 2			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 3			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 4			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 5			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 6			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 7			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 8			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 9			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 10			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 11			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 12			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 13			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 14			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 15			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후


본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 16			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 17			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 18			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

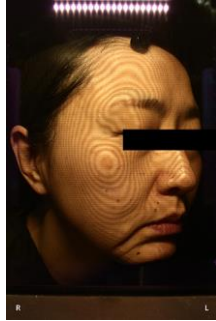

피시험자 19			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 20			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 21			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 22			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

7. 전안촬영시스템 Mark-vu에 의한 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 광채(윤기) 분석 사진

피시험자 1			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 2			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 3			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 4			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 5			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 6			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 7			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 8			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 9			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 10			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 11			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 12			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 13			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 14			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 15			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 16			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 17			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 18			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 19			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 20			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 21			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 22			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.




8. Epsilon E100에 의한 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 겉보습 분석 사진

피시험자 1			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 2			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 3			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후


본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

'하이소닉 초음파 디바이스 외 2종'의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 개선에 대한 인체적용시험

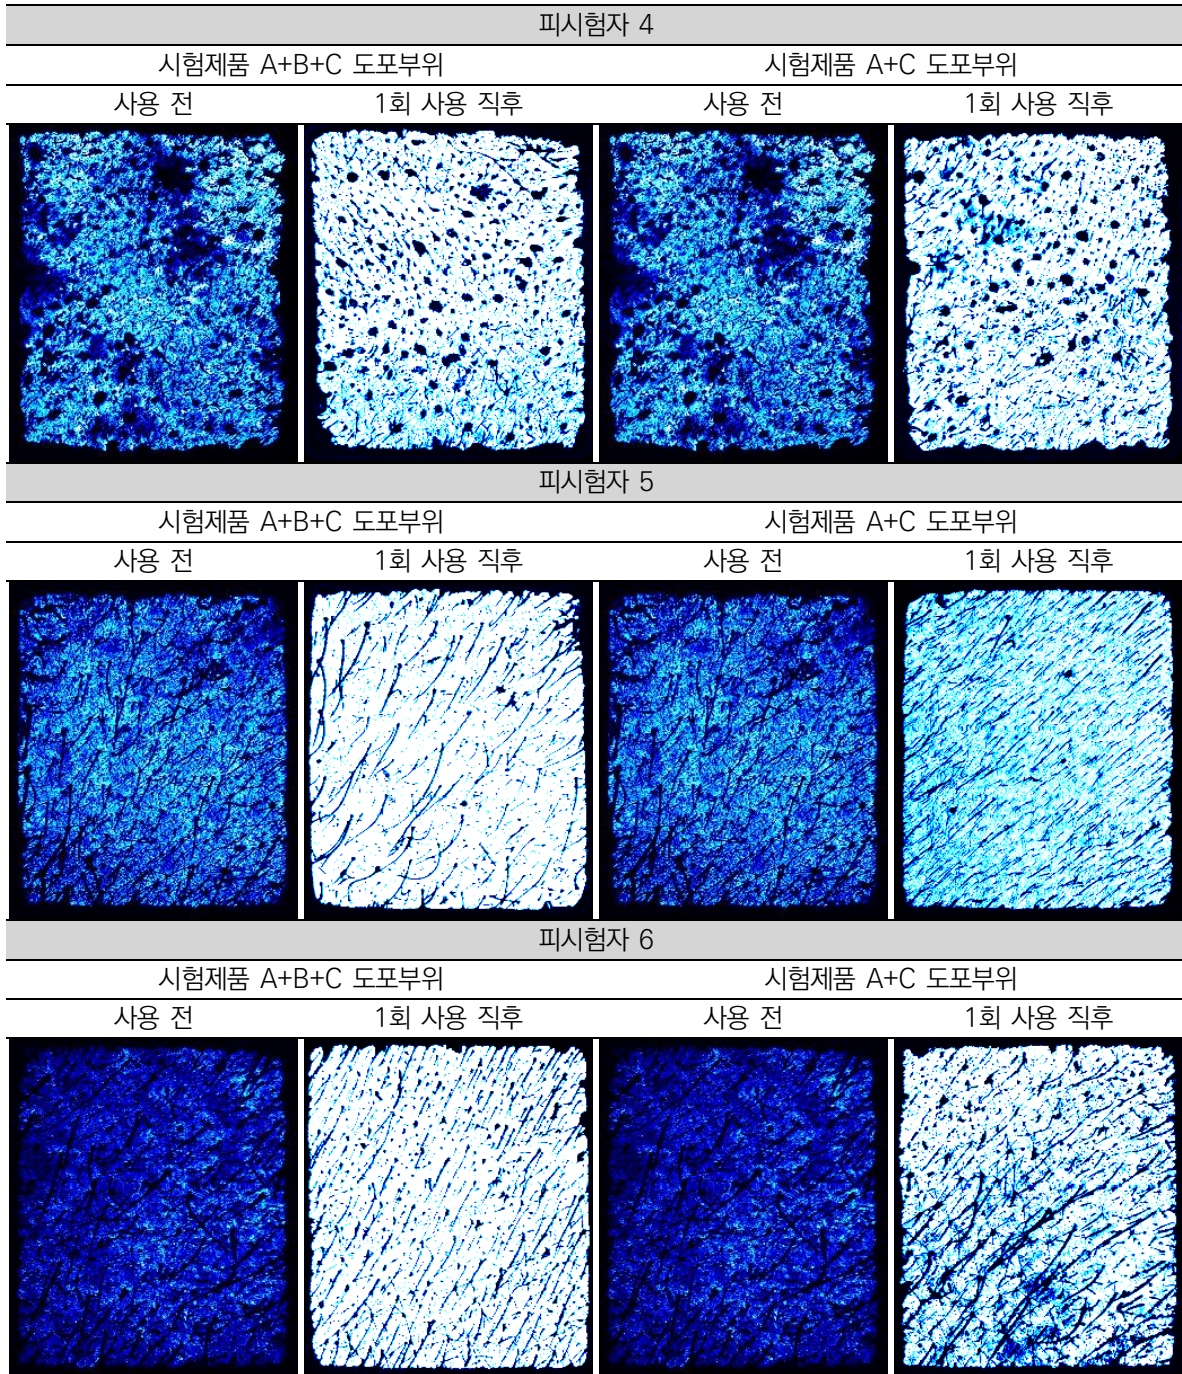

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

'하이스닉 초음파 디바이스 외 2종'의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 개선에 대한 인체적용시험

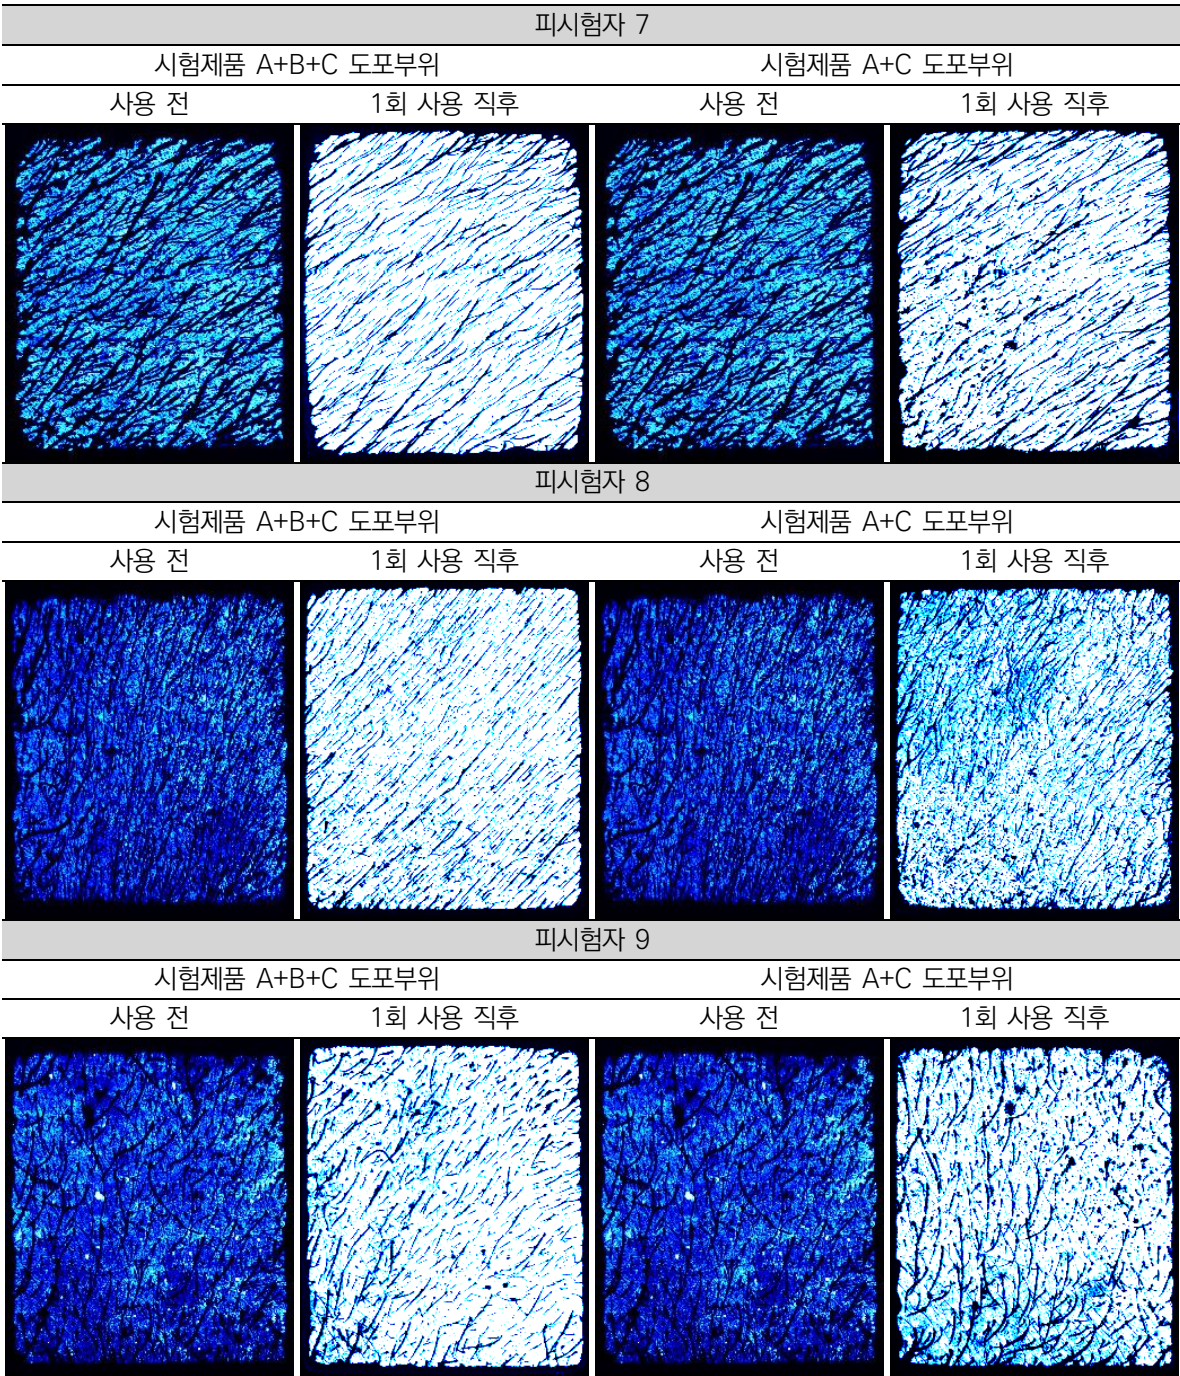


본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

'하이소닉 초음파 디바이스 외 2종'의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 개선에 대한 인체적용시험

피시험자 10			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 11			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 12			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후


본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

'하이스닉 초음파 디바이스 외 2종'의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(겉) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(겉) 개선에 대한 인체적용시험

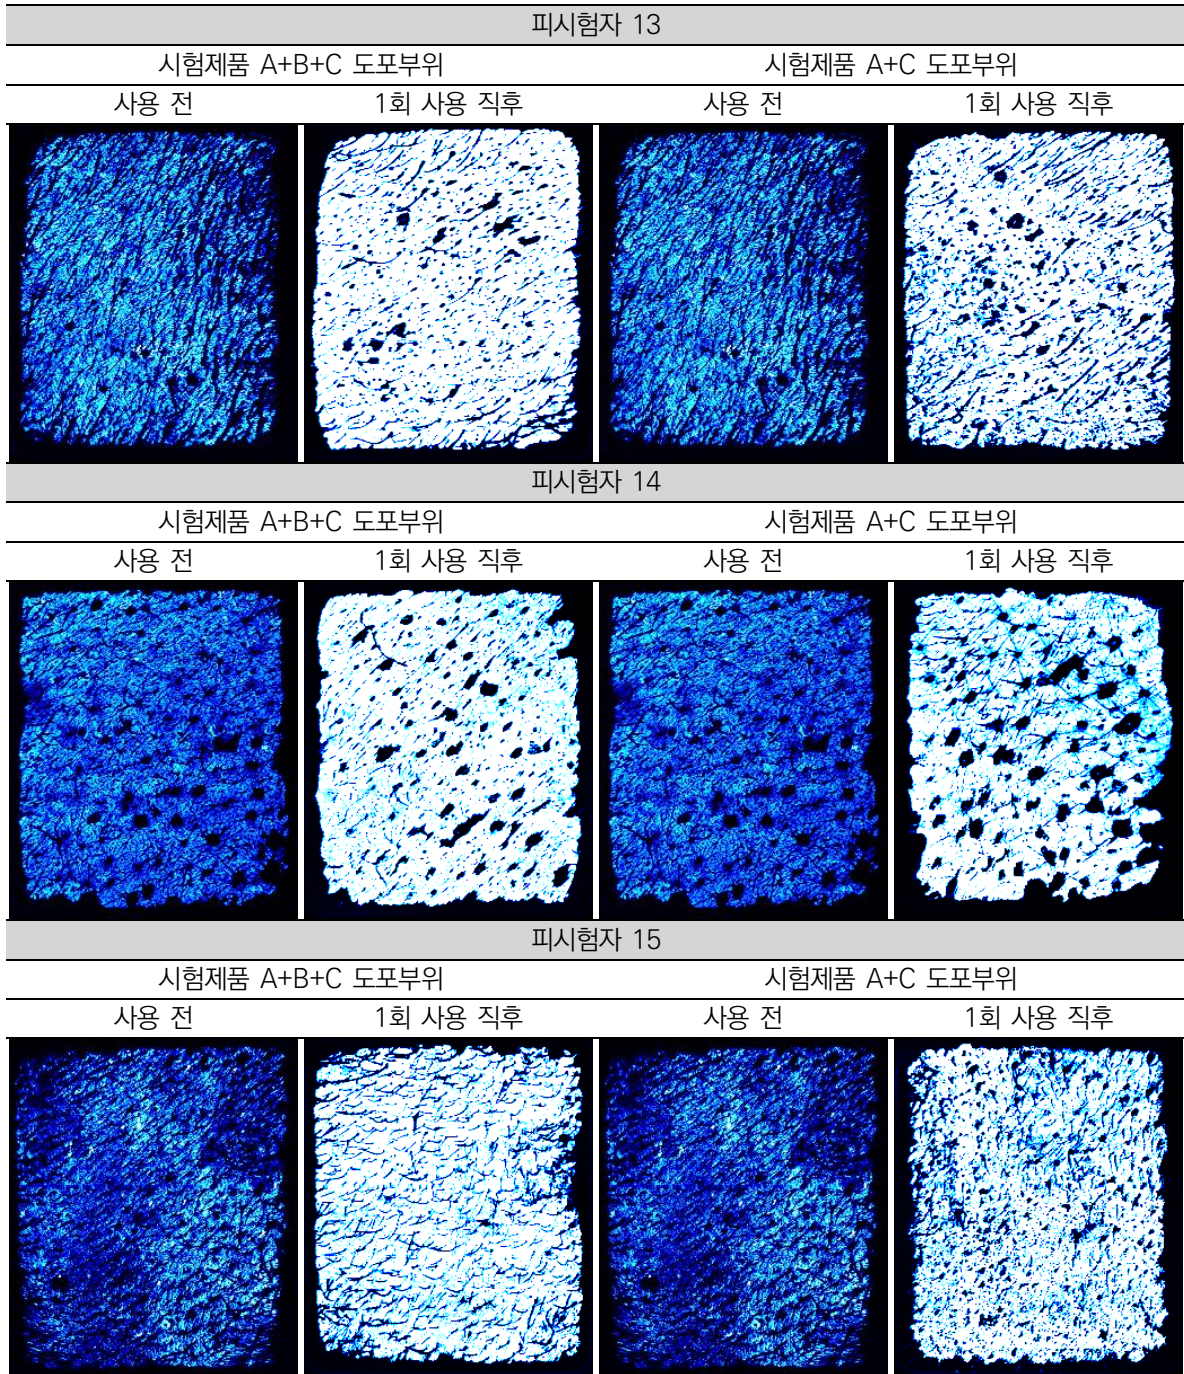

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

'하이소닉 초음파 디바이스 외 2종'의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 개선에 대한 인체적용시험

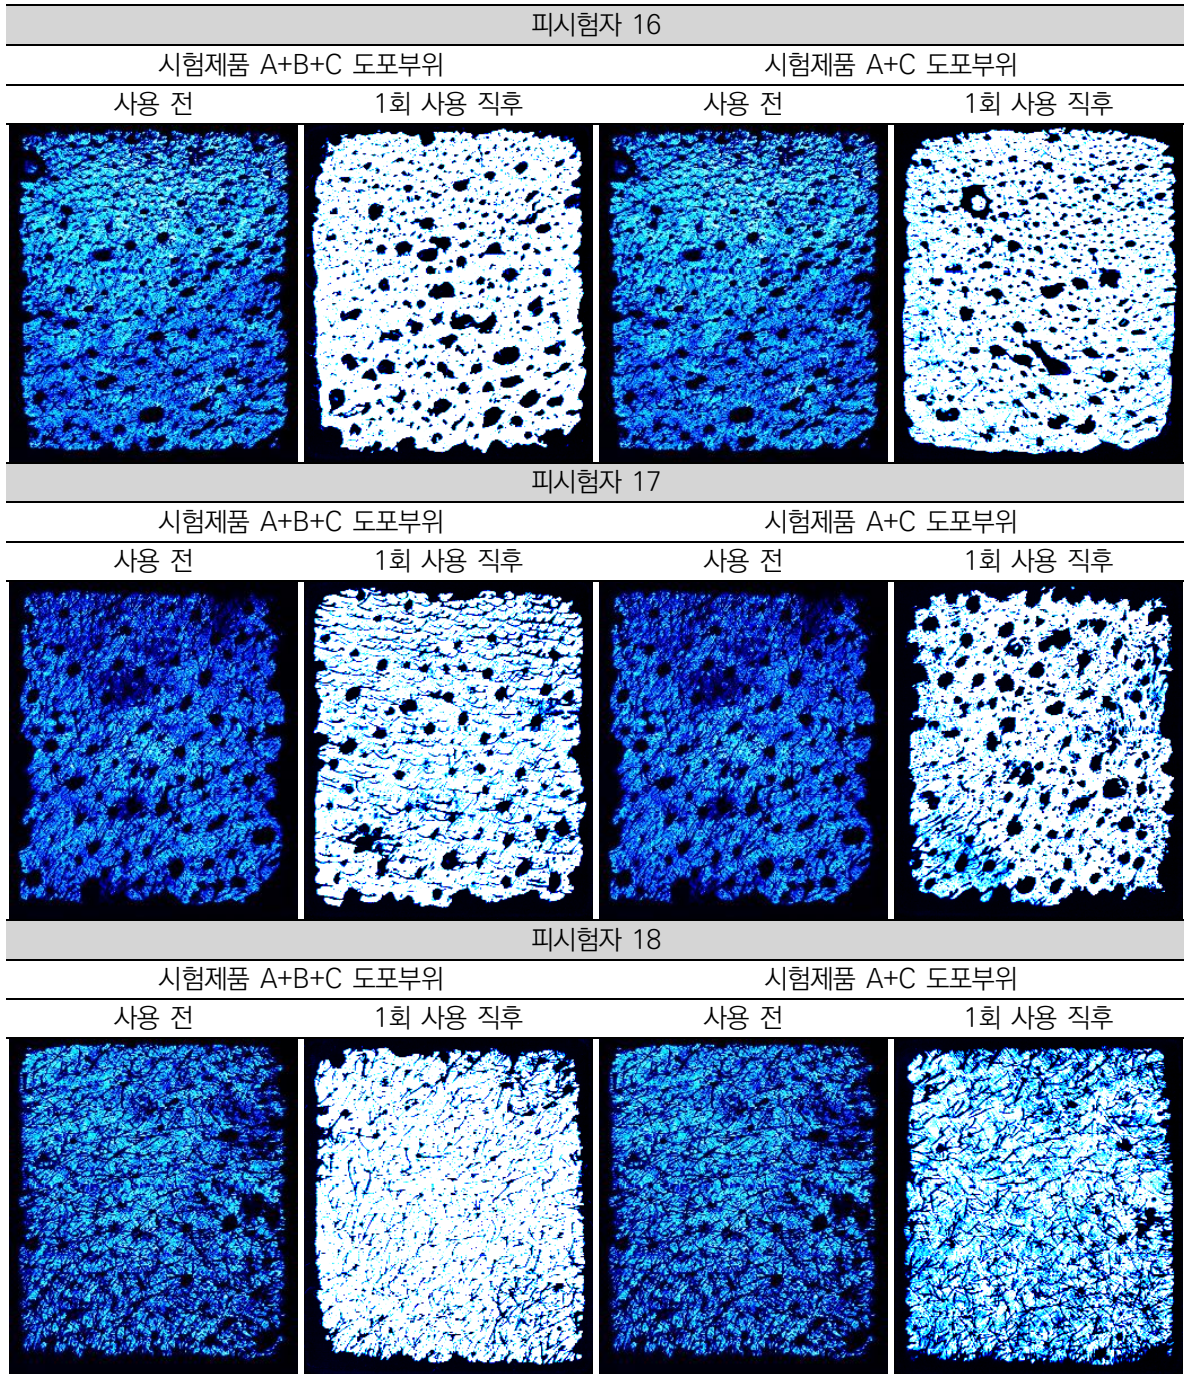

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 19			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 20			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 21			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.




피시험자 22			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.




9. DUB-Skin Scanner에 의한 디바이스 2종 병행 사용 시 피부치밀도 분석 사진


피시험자 1			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

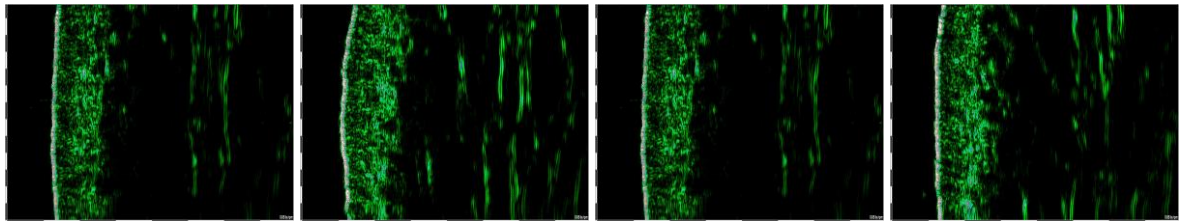

피시험자 2			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후












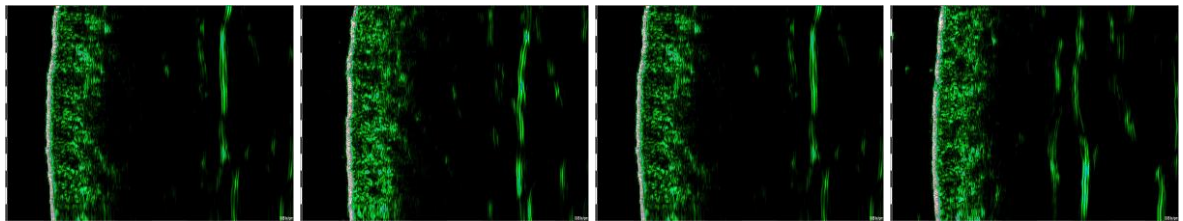


피시험자 3			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

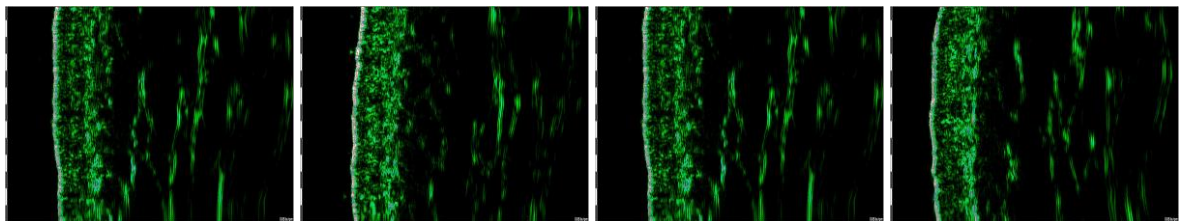













본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 4			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 5			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 6			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 7			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 8			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 9			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 10			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 11			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 12			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 13			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 14			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 15			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 16			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 17			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 18			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후





본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 19			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 20			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 21			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 22			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



10. ANTERA 3D에 의한 디바이스 2종 병행 사용 시 피부 거칠기(결) 분석 사진

피시험자 1			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 2			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 3			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후












본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

'하이소닉 초음파 디바이스 외 2종'의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 개선에 대한 인체적용시험

피시험자 4			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 5			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 6			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 7			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 8			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			
피시험자 9			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.




피시험자 10			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 11			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 12			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 13			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 14			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
피시험자 15			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

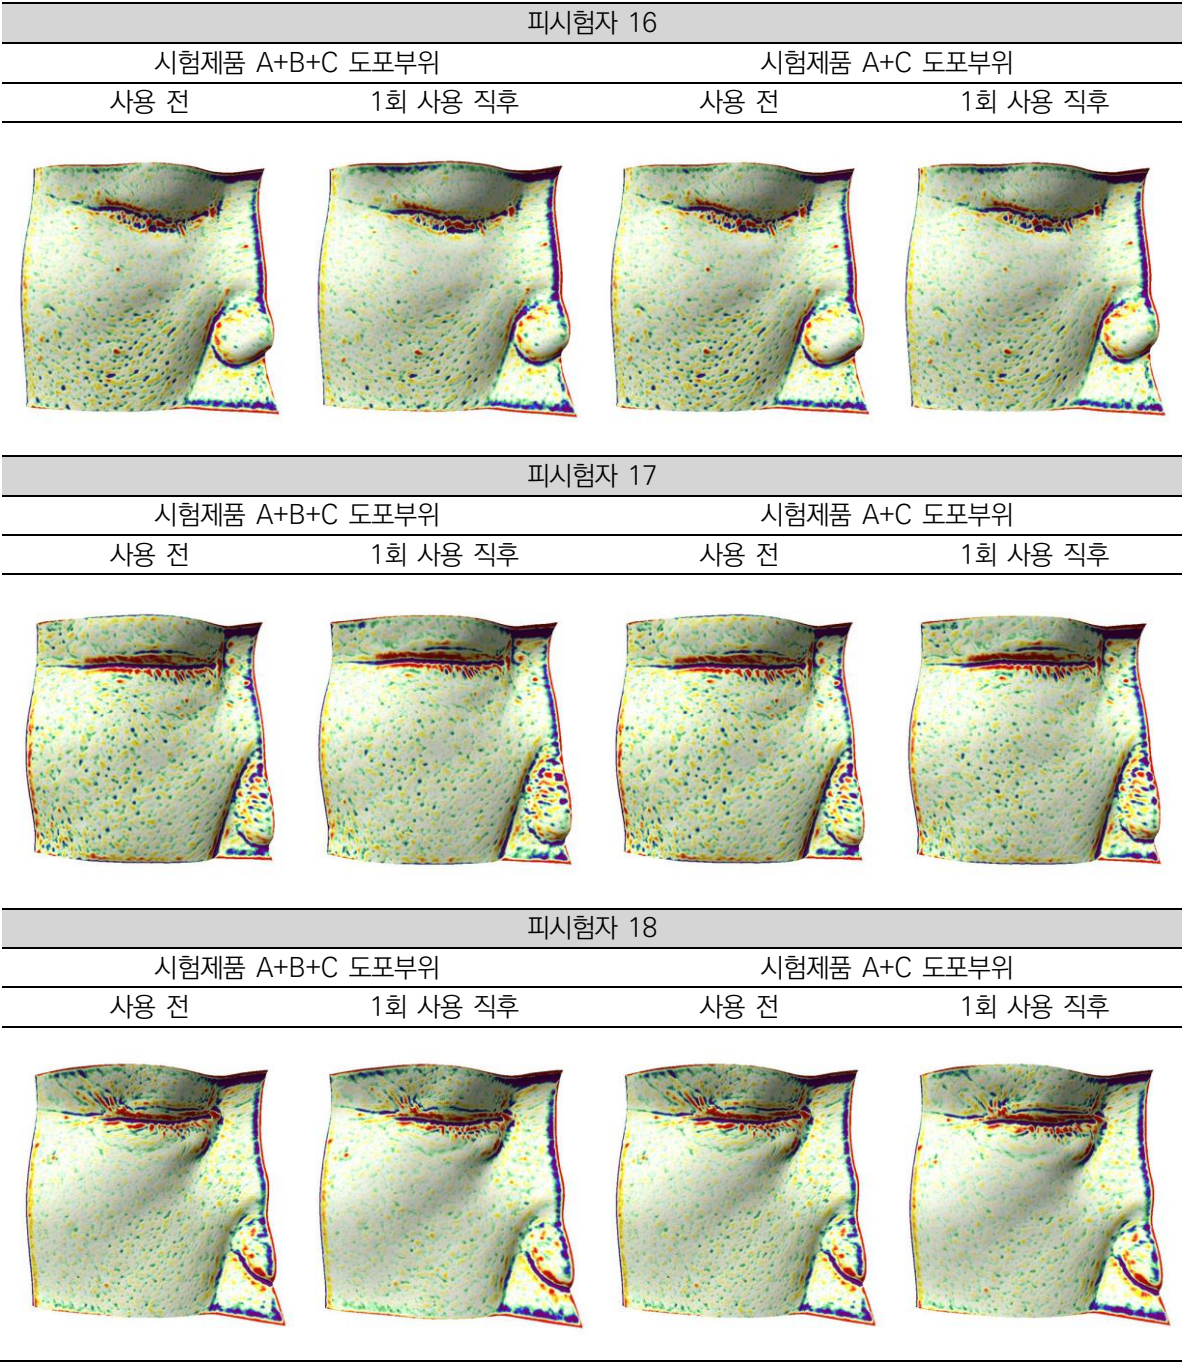

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.







피시험자 19			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

피시험자 20			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

피시험자 21			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 22			
시험제품 A+B+C 도포부위		시험제품 A+C 도포부위	
사용 전	1회 사용 직후	사용 전	1회 사용 직후
			

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



[별첨 3] 시험제품 전성분

오바코 타임슬립 워터맥스 크림(시험제품C)
정제수, 다이메틸설펜, 메틸프로판다이올, 부틸렌글라이콜, 알로에베라잎추출물, 흰목이버섯추출물, 암모늄아크릴로일다이메틸타우레이트/브이피코폴리머, 글리세린, 다이프로필렌글라이콜, 소듐하이알루로네이트, 포타슘하이알루로네이트, 하이드롤라이즈드소듐하이알루로네이트, 하이드롤라이즈드하이알루로닉애씨드, 하이알루로닉애씨드, 폴리글루타믹애씨드, 마텔추출물, 한련추출물, 보검선인장추출물, 오이열매추출물, 소듐디엔에이, 에스에이치-올리고펩타이드-1, 글루타민, 류신, 발린, 알라닌, 트레오닌, 페닐알라닌, 히스티딘, 1,2-핵산다이올, 하이드록시아세트페논, 피이지-60하이드로제네이티드캐스터오일, 카프릴릴글라이콜, 알란토인, 다이소뮴이디티에이, 글리세릴아크릴레이트/아크릴릭애씨드코폴리머, 프로필렌글라이콜, 에틸헥실글리세린, 향료


본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



[별첨 4] 시험제품 안전성 확인서

5A8D-38D5-1445-46BC

방송통신기자재등의 적합등록 필증	
Registration of Broadcasting and Communication Equipments	
상호 또는 성명 Trade Name or Registrant	(주)제이엘유
기자재명칭(제품명칭) Equipment Name	피부관리기
기기부호/추가 기기부호 Equipment code /Additional Equipment code	LARN8
기본모델명 Basic Model Number	HIDM
파생모델명 Series Model Number	
등록번호 Registration No.	R-R-Te5-HIDM
제조사/제조국가 Manufacturer/Country of Origin	(주)제이엘유/한국
등록연월일 Date of Registration	2024-06-20
기타 Others	
위 기자재는 「전파법」 제58조의2 제3항에 따라 등록되었음을 증명합니다. It is verified that foregoing equipment has been registered under the Clause 3, Article 58-2 of Radio Waves Act. 2024년(Year) 09월(Month) 19일(Day) 국립전파연구원장 Director General of National Radio Research Agency ※ 적합등록 방송통신기자재는 반드시 "적합성평가표시" 를 부착하여 유통하여야 합니다. 위반시 과태료 처분 및 등록이 취소될 수 있습니다.	



본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



[별첨 5] 시험기관 연구자의 약력 및 연구경력

1. 시험기관장/시험책임자의 약력 및 연구경력 및 실적

■ 안 인 숙 (연구원장·겸임교수·의학박사) (1975. 12. 10.)

경력사항

2005. 09	- 2008. 02	건국대학교 향장학(뷰티화장품학) 석사
2010. 03	- 2013. 02	건국대학교 향장생물학 박사
2011. 12	- 2015. 07	(주)비엔진 대표이사
2015. 10	- 2017. 10	제1 ~ 3회 한중화장품산업 국제공동포럼 [한국피부과학연구원/ (주)진셀팜 국제공동포럼] 주최자
2015. 07	- 현	재 (주)진셀팜 대표이사
2015. 07	- 현	재 한국피부과학연구원 연구원장
2017. 01	- 현	재 식품의약품안전처 화장품의약품 산·학·연·관 연구협의회 위원
2017. 01	- 현	재 식품의약품안전처 소비자위해예방평가위원회 위원
2017. 01	- 현	재 아시안뷰티화장품학술지(한국연구재단등재지) 편집위원
2017. 01	- 현	재 Biomedical Dermatology(국제저명 영문학술지) 편집위원
2017. 01	- 현	재 중국퍼스널케어제품 화장품산업기술혁신전략연합 특별 전문가(한국대표)
2017. 01	- 현	재 갯잇뷰티(CJ On Style TV채널 뷰티프로그램) 고정패널(화장품 전문가)
2017. 03	- 현	재 건국대학교 화장품공학과 산학겸임교수
2019. 01	- 현	재 부탁해요 여신님(대만 뷰티프로그램) 고정패널(화장품전문가)

수상경력

2007년	대한피부미용학회 우수논문상
2008년	건국대학교 산업대학원장상
2009년	대한피부미용학회 표창장
2016년	서울 한중 FTA 1주년 파트너십 유공자 포상

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



연구실적

- 국제저명 SCI급 학술논문

- Heo MJ, Choi SY, Lee C, *et al.* (2020) Perphenazine Attenuates the Pro-Inflammatory Responses in Mouse Models of Th2-Type Allergic Dermatitis. *Int. J. Mol. Sci.*, 21: E3241.
 - Choi M, Choi YM, Choi SY, *et al.* (2020) Glucose Metabolism Regulates Expression of Hair-Inductive Genes of Dermal Papilla Spheres via Histone Acetylation. *Sci. Rep.*, 10: 4887.
 - Heo MJ, Lee C, Choi SY, *et al.* (2020) Nintedanib ameliorates animal model of dermatitis. *Sci. Rep.*, 10: 4493.
 - Choi SY, Heo MJ, Lee C, *et al.* (2020) 2-deoxy-d-glucose Ameliorates Animal Models of Dermatitis. *Biomedicines.*, 8: 20.
 - Choi M, Choi YM, An IS, *et al.* (2020) E3 ligase RCHY1 negatively regulates HDAC2. *Biochem. Biophys. Res. Commun.*, 521: 37-41.
 - Lee YR, Bae S, Kim JY, *et al.* (2019) Monoterpenoid Loliolide Regulates Hair Follicle Inductivity of Human Dermal Papilla Cells by Activating the Akt/ β -Catenin Signaling Pathway. *J. Microbiol. Biotechnol.*, 29: 1830-1840.
 - Lee J, An S, Jung JH, *et al.* (2019) MUL1 E3 ligase regulates the antitumor effects of metformin in chemoresistant ovarian cancer cells via AKT degradation. *Int. J. Oncol.*, 54: 1833-1842.
 - Kim HM, Jung JH, Kim JY, *et al.* (2019) The Protective Effect of Violaxanthin from *Nannochloropsis oceanica* against Ultraviolet B-Induced Damage in Normal Human Dermal Fibroblasts. *Photochem. Photobiol.*, 95: 595-604.
 - Lee A, Kim JY, Heo J, *et al.* (2018) The Inhibition of Melanogenesis via the PKA and ERK Signaling Pathways by *Chlamydomonas reinhardtii* Extract in B16F10 Melanoma Cells and Artificial Human Skin Equivalents. *J. Microbiol. Biotechnol.*, 28: 2121-2132.
 - Hahn HJ, Kim KB, An IS, *et al.* (2017) Protective effects of rosmarinic acid against hydrogen peroxide-induced cellular senescence and the inflammatory response in normal human dermal fibroblasts. *Mol. Med. Rep.*, 16: 9763-9769.
 - Choi YM, An S, Lee J, *et al.* (2017) Titrated extract of *Centella asiatica* increases hair inductive property through inhibition of STAT signaling pathway in three-
- 본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



- dimensional spheroid cultured human dermal papilla cells. *Biosci. Biotechnol. Biochem.*, 81: 2323-2329.
- Kim K, An S, Choi BG, *et al.* (2017) Arctiin regulates collagen type 1 α chain 1 mRNA expression in human dermal fibroblasts via the miR-378b-SIRT6 axis. *Mol. Med. Rep.*, 16: 9120-9124.
 - Joo D, An S, Choi BG, *et al.* (2017) MicroRNA-378b regulates α -1-type 1 collagen expression via sirtuin 6 interference. *Mol. Med. Rep.*, 16: 8520-8524.
 - Lee JJ, Kim KB, Heo J, *et al.* (2017) Protective effect of *Arthrospira platensis* extracts against ultraviolet B-induced cellular senescence through inhibition of DNA damage and matrix metalloproteinase-1 expression in human dermal fibroblasts. *J. Photochem. Photobiol. B.*, 173: 196-203.
 - An S, Cha HJ, Ko JM, *et al.* (2017) Kinetin Improves Barrier Function of the Skin by Modulating Keratinocyte Differentiation Markers. *Ann. Dermatol.*, 29: 6-12.
 - Kwon SB, An S, Kim MJ, *et al.* (2017) Phytosphingosine-1-phosphate and epidermal growth factor synergistically restore extracellular matrix in human dermal fibroblasts *in vitro* and *in vivo*. *Int. J. Mol. Med.*, 39: 741-748.
 - Youn HJ, Kim KB, Han HS, *et al.* (2017) 23-Hydroxytormentic Acid Protects Human Dermal Fibroblasts by Attenuating UVA-induced Oxidative Stress. *Photoimmunol. Photomed.*, 33: 92-100.
 - Lee J, An S, Choi YM, *et al.* (2017) TRIAD1 Is a Novel Transcriptional Target of p53 and Regulates Nutlin-3a-Induced Cell Death. *J. Cell. Biochem.*, 118: 1733-1740.
 - Lee J, An S, Choi YM, *et al.* (2016) Musashi-2 is a novel regulator of paclitaxel sensitivity in ovarian cancer cells. *Int. J. Oncol.*, 49: 1945-1952.
 - Hahn HJ, Jung HJ, Schrammek-Drusios MC, *et al.* (2016) Instrumental evaluation of anti-aging effects of cosmetic formulations containing palmitoyl peptides, *Silybum marianum* seed oil, vitamin E and other functional ingredients on aged human skin. *Exp. Ther. Med.*, 12: 1171-1176.
 - Choi S, Youn J, Kim K, *et al.* (2016) Apigenin inhibits UVA-induced cytotoxicity *in vitro* and prevents signs of skin aging *in vivo*. *Int. J. Mol. Med.*, 38: 627-634.
 - Lee JJ, An S, Kim KB, *et al.* (2016) Extract of *Ettlia* sp. YC001 exerts photoprotective effects against UVB irradiation in normal human dermal fibroblasts. *J. Microbiol. Biotechnol.*, 28: 775-783.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



- Shin S, Kim K, Lee MJ, *et al.* (2016) Epigallocatechin Gallate-Mediated Alteration of the MicroRNA Expression Profile in 5 α -Dihydrotestosterone-Treated Human Dermal Papilla Cells. *Ann. Dermatol.*, 28: 327-334.
- Cha HJ, He C, Zhao H, *et al.* (2016) Intercellular and intracellular functions of ceramides and their metabolites in skin (Review). *Int. J. Mol. Med.*, 38: 16-20.
- Choi SJ, Lee SN, Kim K, *et al.* (2016) Biological effects of rutin on skin aging. *Int. J. Mol. Med.*, 38: 357-363.
- Joo DH, Cha HJ, Kim K, *et al.* (2015) Benzo(a)pyrene represses melanogenesis in B16F10 mouse melanoma cells. *Mol. Cell. Toxicol.*, 11: 349-355.
- Bae S, An IS, An S. (2015) Development of a high-throughput screening system for identification of novel reagents regulating DNA damage in human dermal fibroblasts. *Acta. Pharm.*, 65: 331-341.
- Lee KM, An S, Lee OK, *et al.* (2015) Analysis of changes in microRNA expression profiles in response to the troxerutin-mediated antioxidant effect in human dermal papilla cells. *Mol. Med. Rep.*, 12: 2650-2660.
- Lee BM, An S, Kim SY, *et al.* (2015) Topical application of a cleanser containing extracts of *Diospyros kaki folium*, *Polygonum cuspidatum* and *Castanea crenata* var. *dulcis* reduces skin oil content and pore size in human skin. *Biomed. Rep.*, 3: 343-346.
- Lee MJ, Cha HJ, Lim KM, *et al.* (2015) Analysis of the microRNA expression profile of normal human dermal papilla cells treated with 5 α -dihydrotestosterone. *Mol. Med. Rep.*, 12: 1205-1212.
- Lee OK, Cha HJ, Lee MJ, *et al.* (2015) Implication of microRNA regulation in para-phenylenediamine-induced cell death and senescence in normal human hair dermal papilla cells. *Mol. Med. Rep.*, 12: 921-936.
- Cha HJ, Lee OK, Kim SY, *et al.* (2015) MicroRNA expression profiling of *p*-phenylenediamine treatment in human keratinocyte cellline. *Mol. Cell. Toxicol.*, 11: 19-28.
- Cha HJ, Bae S, Kim K, *et al.* (2015) Overdosage of methylparaben induces cellular senescence *in vitro* and *in vivo*. *J. Invest. Dermatol.*, 135: 609-612.
- Bae S, Kim K, Cha HJ, *et al.* (2015) Low-dose γ -irradiation induces dual radio-adaptive responses depending on the post-irradiation time by altering microRNA

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



- expression profiles in normal human dermal fibroblasts. *Int. J. Mol. Med.*, 35: 227–237.
- Bae S, Lim K, Cha H, *et al.* (2014) Arctiin blocks hydrogen peroxide-induced senescence and cell death though microRNA expression changes in human dermal papilla cells. *Biol. Res.*, 47: 50.
 - Cha HJ, Kim OY, Lee GT, *et al.* (2014) Identification of ultraviolet B radiation-induced microRNAs in normal human dermal papilla cells. *Mol. Med. Rep.*, 10: 1663–1670.
 - Kim KB, Kim K, Bae S, *et al.* (2014) MicroRNA-1290 promotes asiatic acid-induced apoptosis by decreasing BCL2 protein level in A549 non-small cell lung carcinoma cells. *Oncol. Rep.*, 32: 1029–1036.
 - Bae S, Kim K, Cha HJ, *et al.* (2014) Altered microRNA expression profiles are involved in resistance to low-dose ionizing radiation in the absence of BMI1 in human dermal fibroblasts. *Int. J. Oncol.*, 45: 1618–1628.
 - Cha HJ, Lee GT, Lee KS, *et al.* (2014) Photoprotective effect of arctiin against ultraviolet B-induced damage in HaCaT keratinocytes is mediated by microRNA expression changes. *Mol. Med. Rep.*, 10: 1363–1370.
 - Kwon KJ, Bae S, Kim K, *et al.* (2014) Asiaticoside, a component of *Centella asiatica*, inhibits melanogenesis in B16F10 mouse melanoma. *Mol. Med. Rep.*, 10: 503–507.
 - Kim OY, Cha HJ, Ahn KJ, *et al.* (2014) Identification of microRNAs involved in growth arrest and cell death in hydrogen peroxide-treated human dermal papilla cells. *Mol. Med. Rep.*, 10: 145–154.
 - Cha HJ, Lee KS, Lee GT, *et al.* (2014) Altered miRNA expression profiles are involved in the protective effects of troxerutin against ultraviolet B radiation in normal human dermal fibroblasts. *Int. J. Mol. Med.*, 33: 957–963.
 - Lee KS, Cha HJ, Lee GT, *et al.* (2014) Troxerutin induces protective effects against ultraviolet B radiation through the alteration of microRNA expression in human HaCaT keratinocyte cells. *Int. J. Mol. Med.*, 33: 934–942.
 - Lee GT, Cha HJ, Lee KS, *et al.* (2014) Arctiin induces an UVB protective effect in human dermal fibroblast cells through microRNA expression changes. *Int. J. Mol. Med.*, 33: 640–648.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



- Bae S, Lee EJ, Lee JH, *et al.* (2014) Oridonin protects HaCaT keratinocytes against hydrogen peroxide-induced oxidative stress by altering microRNA expression. *Int. J. Mol. Med.*, 33: 185–193.
- Lee EJ, Cha HJ, Ahn KJ, *et al.* (2013) Oridonin exerts protective effects against hydrogen peroxide-induced damage by altering microRNA expression profiles in human dermal fibroblasts. *Int. J. Mol. Med.*, 32: 1345–1354.
- An IS, An S, Park S, *et al.* (2013) Involvement of microRNAs in epigallocatechin gallate-mediated UVB protection in human dermal fibroblasts. *Oncol. Rep.*, 29: 253–259.
- An IS, An S, Kwon KJ, *et al.* (2013) Ginsenoside Rh2 mediates changes in the microRNA expression profile of human non-small cell lung cancer A549 cells. *Oncol. Rep.*, 29: 523–528.
- Kim K, An S, Cha HJ, *et al.* (2012) Lenalidomide induces apoptosis and alters gene expression in non-small cell lung cancer cells. *Oncol. Lett.*, 5: 588–592.
- An IS, An S, Choe TO, *et al.* (2012) *Centella asiatica* protects against UVB-induced HaCaT keratinocyte damage through microRNA expression changes. *Int. J. Mol. Med.*, 30: 1349–1356.
- An IS, An S, Kang SM, *et al.* (2012) Titrated extract of *Centella asiatica* provides a UVB protective effect by altering microRNA expression profiles in human dermal fibroblasts. *Int. J. Mol. Med.*, 30: 1194–1202.
- Bae S, Kim SY, Jung JH, *et al.* (2012) Akt is negatively regulated by the MULAN E3 ligase. *Cell Res.*, 22: 873–885.
- Bae S, Jeong HJ, Cha HJ, *et al.* (2012) The hypoxia-mimetic agent cobalt chloride induces cell cycle arrest and alters gene expression in U266 multiple myeloma cells. *Int. J. Mol. Med.*, 30: 1180–1186.
- Bae S, Jung JH, An IS, *et al.* (2012) TRIAD1 is negatively regulated by the MDM2 E3 ligase. *Oncol. Rep.*, 28: 1924–1928.
- Bae S, Jung JH, Kim K, *et al.* (2012) TRIAD1 inhibits MDM2-mediated p53 ubiquitination and degradation. *FEBS Lett.*, 586: 3057–3063.
- Choi YM, An S, Lee EM, *et al.* (2012) CYP1A1 is a target of miR-892a-mediated post-transcriptional repression. *Int. J. Oncol.*, 41: 331–336.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



– 한국연구재단등재 학술논문

- 김지예, 배승희, 정진혁 외. (2018) Coptis chinensis 추출물의 JNK/AP1 Axis을 통한 인간진피 섬유아세포 내 MMP1 발현 억제 효능. *Asian J. Beauty. Cosmetol.*, 16: 427-435.
- 정인, 안인숙, 안성관. (2018) 국가별 베이스 메이크업 제품의 색상 비교. *Asian J. Beauty. Cosmetol.*, 16: 277-286.
- 최미나, 나은주, 안인숙 외. (2018) 인간 진피섬유아세포에서의 하이드록시티로졸의 산화 억제 효능. *Asian J. Beauty. Cosmetol.*, 16: 113-121.
- 용희정, 김규리, 안진정 외. (2018) Embelin의 세포사멸 억제 및 항염 효능. *Asian J. Beauty. Cosmetol.*, 16: 103-112.
- 이송정, 한효선, 안인숙 외. (2016) Amentoflavone의 항염증 및 세포 보호 효과. *Asian J. Beauty. Cosmetol.*, 14: 201-211.
- 김경숙, 한송희, 안인숙 외. (2016) UVA가 유도하는 산화적 스트레스에 Ellagic Acid가 미치는 인간 모유두 세포 보호효과. *Asian J. Beauty. Cosmetol.*, 14: 191-200.
- 김기쁨, 조아령, 차화준 외. (2015) Sericine과 Alpha-Mangostin의 주름개선 상승효과. *대한피부미용학회지*, 13: 729-734.
- 최민화, 배승희, 권승빈 외. (2015) Silica gel을 이용한 피부세포 수화능력 비교분석 연구. *대한피부미용학회지*, 13: 615-621.
- 차화준, 권승빈, 김지현 외. (2015) Image J 프로그램을 사용한 모공측정 및 노화도의 새로운 정량분석법 개발과 화장품 인체적용시험에의 활용. *대한피부미용학회지*, 13: 477-482.
- 조정남, 안인숙, 장현희 외. (2015) 귀리추출물을 함유한 크림이 중년여성의 안면홍조 완화에 미치는 효과. *대한피부미용학회지*, 13: 361-366.
- 김수연, 김민정, 안규중 외. (2015) 과산화수소(H₂O₂)에 의해 유도된 인간 각질형성세포 주 손상에 대한 키네티(Kinetin)의 항산화 효과. *대한피부미용학회지*, 13: 59-64.
- 조지희, 윤혜정, 안규중 외. (2015) 10대 여고생들의 입술화장품 사용이 입술에 미치는 영향. *대한피부미용학회지*, 13: 27-34.
- 조춘희, 김수연, 안인숙. (2014) 병풀(*Centella asiatica*) 추출물을 이용한 20~50대 여성의 두피 홍반 개선 효과. *대한피부미용학회지*, 12: 921-927.
- 김수영, 임정옥, 안인숙 외. (2014) 코코넛오일이 피부장벽 기능에 미치는 효과. *대한피부미용학회지*, 12: 907-914.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



- 김기쁨, 이정주, 허진아 외. (2014) *Chlorella vulgaris* 미세조류 추출물의 자외선B 의존적 인간 진피섬유아세포 손상에 대한 보호 효능 연구. *대한피부미용학회지*, 12: 479-486.
- 김가람, 차훈, 송희경 외. (2014) 당유자 미숙과 동결건조 추출물이 멜라닌 생성에 미치는 영향. *대한피부미용학회지*, 12: 403-408.
- 이민지, 김현수, 조아령 외. (2014) 갈락토미세스 발효여과물을 함유한 에센스타입 화장료가 각질, 모공, 피지, 피부뻣기, 여드름 개선에 미치는 영향. *대한피부미용학회지*, 12: 77-84.
- 오봉윤, 이유석, 강정화 외. (2013) 토마토 잎 초임계 추출물의 피부 색소침착 억제 효과. *대한피부미용학회지*, 11: 1129-1136.
- 최성진, 백승우, 최민화 외. (2013) 카올린, 아데노신 및 식물복합추출물이 함유된 안면팩의 피부개선 효과. *대한피부미용학회지*, 11: 993-1000.
- 오봉윤, 이유석, 남승희 외. (2013) 딸기 식물체 추출물의 미백 및 주름 개선 효과. *대한피부미용학회지*, 11: 969-974.
- 정인, 안인숙, 안성관. (2013) 성인여드름 피부의 자외선차단제 사용 실태 및 물리적 자외선차단제의 세안 방법에 따른 세정력 비교 연구. *대한피부미용학회지*, 11: 959-968.
- 권승빈, 이강태, 최성진 외. (2013) 글리세린, 히알루론산, 실리콘 오일이 피부의 보습 및 경피수분손실량에 미치는 효과. *대한피부미용학회지*, 11: 761-768.
- 윤영민, 배승희, 안성관 외. (2013) 자외선(Ultraviolet)이 피부 및 피부세포 내 신호전달 체계에 미치는 영향. *대한피부미용학회지*, 11: 417-426.
- 강윤숙, 이나경, 안인숙. (2013) 피부관리실의 직무환경이 직업안정성에 미치는 영향. *대한피부미용학회지*, 11: 269-274.
- 이보미, 권승빈, 안성관 외. (2013) 국내 화장품 표시·광고 관리 가이드라인 및 실증에 관한 규정. *대한피부미용학회지*, 11: 11-15.
- 윤영민, 최성진, 박우정 외. (2012) *Bifidobacterium longum* 추출물의 자외선B에 대한 인간 진피섬유아세포 보호 효능. *대한피부미용학회지*, 10: 887-891.
- 권경자, 김수연, 안인숙. (2012) 골근테라피(Skeletal Muscle Therapy)가 20-30대 남성 얼굴 크기 변화에 미치는 영향. *대한피부미용학회지*, 10: 803-808.
- 홍미선, 윤영민, 안성관 외. (2012) 인간 진피 섬유아세포에서 천연성분 퀴세틴의 작용기전. *대한피부미용학회지*, 10: 571-579.
- 안인숙, 김지혜, 유희숙 외. (2007) B16F10 mouse melanoma 세포에서의 L-cysteine에 의한 멜라닌 생성 억제. *대한피부미용학회지*, 5: 239-246.
- 박인애, 안인숙. (2007) 유화제와 액정 형성에 관한 연구. *대한피부미용학회지*, 5: 119-129.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



- 국내외 특허

- [국내특허] 천연 복합 추출물을 유효성분으로 함유하는 안티폴루션 화장품 조성물 (2019. 04. 30)
- [국내특허] 청호 추출물, 은행잎 추출물 및 무화과 추출물을 유효성분으로 포함하는 항균 및 항염 조성물 (2018. 12. 06)
- [국내특허] 비올라잔틴을 유효성분으로 포함하는 화장품 조성물 (2017. 12. 14)
- [국내특허] 폴리스타틴 유래 생리활성 펩타이드, 및 이의 용도 (2017. 08. 22)
- [국내특허] 청호 복합 추출물을 유효성분으로 포함하는 모낭충 제거용 화장품 조성물 (2017. 06. 01)
- [국내특허] 나노클로롭시스 오세아니카 추출물을 유효성분으로 포함하는 화장품 조성물 (2016. 12. 28)
- [국내특허] 부레옥잠 추출물을 유효성분으로 함유하는 화장품 조성물 (2016.12.08)
- [국내특허] 관음죽 및 인도 고무나무 추출물을 유효성분으로 함유하는 중금속 또는 미세 먼지 제거용 화장품 조성물 (2016. 08. 18)
- [국내특허] 국화 추출물을 유효성분으로 함유하는 중금속 또는 미세먼지 제거용 화장품 조성물 (2016. 08. 18)
- [국내특허] 인도 보리수 나무 추출물을 유효성분으로 함유하는 중금속 또는 미세먼지 제거용 화장품 조성물 (2016. 08. 18)
- [국내특허] 모발 성장 촉진 활성을 가지는 펩타이드, 및 이의 용도 (2016. 08. 17)
- [국내특허] 미백 활성이 우수한 펩타이드, 및 이의 용도 (2016. 08. 17)
- [국내특허] 미세먼지 흡착 및 제거용 펩타이드, 및 이의 용도 (2016. 08. 17)
- [국내특허] 백모증 개선 효과를 가지는 펩타이드, 및 이의 용도 (2016. 08. 17)
- [국내특허] 주름 개선 및 미백 효과를 가지는 펩타이드, 및 이의 용도 (2016. 08. 17)
- [국내특허] 주름 개선 및 항노화 효과를 가지는 펩타이드, 및 이의 용도 (2016. 08. 17)
- [국내특허] 주름 개선 활성 및 피부 개선 효과를 가지는 펩타이드, 및 이의 용도 (2016. 08. 17)
- [국내특허] 주름 개선용 펩타이드, 및 이의 용도 (2016. 08. 17)
- [국내특허] 지방분해 촉진 효과를 가지는 펩타이드, 및 이의 용도 (2016. 08. 17)
- [국내특허] 피부 상태 개선 및 모발 성장 촉진 효과를 가지는 펩타이드, 및 이의 용도 (2016. 08. 17)
- [국내특허] 항염 활성 및 피부 개선 효과를 가지는 펩타이드, 및 이의 용도 (2016. 08. 17)

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



- [국내특허] 항염증 활성을 가지는 펩타이드, 및 이의 용도 (2016. 08. 17)
- [국내특허] 식물공장유래 병풀 추출물을 유효성분으로 하는 피부개선용 조성물 및 증식성 피부 질환 예방 또는 치료용 조성물 (2016. 03. 14)
- [국내특허] 개똥쑥 발효 추출물을 유효성분으로 하는 피부개선용 조성물 (2016. 02. 29)
- [국내특허] 오미자 발효 추출물을 유효성분으로 하는 미백 및 피부개선용 조성물 (2016. 02. 29)
- [국내특허] 복합효모 균체 파쇄 발효배양액을 유효성분으로 하는 피부개선용 조성물 및 증식성 피부질환 예방 또는 치료용 조성물 (2016. 02. 26)
- [국내특허] 산호수 및 벵갈고무나무 수지 추출물을 유효성분으로 하는 미세먼지 흡착 및 제거용 화장료 조성물 (2016. 02. 26)
- [국내특허] 기린초 발효 추출물을 유효성분으로 하는 피부개선용 조성물 및 증식성 피부 질환 예방 또는 치료용 조성물 (2016. 02. 19)
- [국내특허] 복합유산균 파쇄액 및 마치현의 발효 추출물을 유효성분으로 하는 피부개선용 조성물 및 증식성 피부질환 예방 또는 치료용 조성물 (2016. 02. 19)
- [국내특허] 영생초 및 바다제비집 복합발효 추출물을 유효성분으로 하는 피부개선용 조성물 및 증식성 피부질환 예방 또는 치료용 조성물 (2016. 02. 19)
- [국내특허] 클리나칸투스 누탄스 추출물을 유효성분으로 포함하는 피부 개선용 화장료 조성물 (2014. 11. 11)
- [국내특허] MITF의 조절자 및 멜라닌 색소성 질환 치료제로서의 STUB1 용도 (2014. 08. 29)
- [국내특허] 바다제비집 및 병풀의 복합발효추출물을 유효성분으로 포함하는 피부 자극 완화용 조성물 (2013. 07. 02)
- [국내특허] 피부 임상시험을 위한 기준점 설정 방법 및 장치 (2013. 01. 09)
- [국내특허] 피부 외용제 테스트 방법 (2021. 05. 28)
- [국내특허] 피부 분석 방법 (2021. 07. 12)

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



2. 시험담당자의 약력 및 연구실적

■ 권 승 빈 (연구소장·의학박사) (1980. 10. 16.)

학 력

2011. 03 - 2014. 02 건국대학교 생물공학과 박사

경력사항

2009. 08 - 2012. 02 경일대학교, 선린대학, 수성대학교 등 강의를
 2011. 08 - 2012. 02 수성대학교·교육과학기술부 산업수요맞춤형 교육과정개발위원
 2012. 10 - 현 재 한국피부과학연구원 연구소장
 2014. 03 - 2016. 06 건국대학교 미래지식교육원 강의를
 2016. 01 - 현 재 Asian Journal of Beauty and Cosmetology 논문심사위원
 2017. 09 - 2023. 02 건국대학교 화장품공학과 산학겸임교수
 2022. 09 - 현 재 한국신뢰성보증연구협동조합(KSQA) 정회원
 2023. 05 - 현 재 한국동물실험대체법학회 정회원

수상경력

2007년 국제뷰티산업학회 우수논문상

연구실적

- 국제저명 SCI급 학술논문

- Kwon SB, An S, *et al.* (2017) Phytosphingosine-1-phosphate and epidermal growth factor synergistically restore extracellular matrix in human dermal fibroblasts *in vitro* and *in vivo*. *Int. J. Mol. Med.*, 39: 741-748.
- Hahn HJ, Jung HJ, *et al.* (2016) Instrumental evaluation of anti-aging effects of cosmetic formulations containing palmitoyl peptides, *Silybum marianum* seed oil, vitamin E and other functional ingredients on aged human skin. *Exp. Ther. Med.*, 12: 1171-1176.
- Choi SJ, Lee SN, *et al.* (2016) Biological effects of rutin on skin aging. *Int. J. Mol. Med.*, 38: 357-363.
- Cha HJ, Bae S, Kim K, *et al.* (2015) Overdosage of methylparaben induces cellular senescence *in vitro* and *in vivo*. *J. Invest. Dermatol.*, 135: 609-612.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



- Cha HJ, Lee KS, Lee GT, *et al.* (2014) Altered miRNA expression profiles are involved in the protective effects of troxerutin against ultraviolet B radiation in normal human dermal fibroblasts. *Int. J. Mol. Med.*, 33: 957-963.

-학술논문 및 학술대회 포스터 발표

- 주예은, 권승빈 외. (2022) Effects of 'NEOGEN V.BIOME LIPOSOME™' on the Increased Expression of COL1A1 and HAS2 mRNA in Human Dermal Fibroblasts. *Asian J Beauty Cosmetol.*, 2022; 20(4): 451-459.
- 최민화, 배승희, 권승빈 외. (2015) Silica gel을 이용한 피부세포 수화능력 비교분석 연구. *대한피부미용학회지*, 13: 615-621.
- 차화준, 권승빈, 김지현 외. (2015) Image J 프로그램을 사용한 모공측정 및 노화도의 새로운 정량분석법 개발과 화장품 인체적용시험에의 활용. *대한피부미용학회지*, 13: 477-482.
- 이보미, 이경록, 권승빈 외. (2014) 감나무 잎 추출물, 율피 추출물, 호장근 추출물을 함유한 화장품의 안전성 및 인체효능평가 연구. *대한피부미용학회지*, 12: 361-370.
- 김지현, 조아령, 권승빈. (2014) 아시아 마사지 테크닉. *대한피부미용학회지*, 12: 9-15.
- 오봉윤, 이유석, 남승희 외. (2013) 딸기 식물체 추출물의 미백 및 주름 개선 효과. *대한피부미용학회지*, 11: 969-974.
- 권승빈, 이강태, 최성진 외. (2013) 글리세린, 히알루론산, 실리콘 오일이 피부의 보습 및 경피수분손실량에 미치는 효과. *대한피부미용학회지*, 11: 761-768.
- 이보미, 권승빈, 안성관 외. (2013) 국내 화장품 표시·광고 관리 가이드라인 및 실증에 관한 규정. *대한피부미용학회지*, 11: 11-15.
- 이나경, 이보미, 권승빈. (2013) 피부미용과 학생들의 직업 및 직장선택 시 직무환경의 선호도에 관한 연구. *대한피부미용학회지*, 11: 119-132.
- 최성진, 권승빈, 이보미, 안인숙. (2012) 비소세포성 폐암 세포주 A549에서 Ginsenoside Rh2에 의한 miRNA 발현변화분석. *대한피부미용학회지* 추계학술대회 포스터 발표.
- 안인숙, 권승빈. (2012) HaCaT keratinocyte에서 miRNA 발현 변화를 통한 *Centella asiatica*의 UVB 보호 효과. *대한피부미용학회지* 추계학술대회 포스터 발표.
- 안인숙, 이보미, 권승빈, 최성진. (2012) 인간진피섬유아세포에서 TECA에 의한 UVB 보호효과 및 miRNA 발현변화 프로파일링. *대한피부미용학회지* 추계학술대회 포스터 발표.
- 권승빈 외. (2012) A Comparative Study on Japanese and Korean Female College Students' Purchasing and Using Behaviors of Cosmetics. 대한미용과학회 대만국제학술대회 포스터발표.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



- 권승빈 외. (2011) 한국과 일본 여자대학생의 신체만족도와 외모관리행동에 관한 비교분석. 대한미용과학회 추계학술대회 포스터발표.
- 권승빈 외. (2011) 여자대학생의 외모관리행동에 관한 연구. 대한미용과학회 추계학술대회 포스터발표.
- 권승빈 외. (2011) 여대생의 미용관련태도별 신체만족도 요인 차이 분석. 대한미용과학회 하계학술대회 포스터발표.
- 권승빈 외. (2010) Comparative Analysis between Japanese and South Korean Female College Students on appearance management behavior. 대한미용과학회 중국국제학술대회 포스터발표.
- 권승빈, 이강태, 최성진, 이나경, 박현우, 이광식, 이건국, 안규중, 안인숙. (2013) 글리세린, 히아루론산, 실리콘 오일이 피부의 보습 및 경피수분손실량에 미치는 효과. *대한피부미용학회지*, 11: 761-768.
- 오봉윤, 이유석, 남승희, 이선경, 권승빈, 안인숙, 나해영, 정경주, 강정화. (2013) 딸기 식물체 추출물의 미백 및 주름 개선 효과. *대한피부미용학회지*, 11: 969-974.
- 권승빈, 안인숙. (2013) 인간 각질세포주 모델에서 병풀 추출물에 의한 마이크로유전자 발현 변화 분석에 대한 연구. *대한피부미용학회지* 춘계학술대회 포스터 발표.
- 임초롱, 이보미, 권승빈, 윤영민. (2013) 인간 진피섬유아세포에서 실리비닌(Silibinin)의 항노화 효과. *대한피부미용학회지* 춘계학술대회 포스터 발표.
- 권승빈. (2013) Phytosphingosine-1-phosphate와 Epidermal growth factor가 세포 내 신호전달에 미치는 영향. *대한피부미용학회지* 추계학술대회 포스터 발표.
- 권승빈, 안인숙. (2013) 인간 각질세포에서 센텔라아시아티카 특이적 마이크로알엔에이 발굴. *대한피부미용학회지* 추계학술대회 포스터 발표.

- 국내외 특허

- [국내특허] 피부 임상시험을 위한 기준점 설정 방법 및 장치 (2013. 01. 09)
- [국내특허] 피부 외용제 테스트 방법 (2021. 05. 28)
- [국내특허] 피부 분석 방법 (2021. 07. 12)

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



■ 김 윤 (연구실장) (1989. 04. 26.)

학 력

2012. 02 중앙대학교 식물응용과학과 학사

경력사항

2012. 04 - 2018. 02 대한피부과학연구소 선임연구원

2018. 06 - 2023. 02 피엔케이피부임상연구센터 책임연구원

2023. 03 - 현 재 한국피부과학연구원 연구실장

■ 김 현 경 (주임연구원) (1990. 10. 24.)

학 력

2017. 02 상지대학교 화학과 학사

경력사항

2018. 01 - 현 재 한국피부과학연구원 주임연구원

연구실적

- 국내외 특허

• [국내특허] 피부 분석 방법 (2021. 07. 12)

■ 김 유 라 (주임연구원) (1992. 06. 29.)

학 력

2017. 02 서울시립대학교 일반대학원 생명과학과 석사

경력사항

2017. 03 - 2022.01 (주)엘리드 선임연구원

2022. 01 - 2023.03 한스바이오메드(주) 임상연구사업부 대리

2023. 09 - 현 재 한국피부과학연구원 주임연구원

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



■ 김 명 선 (주임연구원) (1994. 12. 26.)

학 력

2018. 08 이화여자대학교 화학나노과학과 학사

경력사항

2019. 08 - 2022. 03 피엔케이피부임상연구센터 연구원

2023. 01 - 현 재 한국피부과학연구원 주임연구원

■ 황 여 진 (주임연구원) (1994. 09. 07.)

학 력

2019. 08 동국대학교 화공생물공학과 학사

경력사항

2019. 03 - 2024. 01 피엔케이피부임상연구센터 주임연구원

2024. 04 - 현 재 한국피부과학연구원 주임연구원

■ 김 미 지 (연구원) (1998. 10. 04.)

학 력

2023. 08 숭실사이버대학교 뷰티미용예술학과 학사

경력사항

2019. 01 - 2022. 02 피엔케이피부임상연구센터 보조연구원

2022. 03 - 현 재 한국피부과학연구원 연구원

■ 안 정 원 (연구원) (1996. 03. 05.)

학 력

2022. 02 대구한의대학교 화장품약리학과 학사

경력사항

2021. 10 - 현 재 한국피부과학연구원 연구원

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



■ 주 예 은 (선임연구원) (1989. 12. 11.)

학 력

2018. 02 건국대학교 일반대학원 화장품공학과 박사

경력사항

2016. 04 - 현 재 한국피부과학연구원 선임연구원

■ 신 상 훈 (선임연구원) (1989. 10. 31.)

학 력

2016. 03 건국대학교 생물공학과 박사수료

경력사항

2016. 04 - 현 재 한국피부과학연구원 선임연구원

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



3. 신뢰성 보증 책임자의 약력 및 연구실적

■ 김 가 램 (신뢰성 보증 책임자·공학박사)(1984. 11. 03.)

경력사항

2010. 03	- 2012. 02	건국대학교 일반대학원 생물공학과 석사
2012. 03	- 2016. 08	건국대학교 일반대학원 생물공학과 박사
2012. 03	- 2020. 04	한국피부과학연구원 선임연구원
2020. 05	- 현 재	한국피부과학연구원 신뢰성 보증 책임자
2018. 03	- 현 재	건국대학교 화장품공학과 산학겸임교수

연구실적

－ 국제저명 SCI급 학술논문

- Lee J, An S, Jung JH, *et al.* (2019) MUL1 E3 ligase regulates the antitumor effects of metformin in chemoresistant ovarian cancer cells via AKT degradation. *Int. J. Oncol.*, 54: 1833-1842.
- Kim K, An S, Choi BG, *et al.* (2017) Arctiin regulates collagen type 1 α chain 1 mRNA expression in human dermal fibroblasts via the miR-378b-SIRT6 axis. *Mol. Med. Rep.*, 16: 9120-9124.
- Joo DH, An S, Choi BG, *et al.* (2017) MicroRNA-378b regulates α -1-type 1 collagen expression via sirtuin 6 interference. *Mol. Med. Rep.*, 16: 8520-8524.
- Shin S, Kim K, Lee MJ, *et al.* (2016) Epigallocatechin Gallate-Mediated Alteration of the MicroRNA Expression Profile in 5 α -Dihydrotestosterone-Treated Human Dermal Papilla Cells. *Ann. Dermatol.*, 28: 327-334.
- Choi S, Youn J, Kim K, *et al.* (2016) Apigenin inhibits UVA-induced cytotoxicity *in vitro* and prevents signs of skin aging *in vivo*. *Int. J. Mol. Med.*, 38: 627-634.
- Hahn HJ, Youn HJ, Cha HJ, *et al.* (2016) Single Low-Dose Radiation Induced Regulation of Keratinocyte Differentiation in Calcium-Induced HaCaT Cells. *Ann. Dermatol.*, 28: 433-437.
- Cha HJ, Bae S, Kim K, *et al.* (2015) Overdosage of methylparaben induces cellular senescence *in vitro* and *in vivo*. *J. Invest. Dermatol.*, 135: 609-612.
- Bae S, Kim K, Cha HJ, *et al.* (2015) Low-dose γ -irradiation induces dual radio-adaptive responses depending on the post-irradiation time by altering microRNA

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



expression profiles in normal human dermal fibroblasts. *Int. J. Mol. Med.*, 35: 227–237.

- Bae S, Kim K, Cha HJ, *et al.* (2014) Altered microRNA expression profiles are involved in resistance to low-dose ionizing radiation in the absence of BMI1 in human dermal fibroblasts. *Int. J. Oncol.*, 45: 1618–1628.
- Kim K, An S, Cha HJ, *et al.* (2012) Lenalidomide induces apoptosis and alters gene expression in non-small cell lung cancer cells. *Oncol. Left.*, 5: 588–592.
- Bae S, Kim SY, Jung JH, *et al.* (2012) Akt is negatively regulated by the MULAN E3 ligase. *Cell Res.*, 22: 873–885.
- Bae S, Jeong HJ, Cha HJ, *et al.* (2012) The hypoxia-mimetic agent cobalt chloride induces cell cycle arrest and alters gene expression in U266 multiple myeloma cells. *Int. J. Mol. Med.*, 30: 1180–1186.
- Bae S, Jung JH, Kim K, *et al.* (2012) TRIAD1 inhibits MDM2-mediated p53 ubiquitination and degradation. *FEBS Lett.*, 586: 3057–3063.
- Choi YM, An S, Lee EM, *et al.* (2012) CYP1A1 is a target of miR-892a-mediated posttranscriptional repression. *Int. J. Oncol.*, 41: 331–336.
- Bae S, Lee EM, Cha HJ, *et al.* (2011) Resveratrol alters microRNA expression profiles in A549 human non-small cell lung cancer cells. *Mol. Cells*, 32: 243–249.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

[별첨 6] 시험기관의 주요설비

1. 일반사항

한국피부과학연구원은 식품의약품안전처의 '화장품법', '의약품, 의약외품, 화장품 및 의료기기 검사기관 지정 등에 관한 규정', '의약품 임상시험 관리기준', '화장품 인체적용시험 및 효력시험 가이드라인', '화장품 표시·광고 실증을 위한 시험방법 가이드라인', '기능성화장품의 유효성평가를 위한 가이드라인', 보건복지부의 '생명윤리 및 안전에 관한 법률', 미래창조과학부의 '연구실 안전환경 조성에 관한 법률' 등을 기준으로, 실험수 약 2783.63 m² 규모의 연구시설을 설치·운영하고 있음.

한국피부과학연구원의 전체 시설은 시험의 신뢰성에 영향을 주는 간섭을 최소화 하고 연구에 필요한 사항이 충족되도록 최적의 크기, 구조, 설비, 배치, 전원, 조명, 보안, 냉난방 및 환기시설 등을 갖추고 있으며, 전체 임상시험 공간은 항온항습설비 등을 통해 제어하고 있음.

시험결과의 신뢰성을 위하여 시험검사 장소의 출입은 통제되고 제한되도록 하고 있으며, 시험검사실 각각은 적절하게 분리되어 각 시험계와 시험검사구역에서 각각 시험이 적절하게 실시될 수 있도록 하고, 교차 오염이 발생되지 않도록 위생적으로 관리하고 있음.

모든 시험검사 시설 및 설비는 품질매뉴얼의 관리체계에 따라 정기적으로 점검 및 기록 관리되고 있으며, 자격요건에 적합한 연구원만이 조작하도록 하고 있음.

시험검사를 포함한 모든 업무는 연구원장이 승인한 문서화된 표준작업지침서(Standard Operating Procedure; SOP)에 따라 수행되고 있음.

피시험자에 대한 모든 자료는 보건복지부의 '생명윤리 및 안전에 관한 법률' 등에 근거하여 철저히 관리하고 있으며, 한국피부과학연구원에서 자체 개발한 피시험자 관리용 컴퓨터프로그램을 통해 전자자료 형태로 보안 관리하고 있음.

시험검사에 대한 일련의 기록 및 자료, 전자자료, 컴퓨터서버 등은 보안이 유지된 상태로 연구원내 자료보관실에 안전하게 보존하고 있으며, 불가피한 사유로 보존기간이 만료되기 전에 처분되는 경우 정당한 절차를 거쳐 기록으로 남기고 있음. 또한 컴퓨터서버에 대한 접근 및 자료보관실 출입은 연구원장에 의해 권한을 받은 담당자에게만 허용되며, 자료보관실로부터 기록의 출납이나 반입은 적절한 방법으로 기록되고 있음.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



2. 주요 내부시설

연구실명	규격 및 기타
세콤보안 및 폐쇄회로TV 보안센터	SECOM and CCTV Security Sector
항온항습센터	Constant Temperature and Humidity Sector
임상자료분석실	Clinical Data Analysis Room
임상효능평가실	Clinical Efficacy Room
유효성평가실	Efficacy Evaluation Room
안전성평가실	Safety Evaluation Room
기능성평가실	Functional Evaluation Room
자외선조사실	UV Irradiation Room
내수성평가실	Waterproof Evaluation Room
세포효능평가실	Cellular Efficacy Room
3차원 피부세포배양실	3D Skin Cell Culture Room
3차원 입체영상처리실	3D Image Processing Room
비임상시험 분석기기실	<i>In vitro</i> Experiment Equipment Room
촬영실	Studio
자료보관실	Data Storage Room
세안실	Washing Room
피시험자 대기실	Volunteer Waiting Room
피시험자 상담실	Volunteer Counseling Room
피시험자 탈의실	Volunteer Locker Room
회의실	Conference Room
연구원장실	Office for Director
연구원실	Office for Researchers
행정실	Administrative Office
현미경실	Microscope Room
암실 및 영상필름 분석실	Dark Room and Film Analysis Room
창고	Storage Room
분자표적신약연구실	Molecular Targeted Drug and Biomedical Research Lab
세포배양 및 세포분석실	Cell Culture and Analysis Room
DNA 및 유전자분석실	DNA and Gene Analysis Room

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



단백질 및 효소분석실	Protein and Enzyme Analysis Room
미생물배양 및 분석실	Microorganism Culture and Analysis Room
고기능성물질 스크리닝실	Highly Functional Biomaterial Screening Room
생리활성물질 분리정제실	Bioactive Material Isolation and Purification Room
초정밀소재분석실	Super Precisional Material Analysis Room
냉장냉동고 및 항온기실	Freezer and Incubator Room

3. 주요 시험기기

시험기기명	규격 및 기타
항온항습 냉난방공조시스템	Homsys, Korea
일반 냉난방시스템	
상수·폐수· 폐기물처리장치	
보안시스템	세콤
3차원 피부 및 바디 멀티 스캐닝 입체분석시스템	PRIMOS 3D Skin and Body Multiscanner Analyzing System, GFMesstechnik GmbH, Germany
3차원 피부 및 바디 라이트 멀티 스캐닝 입체분석시스템	PRIMOS Lite 3D (field of view 45 x 30) 3D Face and Body Multiscanner Analyzing System, GFMesstechnik GmbH, Germany
3차원 얼굴 및 피부 라이트 스캐닝 입체분석시스템	PRIMOS Lite 3D (field of view 18 x 13) 3D Face and Skin Skin Scanner Analyzing System, GFMesstechnik GmbH, Germany
3차원 피부 및 바디 멀티 스캐닝 입체분석시스템	VECTRA XT 3D Imaging System, Canfield Scientific, Inc., USA
자외선조사기	Solar Simulator, Solar Light Company, Inc., USA
피부분석기A	DUB Skin Scanner, Taberna Pro Medicum GmbH, Germany
피부분석기B	DermaLab USB, Cortex Technology, Inc., Denmark
피부분석기C	Robo Skin CS50, Inforward, Inc., Japan
피부분석기D	DMS II Colorimeter, Cortex Technology, Inc., Denmark
피부분석기E	Colorimeter CR-400/410, Konica Minolta, Inc., Japan
피부분석기F	Spectrophotometer CM-2600D, Konica Minolta, Inc., Japan
피부분석기G	Multi Derasope Probes MPA5, Courage+ Khazaka Electronic GmbH, Germany
피부분석기H	Multi Gloss 268 PLUS, Konica Minolta, Japan
피부분석기I	ANTERA 3D, Miravex, Ireland
피부분석기J	Epsilon E100, Biox Systems Ltd., UK
피부분석기K	DermaVision Pro, OptoBioMed Co., Kangwon, Korea

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피부분석기L	DermaView Pro, OptoBioMed Co., Kangwon, Korea
피부분석기M	KONG PC Camera, Bomtech, Korea
피부분석기N	FLUKE-Ti105 Thermal Imager, Fluke, Inc., USA
피부분석기O	Ballistometer BLS780, Dia-Stron Ltd., UK
피부분석기P	Dermal Torque Meter DTM310, Dia-Storn Ltd., UK
피부분석기Q	Facial Stage, Cosmetic Full-Face Photography System Facial Stage DM-3, MORITEX Corp., Japan
피부분석기R	Skin Diagnosis System SDM, Bomtech, Korea
피부분석기S	SKIN-O-MAT, Cosmomed GmbH, Germany
피부분석기T	Vapometer, Delfin Technologies Ltd., Finland
피부분석기U	MoistureMeterD, Delfin Technologies Ltd., Finland
피부분석기V	MoistureMeterD Compact, Delfin Technologies Ltd., Finland
피부분석기W	SkinColorCatch, Delfin Technologies Ltd., Finland
피부분석기X	SkinGlossMeter, Delfin Technologies Ltd., Finland
피부분석기Y	JANUS-1, PIE Ltd., Korea
피부분석기Z	TiVi8000Micro, Wheels Bridge AB, Linkoping, Sweden
피부분석기a	Folliscope, LeadM Co., Seoul, Korea
피부분석기b	Dino-Lite Premier AM4113T, AnMo Electronics Ltd., Taiwan
피부분석기c	VISIA Complexion Analysis, Canfield Scientific, Inc., USA
피부분석기d	F-Ray, BEYOUNG Co., Korea
피부분석기e	MTT175, Miniature Tensile Tester, Dia-Stron Ltd., UK
피부분석기f	HC 103, Mettler-Toledo International Inc., Switzerland
피부분석기g	Handy Digital Electrostatic Fieldmeter FMX-004, SIMCO ion Co., Japan
피부분석기h	VISIA Clinical Research, Canfield Scientific, Inc., USA
피부분석기i	Translucency probe TLS850, Dia-stron Ltd., Andover, UK
피부분석기j	Visioscan VC 20plus, Courage+Khazaka Electronic GmbH, Cologne, Germany
피부분석기k	Tewameter TM300, Courage+Khazaka electronic GmbH, Cologne, Germany
적외선 조사기	IR300, Daekyoung Co., Kyungki, Korea
냉풍기	ELECTRIC AIR COOLER BKCF-16R01K, Bokuk, Korea
중형제습기	NED-050P, Nawooel, Korea
전기 온풍기	NE-80S, Nawooel, Korea
유속, 풍속 측정기	FLOWATCH, JDC INSTRUMENTS, Switzerland
순환수조	Nady BM-205, BuyMed, China

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로
 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

'하이소닉 초음파 디바이스 외 2종'의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 개선에 대한 인체적용시험

내수성시험용 욕조 및 기타	Korea/기타
촬영기기 및 조명장치, 기타	Korea/Japan/Germany/기타
피시험자 관리프로그램	자체개발, Korea
컴퓨터 서버 및 보안시스템	Korea/기타
회전형 점도계	Viscometer, Fungilab Inc., Spain
자외선 분광광도계	UV Spectrophotometer, Amersham Biosciences, Inc., USA
가시부 분광광도계	Spectrophotometer, Amersham Biosciences, Inc., USA
디지털 광학현미경	Digital Light Microscope, AMG, Inc., USA
광학현미경	Light Microscope, Olympus/Nikon, Japan
실시간 유전자 증폭반응장치	Real-Time PCR System, Bioer, Inc., China
유전자 증폭반응장치	PCR Machine, China/USA
유전자·단백질 이미지 분석장치	Image Analyzing System, Australia/USA
세포배양기	Skin Cell Incubator, Japan/Germany
액체질소 저장탱크	Liquid Nitrogen Tank, Germany/USA
시험관 혼합기	Vortex Mixer, Scientific Industries, USA
가열식·일반 자석교반기	Magnetic Mixer, Korea/Japan
가열식·일반 교반기	Shaker, Korea/Japan
고·중·저속 원심분리기	Centrifuge, Korea/Japan
대·중·소 냉장·냉동고	Refrigerator, Freezer, Korea
초저온 냉동고	Deep Freezer, Korea/Japan
가열/감온블럭장치	Heating/Cooling Block, Korea/Japan
증류수 제조장치	Water Purification System, Genesis Inc., Korea
초순수 제조장치	Mili-Q Intergral Water Purification System, Milipore Corp., USA
향온 수욕조	Water Bath, Korea/Japan
무균실험대	Clean Bench, Sejong Plus, Inc., Korea
대·중·소·아날로그 디지털 저울	Balance, Korea/Japan/Germany
호모믹서	Homomixer, Korea/Japan
pH 측정기	PH Meter, Korea/Japan
자동피펫·멀티피펫	Automatic Micro Pipette / Multi Pipette, Gilson, Inc., USA
마이크로피펫	Micro Pipette, Gilson, Inc., USA
증기가압멸균기	Autoclave, Korea/Japan
기체 크로마토그래프 분석시스템	Gas Chromatography System, Agilent Technologies, Inc., USA

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



'하이소닉 초음파 디바이스 외 2종'의 디바이스 2종의 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 및 디바이스 2종 병행 사용 시 볼/턱라인부위 탄력, 볼/턱라인부위 피부 처짐(처진 각도), 피부 광채(윤기), 피부 겉보습, 피부 속보습, 피부치밀도, 피부 거칠기(결) 개선에 대한 인체적용시험

액체 크로마토그래프 분석시스템	High-Performance Liquid Chromatography System, Agilent Technologies, Inc., USA
박층 크로마토그래프 분석시스템	Thin Layer Chromatography System, Agilent Technologies, Inc., USA
자동분리 분석분획시스템	SepBox 2D-250, Sepiatec GmbH, Germany
초소량 분광광도계	Vis-UV Nanodrop, Maestrogen, Inc., USA
형광 마이크로플레이트 분석기	Fluorescence Microplate Reader, Molecular Devices, Inc., USA
마이크로플레이트 분석기	Microplate Reader, Bio-Rad, Inc., USA
형광현미경	Fluorescence Microscopy System, Carl Zeiss, Inc., Germany
DNA/RNA 혼성화 배양기	Micro DNA/RNA Hybridization Incubator, Robbins Scientific, Inc., USA
유전자칩 반응분석시스템	Array Hybridization System, Agilent Technologies, Inc., USA
유전자칩 스캐너	Array Scanner, Agilent Technologies, Inc., USA
유전자 전기영동시스템	DNA Electrophoresis System, Bio-Rad, Inc., USA
단백질 전기영동시스템	Protein Electrophoresis System, Bio-Rad, Inc., USA
전기영동 전원장치	Power Supply, Bio-Rad, Inc., USA
유전자 UV 분석기	UV Transilluminator, Korea/Japan
미생물 자동 동정장치	Sherlock Microbe Identification System, Midi, Inc., USA
대·중·소 미생물배양기	Microorganism Incubator, Korea/Japan
고·중·저속 진탕기	Shaking Incubator, Korea/Japan
강제 순환 건조기	Forced Convection Oven, Jeio Tech., Inc., Korea
겔 건조기	Gel Dryer, Bio-Rad, Inc., USA
대·중·소 전기 건조기	Electric Dryer, Korea/Japan
동결건조기	Freeze Dryer, Ilshin Bio Base, Inc., Korea
제빙기	Ice Maker, Ilshin Bio Base, Inc., Korea
저온냉장 실험챔버	Cold Chamber, Hanbaek Scientific, Co., Korea
진공농축기	Rotary Evaporator, Eyela, Inc., Japan
용출액 자동컬렉팅 시스템	Fraction Collector, KSC, Inc., Korea
초음파분쇄시스템	Sonication System, Sonic Vibra-Cell, Sonics and Materials, Inc., USA
필름 현상기	Medical Film Processor, Konica Minolta, Inc., Japan
기타 임상·비임상 시험에 필요한 시설 및 기구, 시약	다양

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



한국피부과학연구원

서울특별시 송파구 법원로11길 25,
에이동 6층(문정동, 에이치비지니스파크)

Korea Institute of Dermatological Sciences